

ГОСТ Р 51330.5—99  
(МЭК 60079-4—75)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ**

**Ч а с т ь 4**

**Метод определения температуры  
самовоспламенения**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центром сертификации взрывозащищенного электрооборудования «СТВ» и Испытательным центром промышленной продукции РФЯЦ-ВНИИЭФ

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 9 декабря 1999 г. № 496-ст

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60079-4—75 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения» с Изменением 1 (1995), первым дополнением МЭК 60079-4A—75 и дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

## Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс государственных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, разрабатываемых Техническим комитетом по стандартизации ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование» на основе применения международных стандартов МЭК на взрывозащищенное электрооборудование.

Стандарт устанавливает метод определения температуры самовоспламенения химически чистого пара или газа в воздухе при нормальном атмосферном давлении, критерии оценки достоверности полученных результатов, основные требования к используемому испытательному оборудованию и средствам измерения, классификацию взрывоопасных смесей газов и паров по группам в зависимости от температуры самовоспламенения.

В стандарт, дополнительно к требованиям МЭК 60079-4—75, включены положения, разъясняющие и (или) конкретизирующие отдельные положения МЭК 60079-4—75 с учетом сложившейся в России практики. Приложение Б содержит аутентичный текст первого дополнения МЭК 60079-4А—70. Приложение В дополняет положения МЭК 60079-4—75 системой классификации взрывоопасных смесей газов и паров по группам в зависимости от температуры самовоспламенения, применяемой в Российской Федерации. Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, выделены в тексте курсивом.

В стандарте сохранена нумерация основного текста (включая нумерацию перечислений) и приложений (за исключением приложений Б и В), установленная МЭК 60079-4—75 и МЭК 60079-4А—70.

Содержание

1 Область применения и нормативные ссылки . . . . .	1
2 Определения . . . . .	1
3 Общее описание метода . . . . .	1
4 Оборудование . . . . .	2
5 Проведение испытаний . . . . .	2
6 Температура самовоспламенения . . . . .	4
7 Объективность результатов испытаний . . . . .	4
8 Регистрация данных . . . . .	4
9 Требования безопасности . . . . .	4
Приложение А Печи . . . . .	5
Приложение Б Температура самовоспламенения некоторых горючих газов и паров . . . . .	14
Приложение В Классификация взрывоопасных смесей газов и паров по температуре самовос- пламенения . . . . .	15
Приложение Г Отличительные признаки настоящего стандарта и международного стандарта МЭК 60079-4—75 . . . . .	18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

Часть 4

Метод определения температуры самовоспламенения

Explosionprotected electrical apparatus.  
Part 4. Method of test for ignition temperature

Дата введения 2001-01-01

## 1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящий стандарт устанавливает метод определения температуры самовоспламенения химических чистого газа или пара в воздухе при атмосферном давлении.

*Приложение Б содержит температуру самовоспламенения некоторых горючих газов и паров.*

*В приложении В приведена классификация взрывоопасных смесей газов и паров по группам в зависимости от температуры самовоспламенения.*

*Требования настоящего стандарта являются обязательными.*

### 1.1 Нормативные ссылки

*В настоящем стандарте используют ссылки на следующие стандарты:*

*ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны*

*ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты*

## 2 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**2.1 температура самовоспламенения:** Наименьшая температура, при которой происходит самовоспламенение, определенная в соответствии с методом, описанным в настоящем стандарте.

**2.2 самовоспламенение:** Реакция в испытательной колбе, сопровождающаяся появлением пламени и (или) взрывом, для которой *период индукции* самовоспламенения не превышает 5 мин.

**2.3 период индукции самовоспламенения:** Период времени, который проходит между моментом полного введения пробы и самовоспламенением.

## 3 Общее описание метода

Заданный объем вещества, предназначенного для испытания, вводят в нагретую открытую колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup>, заполненную воздухом. Содержимое колбы наблюдается в затемненном помещении до тех пор, пока не произойдет самовоспламенение. Испытание проводят с различными температурами колбы и объемами пробы. Наименьшую температуру колбы, при которой происходит самовоспламенение, принимают в качестве температуры самовоспламенения в воздухе при атмосферном давлении.

## 4 Оборудование

Описание испытательного оборудования приведено в 4.1—4.6.

*В качестве вспомогательного оборудования используют также:*

- лабораторный автотрансформатор;
- потенциометры класса 0,1 или более точные для измерения термо-ЭДС термопар;
- барометр;
- резиновую грушу для продувки испытательной колбы (или источник сжатого воздуха).

### 4.1 Испытательная колба

Испытательная колба — колба вместимостью 200 см<sup>3</sup> из термически устойчивого (боросиликатного) стекла. Для испытаний должна использоваться химически чистая колба.

Если температура самовоспламенения испытуемой пробы превышает температуру размягчения стекла, из которого изготовлена колба, или пробы может быть причиной повреждения (химической коррозии) колбы, следует использовать кварцевую или металлическую колбу; это должно быть отмечено в протоколе испытаний.

### 4.2 Печь

Испытательная колба должна быть равномерно прогрета горячим воздухом печи. Удовлетворяющие этим требованиям типы печей описаны в приложении А настоящего стандарта.

Считают, что колба прогревается равномерно, а места для измерения температуры выбраны правильно, если определенные по методике настоящего стандарта температуры самовоспламенения для веществ, указанных в таблице 1, согласуются, с учетом допусков по разделу 7, с данными таблицы 1. Пробы, используемые для такой проверки, должны иметь чистоту не менее 99,9 %.

Таблица 1

Вещество	Температура самовоспламенения, °С
н-Гептан	220
Этилен	435
Бензол	560

*ввода термопар во внутренний объем печи используют двухканальную фарфоровую трубку.*

### 4.4 Шприцы или пипетки для пробы

Жидкие пробы вводят в колбу одним из следующих способов:

- а) аттестованным шприцем вместимостью 0,25 или 1 см<sup>3</sup> и ценой деления не более 0,01 см<sup>3</sup>, снабженным антикоррозионной стальной иглой с диаметром отверстия не более 0,15 мм;
- б) аттестованной мерной пипеткой вместимостью 1 см<sup>3</sup>, позволяющей выпустить 1 см<sup>3</sup> дистиллированной воды при комнатной температуре в виде 35—40 капель.

Газообразные пробы вводят с помощью аттестованного стеклянного герметичного шприца (типа III-9) вместимостью 200 см<sup>3</sup>, снабженного трехходовым вентилем и соединительными трубками.

П р и м е ч а н и е — Следует предусмотреть меры предосторожности против обратного воспламенения. Один из способов, который используют для этих целей, схематически представлен на рисунке 6.

### 4.5 Таймер

Для определения запаздывания самовоспламенения следует использовать аттестованный таймер с ценой деления не более 1 с.

### 4.6 Зеркало

Для удобства наблюдения за внутренним объемом колбы, на крышке печи на высоте примерно 250 мм над колбой закрепляют зеркало.

## 5 Проведение испытаний

5.1 Температура печи должна быть такой, чтобы колба была равномерно прогрета до требуемой температуры. *При этом показания термопар не должны отличаться более чем на 1 °С, а установленная температура не должна изменяться в течение 5 мин.*

### 5.2 Введение пробы

Если точка кипения исследуемой жидкой пробы соответствует комнатной температуре или близка к ней, должны предприниматься меры предосторожности для поддержания температуры системы

впрыскивания пробы на уровне, обеспечивающем уверенность, что состояние пробы до ее введения в испытательную колбу не изменится. С этой целью легкокипящие продукты охлаждают до температур, при которых можно легко набрать в пипетку (шиц) требуемое количество вещества.

Для отбора пробы вязкие и твердые продукты нагревают до температур, при которых обеспечивается требуемое заполнение системы впрыскивания пробы.

### 5.2.1 Жидкие пробы

Требуемый объем исследуемой пробы вводят в испытательную колбу с помощью шприца или пипетки. Проба должна быть введена в виде капель в центр колбы не более чем за 2 с. Шприц или пипетку следует затем быстро извлечь из колбы. Попадание пробы на стенки колбы в процессе впрыскивания должно быть исключено.

### 5.2.2 Газообразные пробы

Газообразные пробы вводят с помощью предварительно наполненного герметичного шприца и подводящих трубок, обеспечивающих последующее полное заполнение системы исследуемой газовой пробой. Требуемый объем пробы вводят в испытательную колбу по возможности с постоянной скоростью, равной  $20 \text{ см}^3/\text{с}$ . Заполняющая трубка должна быть затем быстро извлечена из колбы.

### 5.2.3 Первичный объем пробы

Рекомендуемый объем пробы для первоначальных испытаний составляет  $0,07 \text{ см}^3$  для жидкой и  $20 \text{ см}^3$  для газообразной пробы.

### 5.3 Наблюдения

Таймер должен быть включен как только пробы будет полностью введена в испытательную колбу, и остановлен сразу при появлении пламени. Температура и период индукции самовоспламенения должны быть зарегистрированы. Если появление пламени не наблюдалось, таймер должен быть остановлен через 5 мин, а испытание закончено.

*Условия и результаты испытаний должны регистрироваться со следующей погрешностью:*

- температура . . .  $\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- объем вещества . . .  $\pm 0,01 \text{ см}^3$
- время . . .  $\pm 1 \text{ с}$

### 5.4 Последовательность испытаний

Испытания следует повторить при различных температурах и с различными объемами пробы до получения минимального значения температуры самовоспламенения. После каждого испытания колба должна продуваться чистым сухим воздухом. После продувки должно пройти время, достаточное для того, чтобы температура колбы восстановилась до требуемой испытательной температуры перед введением очередной пробы.

*Подготовку и испытания осуществляют в следующем порядке:*

*- чистую испытательную колбу укрепляют на крышке печи, боковые термопары прижимают к колбе и фиксируют, колбу с термопарами помещают в печь, устанавливают нижнюю термопару, прижав ее к дну колбы, и также фиксируют;*

*- проверяют правильность сборки термометрической схемы;*  
*- проверяют электрическую схему на отсутствие короткого замыкания в местах присоединения проводов и токоведущих частей на корпус испытательной установки.*

*Первичные испытания проводят с целью предварительного определения температуры самовоспламенения. Для этого на нескольких пробах первичного объема, изменения температуру опыта ступенями через  $25, 10, 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , находят минимальную температуру, при которой происходит самовоспламенение, а также температуру, на  $5 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ниже которой самовоспламенение не наблюдается.*

*Испытания по определению наиболее легкосамовоспламеняющейся количества вещества*

Для проведения этих испытаний выбирают шесть—восемь проб, отличающихся на  $0,05—0,2 \text{ см}^3$  для жидких проб и на  $4—5 \text{ см}^3$  для газообразных проб, и для каждой из них, изменения температуру опыта вблизи температуры самовоспламенения, полученной при первоначальных испытаниях, ступенями через  $25, 10, 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$  находят минимальную температуру, при которой происходит самовоспламенение, а также температуру, на  $5 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ниже которой самовоспламенение не наблюдается. По полученным данным строят график зависимости температуры самовоспламенения от объема пробы. График должен иметь вид параболы (если парабола не вырисовывается, исследуют дополнительные пробы). Объем пробы, соответствующий минимуму полученной кривой, принимают за наиболее легкосамовоспламеняющееся количество исследуемого вещества.

## ГОСТ Р 51330.5—99

Заключительные испытания проводят с *наиболее легкосамовоспламеняющимся количеством вещества* с шагом по температуре 2 °С до тех пор, пока не будет получена наименьшая температура, при которой происходит самовоспламенение.

### 5.5 Подтверждающие испытания

Для подтверждения полученного результата проводят пять испытаний при температуре на 2 °С ниже наименьшей температуры, полученной в процессе заключительных испытаний, при этом самовоспламенение не должно наблюдаться ни в одном из испытаний

## 6 Температура самовоспламенения

Наименьшее значение температуры, при которой происходит самовоспламенение в процессе испытаний по разделу 5, должно быть зафиксировано в качестве температуры самовоспламенения при условии, что результаты удовлетворяют требованиям раздела 7. Должны быть зафиксированы также период индукции самовоспламенения и давление окружающей среды.

## 7 Объективность результатов испытаний

### 7.1 Повторяемость

Расхождение двух результатов, полученных одним и тем же оператором, не должно превышать 2 % определяемой величины.

### 7.2 Воспроизводимость

Усредненные результаты аналогичных испытаний, полученные в различных лабораториях, не должны различаться более чем на 5 %.

П р и м е ч а н и е — Допуски на расхождение результатов испытаний и воспроизводимость, установленные выше, являются рекомендуемыми величинами вплоть до накопления большего объема информации.

## 8 Регистрация данных

Регистрационные записи должны содержать название, источник и физические свойства вещества, номер испытания и дату его проведения, температуру и давление окружающей среды, объем пробы, температуру и запаздывание самовоспламенения.

## 9 Требования безопасности

*Испытательную установку размещают в вытяжном шкафу. Рабочее место оператора должно удовлетворять требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и санитарно-гигиеническим требованиям по ГОСТ 12.1.005.*

*При исследовании токсичного вещества или вещества, которое выделяет токсичные компоненты при разложении и горении, испытание проводят при соблюдении санитарных правил и правил техники безопасности, принятых для работы с токсичными веществами. В этом случае применяют соответствующий противогаз и дегазационные средства.*

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(обязательное)

## Печи

Для испытаний, описанных в настоящем стандарте, подходят печи, сконструированные в соответствии с А.1 и А.2.

А.1 Печь схематически показана на рисунках А.1 — А.6. Она содержит:

— цилиндр из огнеупорного материала с внутренним диаметром 127 мм и высотой 127 мм, на наружной поверхности которого намотан равномерно распределенный по высоте электрический нагреватель мощностью 1200 Вт;

- подходящий огнеупорный изоляционный материал и поддерживающий стальной корпус;
- крышку в форме кольца и центрирующее кольцо колбы из огнеупорного материала;
- нагреватели горловины и основания колбы мощностью 300 Вт.

Для измерения температуры печи используют три термопары, расположенные на 25 и 50 мм ниже основания нагревателя горловины и под дном колбы его центра.

Температура, измеренная каждой термопарой, должна находиться в пределах  $\pm 1$  °С от ожидаемой испытательной температуры путем независимой регулировки каждого из трех нагревателей.


А.2 Печь схематически показана на рисунках А.7—А.9. Она содержит нагреватель мощностью 1300 Вт с максимальным током нагрева 6 А.

Провод нагревателя диаметром 1,2 мм и длиной 35,8 м из сплава Cr/Al (30/5) намотан на всю длину керамического цилиндра с шагом 1,2 мм. Нагреватель закреплен с помощью высокотемпературной мастики и покрыт напыляемым термоизолирующим слоем оксида алюминия толщиной 20 мм. Цилиндр из нержавеющей стали вставлен в керамический корпус с минимально возможным зазором. Крышка, закрывающая печь, также изготовлена из нержавеющей стали и содержит колбу, расположенную внутри печи. Для этого крышка включает в себя верхний диск, разъемное изоляционное уплотнение и разъемный нижний диск. Горловину колбы вставляют в крышку с высокотемпературной изоляционной прокладкой идерживают с помощью сегментов разъемного уплотнения и нижнего диска, которые обеспечивают уплотнение и крепятся к верхнему диску с помощью двух кольцевых гаек.

Нагреватель может работать от сети переменного или постоянного тока с соответствующим способом управления напряжением.

Максимальный ток нагрева 6 А следует использовать для достижения требуемой температуры в процессе предварительных испытаний. Если применяют систему автоматического управления температурой, периоды нагрева и охлаждения должны быть одинаковы и, по возможности, только часть тока нагрева должна регулироваться таким способом.

Измерительные термопары устанавливают на внешней поверхности стенок колбы на расстоянии  $(25 \pm 2)$  мм от ее дна и в центре нижней поверхности дна.

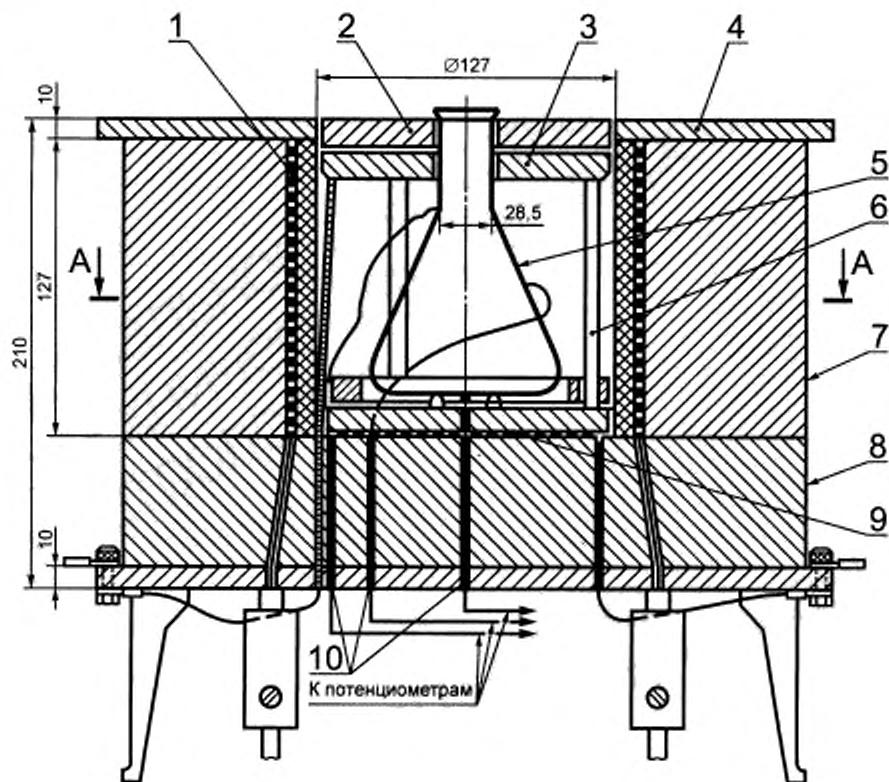

1 — основной нагреватель; 2 — кольцо крышки; 3 — обогреватель горловины; 4 — крышка из огнеупорного материала; 5 — колба вместимостью 200 см<sup>3</sup>; 6 — керамическая опора; 7 — поддерживающий цилиндр; 8 — электрический титрель печи; 9 — основной нагреватель; 10 — термопары

Рисунок А.1 — Испытательное оборудование (сборка)


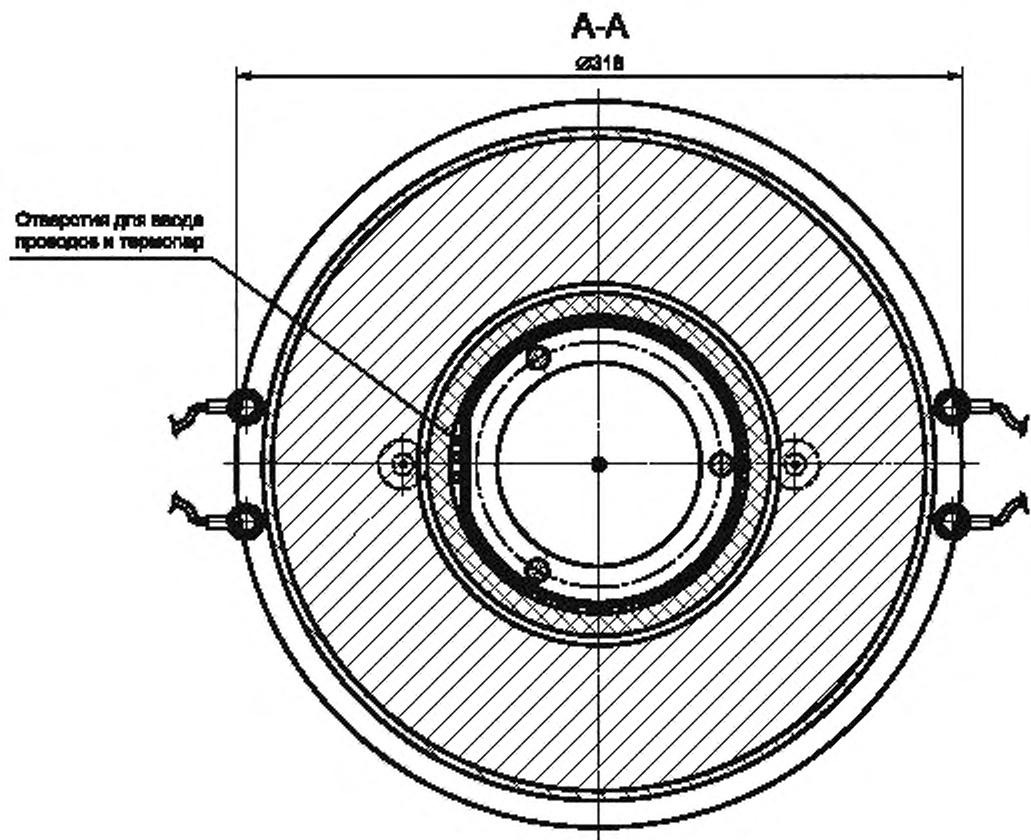


Рисунок А.2 — Сечение А-А (колба не показана)

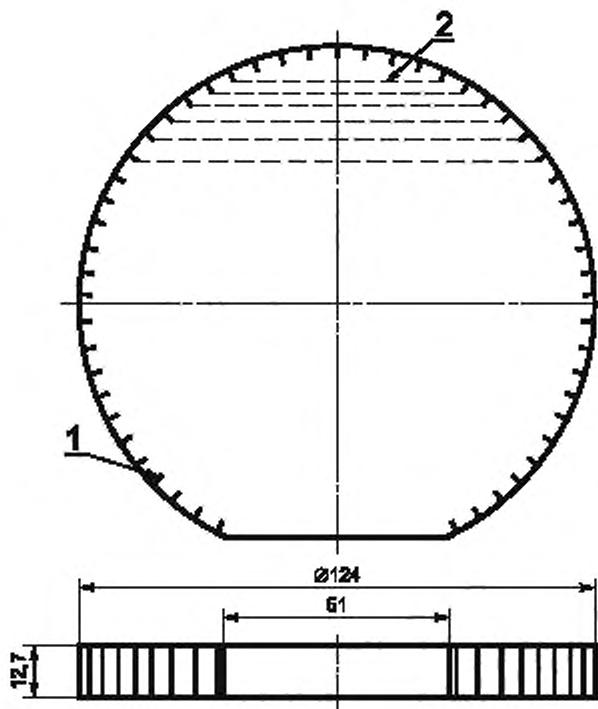

1 — паз размером 1,5×1,5 мм на боковой поверхности диска;  
2 — способ укладки никель-хромового провода диаметром 0,4 мм и  
длиной 2,5 м

Рисунок А.3 — Основной нагреватель (корпус — из огне-  
упорного материала)



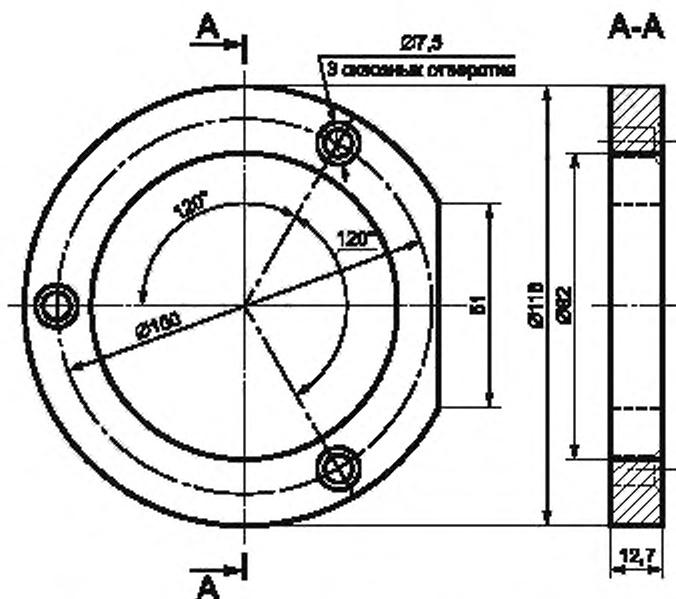


Рисунок А.4 — Центрирующее кольцо колбы (корпус — из огнеупорного материала)

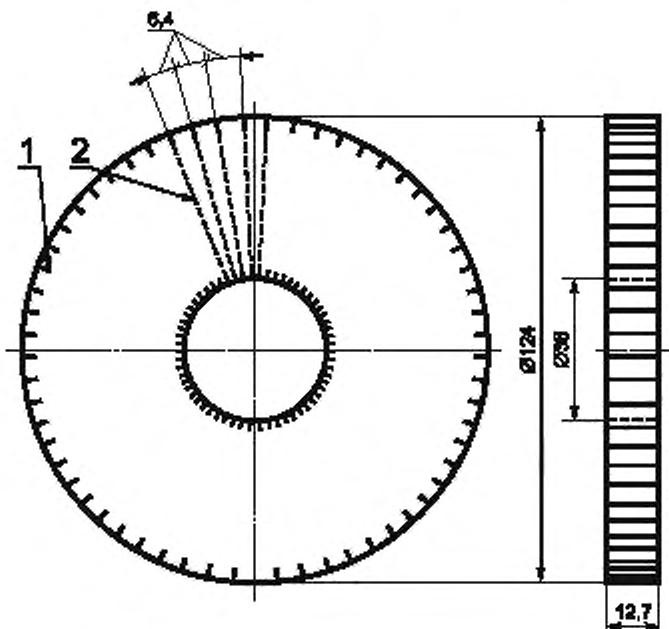


1 — паз размером 1,5×1,5 мм на внешней и внутренней боковых поверхностях колца; 2 — способ укладки никель-хромового провода диаметром 0,4 мм и длиной 4,5 м

Рисунок А.5 — Обогреватель горловины (корпус из огнеупорного материала)

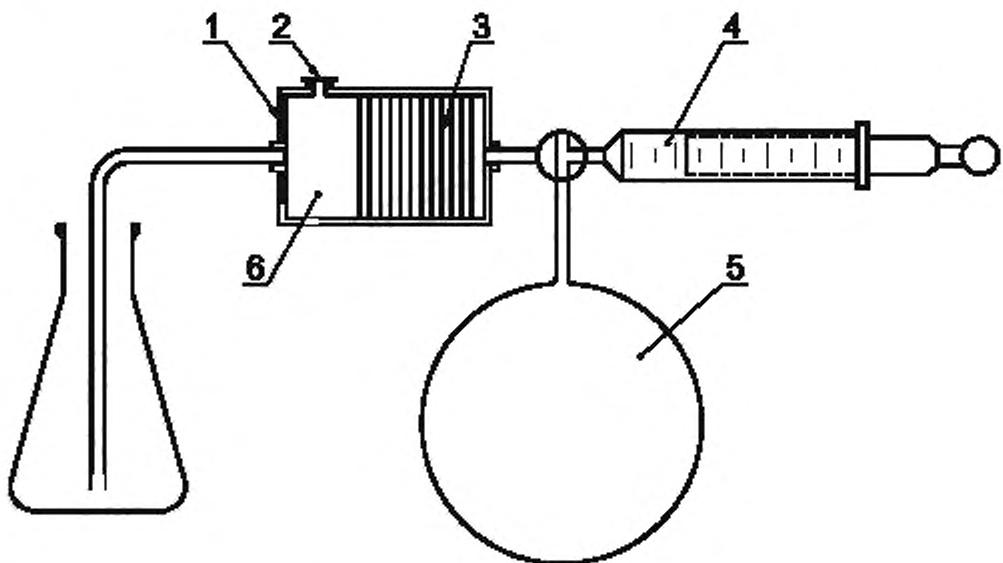

1 — огнепрепятитель; 2 — предохранительная мембрана; 3 — пластиинки из спеченного стекла (перегородки); 4 — герметичный шприц; 5 — резервуар с газом; 6 — предкамера

Рисунок А.6 — Введение газообразной пробы

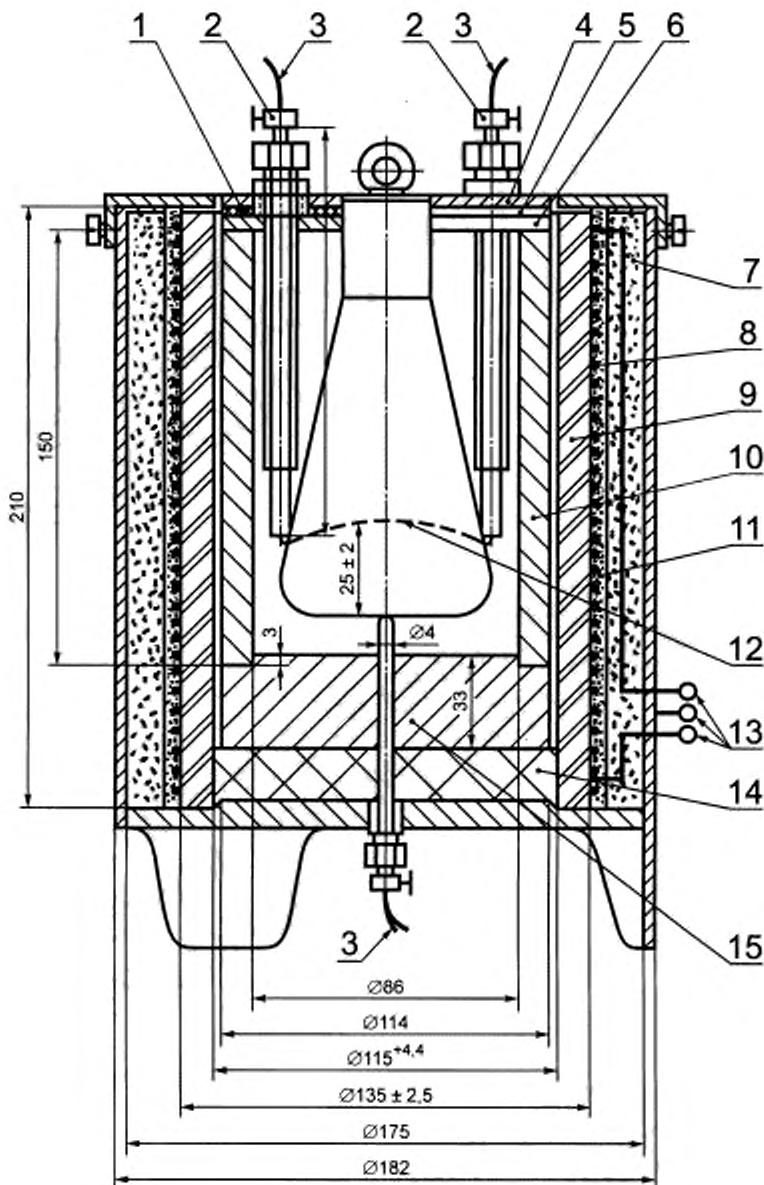

1 — высокотемпературная изоляция; 2 — зажимные втулки; 3 — термопары;  
 4 — верхняя часть крышки; 5 — изоляционное кольцо; 6 — нижняя часть крышки;  
 7 — теплоизоляция; 8 — нагреватель; 9 — керамическая трубка; 10 — стальной ци-  
 линдр; 11 — высокотемпературная мастика; 12 — контрольные точки; 13 — соедине-  
 ние нагревателя на напряжение 220 В; 14 — изоляционный диск; 15 — металлическое  
 основание

Рисунок А.7 — Печь

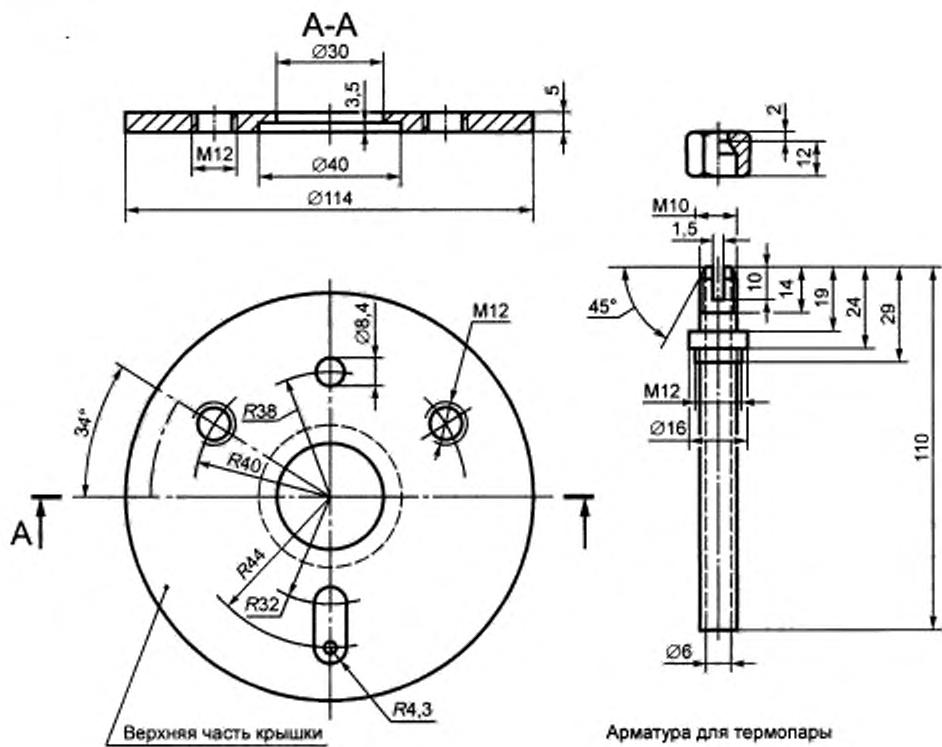


Рисунок А.8 — Крышка стального цилиндра

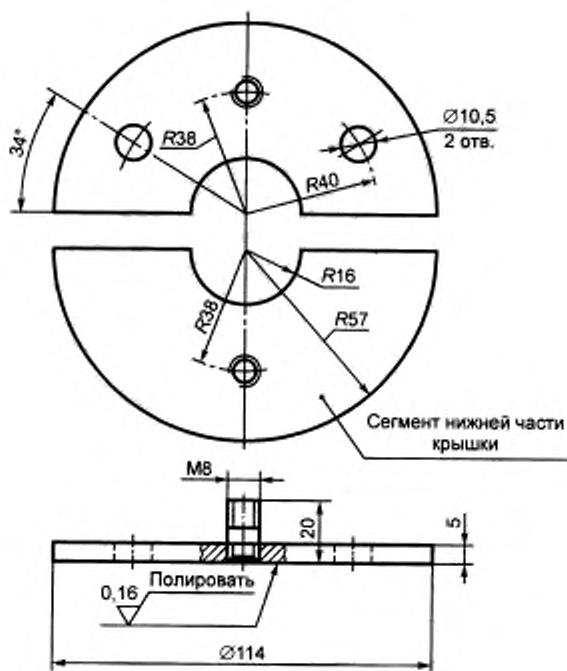


Рисунок А.9 — Крышка стального цилиндра

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(справочное)

## Температура самовоспламенения некоторых горючих газов и паров\*

Наименование вещества	Химическая формула	Температура самовоспламенения, °С
Уксусный ангидрид	$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$	334
Ацетон	$(\text{CH}_3)_2\text{CO}$	535
Бензол	$\text{C}_6\text{H}_6$	560
1,3-Бутадиен	$\text{CH}_2=\text{CH CH=CH}_2$	430
Изобутанол (бутиanol-2)	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$	408
Серауглерод	$\text{CS}_2$	102
Хлорбензол	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$	637
Циклогексан	$\text{C}_6\text{H}_{12}$	259
Циклогексанон	$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$	419
1,4-Диоксан	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3\text{O}$	379
Этилбензол	$\text{C}_6\text{H}_5\text{C}_2\text{H}_5$	431
<i>n</i> -Гептан	$\text{C}_7\text{H}_{16}$	215
<i>n</i> -Гексан	$\text{C}_6\text{H}_{14}$	233
Метилаль	$\text{CH}_2(\text{OCH}_3)_2$	236
Нафталин	$\text{C}_{10}\text{H}_8$	528
<i>n</i> -Нонан	$\text{C}_9\text{H}_{20}$	205
2,2,4-Триметилпентан (изооктан)	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_3$	411
<i>n</i> -Тетрадекан	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_9\text{CH}_3$	201
Тетрагидрофуран	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	224
Толуол	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$	535
Трихлорсилан	$\text{SiHCl}_3$	230
Винилацетат	$\text{CH}_2=\text{CH COOCH}_3$	385
<i>n</i> -Ксиол	$\text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_2$	528

## П р и м е ч а н и я

1 Значения температуры самовоспламенения определены методом по МЭК 60079-4 не менее чем в двух независимых лабораториях разных стран, с расхождением результатов не более 5 %, в соответствии с 7.2.

2 Даже незначительное количество примесей может заметно изменять значение температуры самовоспламенения. Так температура самовоспламенения трихлорсилана, равная 230 °С, определяется только при испытании на свежей пробе. После старения пробы (вследствие окисления и возможного изменения влажности пробы) значение температуры самовоспламенения может снизиться до 185 °С.

\* Настоящее приложение содержит аутентичный текст публикации МЭК 60079-4А170.

ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(справочное)**Классификация взрывоопасных смесей газов и паров по температуре самовоспламенения**

Взрывоопасные смеси газов и паров подразделяют на группы в зависимости от значения температуры самовоспламенения согласно таблице В.1

Таблица В.1

Группа взрывоопасных смесей	Температура самовоспламенения, °С
<i>T1</i>	Св. 450
<i>T2</i>	» 300 до 450 включ.
<i>T3</i>	» 200 » 300 »
<i>T4</i>	» 135 » 200 »
<i>T5</i>	» 100 » 135 »
<i>T6</i>	» 85 » 100 »

Распределение взрывоопасных смесей по группам приведено в таблице В.2

Таблица В.2

Группа взрывоопасных смесей	Вещество, образующее с воздухом взрывоопасную смесь
<b>Взрывоопасные смеси категории I</b>	
<i>T1</i>	Метан в подземных выработках
<b>Взрывоопасные смеси категории IIА</b>	
<i>T1</i>	<p>Аммиак, алкил хлористый, ацетон, ацетонитрил.</p> <p>Бензол, бензотрифторид, бутил хлористый третичный.</p> <p>Винил хлористый, винилиден хлористый, 2-винилпиридин, 4-винилпиридин.</p> <p>Газовая смесь (10 % водорода + 90 % аргона), <math>\beta</math>-гидропетрафторэтокси-бензол.</p> <p>1,1-Диметил-5-гидропетрамиловый спирт; 3,4-дихлорбутен-1; 1,3-дихлорбутен-2; дихлорметан, 1, 2-дихлорпропан, дихлорэтан, дациклопентадиен, дизтиламин, доменный газ.</p> <p>Изобутилен, изобутан, изопропилбензол, изопропилацетат, изопропилформиат.</p> <p>Кислота уксусная, ксиол.</p> <p>Лак сланцевый пиролизный ЛСП-1.</p> <p>Метан (промышленный), металиххлорид, метилацетат, 2-метил-5-винилпиридин, метилизоцанат, 2-метилпиридин, 3-метилпиридин, 4-метилпиридин, <math>\beta</math>-метилстирол, метил хлористый, метилхлорформиат, метилциклогептонацетон, метилэтилкетон.</p> <p>Оксид углерода.</p> <p>Пиридин, пропан, псевдокумаз.</p> <p>Растворители Р-4, Р-5, РС-1, разбавитель РЭ-1.</p> <p>Сольвент нефтяной, стирол, спирт дикацетоновый, спирт трифтормети-ловый.</p> <p>Толуол, трифторметилпропан, трифторметен, трифторметан, трифторметилхлорэтилен, триэтиламин.</p> <p>Хлорангидрид акриловой кислоты, хлорангидрид метакриловой кислоты, хлорбензол.</p> <p>Циклопентадиен</p> <p>Этан, этил хлористый</p>

ГОСТ Р 51330.5—99

Продолжение таблицы В.2

Группа взрывоопасных смесей	Вещество, образующее с воздухом взрывоопасную смесь
T2	<p>Алкилбензол, аллилацетат, амилацетат, ангидрид уксусной кислоты, ацетилацетон, ацетилфторид, ацетил хлористый, ацетопропионат, бутил хлористый вторичный, бутирилфторид</p> <p>Бензин Б 95/130, бутан, бутилацетат, бутилены, бутилпропионат, бутил хлористый вторичный, бутирилфторид</p> <p>Винилацетат, винилиден фтористый</p> <p>Диатол, дигизопропилямин, дигизопропиоловый эфир, диметиламин, диметиланилин, диметиламинопропионитрил, диметилвинилэтинилкарбонат; 1,1-диметил; или 3-гидроперфторпропиоловый спирт, диметилсульфат, диметилформиат, диметилциклогексаны, димер метилциклогептадиена.</p> <p>Изобутилизобутират, изобутил хлористый, изомасляная кислота, изопентан, изопрен, изопропиламин, изопропилхлоракетат, изооктан.</p> <p>Кислота пропионовая.</p> <p>Метиламин; 2-метильтбутен-2, метилизобутилкарбонат, метилизобутилкетон, метилметакрилат, метилмеркаптан, метилтретичноамилтовый эфир, метилтретичнообутиловый эфир, метилхлорметидхлорсилан, метилтрихлорсилан; 2-метилтиофен, метилциклогептадиен, метилфуран, метилформиат, моноизобутиламин.</p> <p>Оксид мезитила.</p> <p>Пентадиен-1, 3, пероксид дигидроизофорона, пропиламин, пропилен.</p> <p>Растворители Р-40 № 645 (взамен РДВ), № 646, № 647, № 648, № 649, РС-2, БЭФ, АЭ.</p> <p>Разбавители РКБ-1, РКБ-2.</p> <p>Спирты: амиловый третичный, н-бутиловый, бутиловый третичный, изоамиловый, изобутиловый, изопропиловый, метилловый, пропиловый, 1, 1, 3-тригидроперфторпропиоловый, фурфуриловый, этиловый.</p> <p>1, 1, 3-Тригидроперфторпропилеметакрилат, 1, 1, 7-тригидроперфторгептилметакрилат, 1, 1, 3-тригидротетрафторпропилакрилат, трифторпропилеметилдихлорсилан, трифторхлорэтизометиловый эфир, трифторэтилен, трихлорэтилен.</p> <p>Хлористый изобутил.</p> <p>Циклогексанол, циклогексанон, циклогексен, циклогептэн.</p> <p>Этиламин, этилацетат, этибутират, этиленхлорид, этилбензол, этилизобутират, этилформиат, этилендиамин</p>
T3	<p>Бензин A-72, A-76, «Газоша», Б-70 экстракционный МРТУ 12н № 20—63, экстракционный ТУ 38—101—303—72, бутилметакрилат, бутил хлористый.</p> <p>Винилциклогексен.</p> <p>Гексан, гексаметиленимин, гептан.</p> <p>Дизобутиламин, диметиламинозетанол, N,N-диметилпропандиамин-1, 3; диметилсульфид, дипропиламин.</p> <p>Изовалериановый альдегид, изооктилен.</p> <p>Камfen, керосин.</p> <p>Метилацетоацетат, метиловый эфир <math>\beta</math>-метоксипропионовой кислоты, морфолин.</p> <p>Нефть сырья</p> <p>Петролейный эфир, полизэфир ТГМ-3, пентан.</p> <p>Растворитель № 651</p> <p>Сероокись углерода, скрипидар, спирт амиловый, стабилизатор СД-1 (М).</p> <p>Тетрагидроинден, тетрафторэтилен, топливо Т-1, ТС-1, Т-6, Т-8, печное марки А, траметиламин, 4, 4, 5-траметил-1, 3-диоксан.</p> <p>Уайт-спирит.</p> <p>Циклогексан, циклогексиламин.</p> <p>Этилдислортиофосфат, этилмеркаптан</p>

## Окончание таблицы В.2

Группа взрывоопасных смесей	Вещество, образующее с воздухом взрывоопасную смесь
T4	Альдегиды: изомасляный, масляный, уксусный (ацетальдегид), ацеталь. Бромацеталь. Декан, динозаминовый эфир, 1, 4-диметилтиперазин. $\alpha$ -Изопропил- $\beta$ -изобутилакролеин. Паральдегид. Тетраметилдиаминометан, 1, 1, 3-триэтоксибутан
T5	—
T6	—
<b>Взрывоопасные смеси категории IVB</b>	
T1	Коксовый газ. Синильная кислота.
T2	Винилнорборнен. Дивинил, 4, 4-диметилдиоксан, диметилдихлорсилан, диоксан, диметилдихлорсилан, диметилкетон. Камфорное масло, кислота акриловая. Метилакрилат, мегилминидихлорсилан, метиленциклобутан. Нитрил акриловой кислоты, нитроциклогексан. Оксид 2-метилбутена-2, оксид пропилена, оксид этилена, актилацетат. Пропаргиловый спирт. Растворители: AMP-3, AKP. Триметилхлорсилан. Фенилацетилен, формальдегид, фуран фурфурол. Этихлоридиан, этилакрилат, этилтрихлорсилан, этилен
T3	Алилглицидиловый эфир, альдегид кротоновый, акролеин, ацетат диметилэтинилкарбинола. Бутилакрилат, бутилглицидный эфир. Винилоксизтанол, винилтрихлорсилан. Дикетен. Изопропенилацетилен. Метилала, метилдигидропиран, 4-метиленететрагидропиран, 2-метилпентенала. Сероводород. Тетрагидробензальдегид, тетрагидрофуран, тетраэтоксисилан, топливо дизельное (зимнее), триэтоксисилан. Формальдегид. Этилдихлорсилан, этилidenнорборнен, этилцеллюзоль
T4	Альдегид пропионовый. Дибутиловый эфир, диметиловый эфир диэтиленгликоля, диэтиловый эфир этиленгликоля. 2-Этилгексеналь
T5	—
T6	—
<b>Взрывоопасные смеси категории IIC</b>	
T1	Водород, водяной газ. Светильный газ, смесь (75 % водорода + 25 % азота)
T2	Ацетилен
T3	Метилдихлорсилан. Трихлорсилан
T4	—
T5	Сероуглерод
T6	—

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
(справочное)*Отличительные признаки настоящего стандарта и международного стандарта МЭК 60079-4—75*

Отличительные признаки настоящего стандарта и международного стандарта МЭК 60079-4 приведены в таблице Г.1. В графе 1 таблицы указан также характер каждого уточнения текста. В графе 3 приведен аутентичный текст соответствующих пунктов (абзацев) стандарта МЭК 60079-4, подвергшийся уточнению.

Таблица Г.1

Номер раздела, пункта настоящего стандарта		Аутентичный текст МЭК 60079-4
	МЭК 60079-4	
1. Введены ссылки на приложения <i>Б</i> и <i>В</i>	1	
1.1 Введен дополнительно		
2.2, 2.3, 4.5, 5.3 (первый абзац), 6, 8. Текст, выделенный курсивом, — из- менена редакция	2.2, 2.3, 4.5, 5.3 (первый абзац), 6, 8	запаздывание
4. Введен дополнительный текст	4	
4.1. Введен дополнительный текст	4.1	
4.3. Введен дополнительный текст	4.3	
4.4. Введен дополнительный текст	4.4	
5.1. Введен дополнительный текст	5.1	
5.2. Введен дополнительный текст	5.2	
5.3. Введен дополнительный текст	5.3	
5.4. Введен дополнительный текст	5.4	
5.5. Изменена редакция	5.5	Испытания заключительной серии должны быть повторены пять раз
9. Введен дополнительно		
Приложение Б. Введено дополни- тельно (аутентичный текст пуб- ликации МЭК 79-4A-70)		
Приложение В. Введено дополни- тельно		

УДК 621.3.002.5—213.34:006.354

ОКС 29.260.20

Е09

ОКСТУ 3402

Ключевые слова: электрооборудование взрывозащищенное, температура самовоспламенения, метод определения, проведение испытаний, объективность результатов испытаний, оценка повторяемых испытаний, регистрация данных, классификация взрывоопасных смесей газов и паров по температуре самовоспламенения.

Редактор *В. П. Осурцов*  
Технический редактор *В. И. Прусакова*  
Корректор *Л. Я. Митрофанова*  
Компьютерная верстка *Т. В. Александровой*

Изд. лин. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 07.02.2000. Подписано в печать 14.03.2000. Усл. печ. л. 1,40.  
Уч.-изд. л. 1,62. Тираж 325 экз. С. 4678. Зак. 403.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.  
Калужская типография стандартов, 248021, Калуга, ул. Московская, 256.  
ПЛР № 040138