
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
ISO 9585—
2011

ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ

**Определение прочности и жесткости на изгиб
металлических пластинок для скрепления
отломков кости**

(ISO 9585:1990, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 ноября 2011 г. № 40)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|---|------------------------------------|---|
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстанстандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстанстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1376-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9585—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 9585:1990 Implants for surgery — Determination of bending strength and stiffness of bone plates (Имплантаты для хирургии. Определение прочности и жесткости на изгиб металлических пластинок для скрепления отломков кости).

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р ИСО 9585—2009

6 ВВЕДЕНИЕ В ПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

© Стандартинформ, 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ**Определение прочности и жесткости на изгиб металлических пластинок
для скрепления отломков кости**

Implants for surgery. Determination of bending strength and stiffness of bone plates

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

В настоящем стандарте представлен метод испытания и определения прочности и жесткости на изгиб прямых пластинок для скрепления отломков кости. Этот метод можно применять для испытаний пластинок с небольшой заданной кривизной, предназначенных для скрепления кости, а также для испытания прямого участка пластинок, согнутых под углом.

Примечание — Данный метод испытания не рекомендуется применять для пластинок длиной менее 50 мм.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 крутящий момент: Крутящее действие силы вокруг оси, выраженное числом, являющимся произведением силы F на расстоянии b , измеряемое перпендикулярно от оси к направлению действия этой силы; Н·м.

2.2 изгибающий момент M_b : Момент, действующий вокруг осевой линии, перпендикулярной к длинной оси тела, и обычно вызывающий боковой прогиб; Н·м.

2.3 прогиб: Линейное смещение из-за изгиба, измеренное перпендикулярно к первоначальной оси пластинки; м.

2.4 прочность при изгибе: Значение изгибающего момента при разрушении или в заданной расчетной точке, в зависимости от того, что меньше.

2.5 эквивалентная жесткость на изгиб: Жесткость пластиинки, рассчитанная с учетом размеров испытуемого образца и наклона S линейной части графика зависимости прогиба от нагрузки, полученного при механическом испытании; Н·м².

Примечание — При расчете эквивалентной жесткости на изгиб учитывают отверстия и прорези в пластинке.

3 Аппаратура

3.1 Испытательное приспособление, необходимое для получения системы нагружения, изображено на рисунке 1. Основой приспособления являются четыре ролика (заштрихованные кружки), оси которых остаются параллельными друг другу.

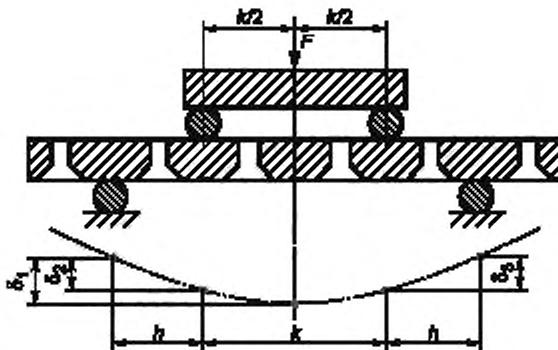


Рисунок 1 — Схема приспособления с четырьмя опорами для испытания на прочность при изгибе (внешний вид образца при изгибе)

3.2 Ролики цилиндрической формы одинакового диаметра 8—13 мм или профицированной формы, соответствующей поперечному сечению испытуемой пластинки со средним диаметром 8—13 мм. Желательно, чтобы один из роликов был жестко связан с образцом для того, чтобы ограничить продольное перемещение, а все ролики были бы жестко фиксированы для сохранения их относительного положения между собой.

3.3 Устройство для приложения усилий, например установка для испытания механических свойств.

3.4 Устройство для измерения относительного смещения.

4 Испытания

4.1 Основные положения

Испытание на изгиб проводится на устройстве, описанном в разделе 3. Цилиндрические ролики используются для испытания плоских пластинок, а также пластинок с искривленным поперечным сечением, когда отклонение от плоскости в центре пластины не превышает значения $b/6$, где b — ширина пластины.

Испытания пластины другой формы проводятся при использовании роликов соответствующего профиля.

4.2 Размещение испытуемого образца

Испытуемый образец помещают в испытательное приспособление с выполнением следующих рекомендаций:

а) разместить пластины таким образом, чтобы внутренние ролики находились в контакте с той поверхностью пластины, которая должна соприкасаться с костью;

б) если пластина является симметричной, разместить ее так, чтобы два наиболее близких к центру резьбовых отверстий, располагались симметрично между внутренними роликами;

в) если пластина имеет центральное резьбовое отверстие, разместить ее таким образом, чтобы это отверстие и любое другое резьбовое отверстие были расположены симметрично между внутренними роликами;

г) если пластина является асимметричной, разместить ее таким образом, чтобы два резьбовых отверстия располагались между внутренними роликами и место разлома, для соединения которого она предназначена, также находилось бы между внутренними роликами;

д) разместить внешние ролики на равном расстоянии h , м, от внутренних роликов, как показано на рисунке 1, так, чтобы только одно отверстие находилось на линии между внутренними и внешними роликами;

е) убедиться в том, что внутренние ролики не находятся в контакте с теми частями пластины, где имеются резьбовые отверстия. По возможности, внешние ролики не должны касаться тех частей пластины, где имеются резьбовые отверстия;

ж) выровнять ось испытуемого образца таким образом, чтобы она стала перпендикулярной к осям роликов;

i) установить приспособление для измерения прогиба (измерение проводится в метрах) пластиинки относительно первоначального положения опор внешних роликов. Прогиб может быть измерен:

- 1) на средней линии между центральными роликами (δ_1);
- 2) на одном из центральных роликов (δ_2);
- 3) на каждом из центральных роликов (δ_2 и δ_3).

Если местоположение отверстий на пластиинке не является симметричным относительно ее длины, то рекомендуется использовать метод 3).

4.3 Прилагаемая нагрузка F

Приложить нагрузку F по указанной центральной линии нагружения и измерить соответствующий прогиб. Постепенно увеличивая нагрузку F , отмечая соответствующий прогиб через каждый интервал и строя график зависимости δ от F до тех пор, пока F не достигнет значения, при котором наступит разрушение пластиинки, $F = F_{\max}$. Прогиб δ становится таким, что пластиинка деформируется так, что графическая зависимость прогиба от нагрузки показывает заметную текучесть ($F = P$), как показано на рисунке 2.

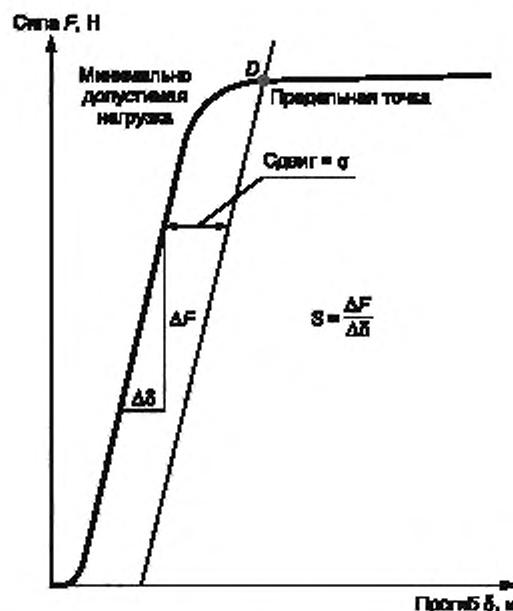


Рисунок 2 — График зависимости прогиба от нагрузки

4.4 Использование образцов

Каждый образец испытывают только один раз и затем утилизируют его.

5 Расчет результатов

5.1 Среднее прогиба

Если прогибы δ_2 и δ_3 измерены в соответствии с 4.2, перечисление i), метод 3), то рассчитывают среднее прогиба, полученного на каждом этапе испытаний

$$\delta_4 = 0,5 (\delta_2 + \delta_3).$$

Затем чертят графическую зависимость прогиба δ_4 от нагрузки F .

5.2 Эквивалентная жесткость на изгиб

Проводят прямую линию через начальную (линейную) часть графика зависимости прогиба от нагрузки, как показано на рисунке 2. Эта линия будет иметь наклон S , что также показано на рисунке 2.

Если прогиб измерен в соответствии с 4.2, перечисление i), метод 1), то значение эквивалентной жесткости на изгиб E , м, рассчитывают по формуле

$$E = \frac{(4h^2 + 12hk + k^2)Sh}{24}, \quad (1)$$

где h — расстояние между внутренними и внешними роликами, м;

k — расстояние между внутренними роликами, м;

S — уклон кривой прогиб/нагрузка, Н·м.

Если прогиб измерен в соответствии с 4.2, перечисление i), метод 2) или с 4.2, перечисление i), метод 3), то E — эквивалентную жесткость на изгиб, рассчитывают по формуле

$$E = \frac{(2h + 3k)Sh^2}{12}. \quad (2)$$

5.3 Прочность на изгиб

На графической зависимости прогиб/нагрузка проводят прямую линию, параллельную линейной части графика, но смещенную на q метров от нее, как показано на рисунке 2. Пересечение этой линии с кривой является расчетной точкой безопасности, соответствующая сила P является безопасной нагрузкой.

Значение q рассчитывают по формуле

$$q = 0,02(2h + k). \quad (3)$$

Прочность на изгиб, Н·м, рассчитывают по уравнению

$$\text{Сопротивление изгибу} = 0,5Ph, \quad (4)$$

где P — расчетная нагрузка, Н;

h — расстояние между внутренними и внешними роликами, м.

Если разрушение пластиинки происходит перед точкой пересечения кривой прогиб/нагрузка линии сдвига, то расчет прочности на изгиб, Н·м, производится следующим образом:

$$\text{Прочность на изгиб} = 0,4F_{\max}h, \quad (5)$$

где F_{\max} — максимальная нагрузка, Н;

h — расстояние между внутренними и внешними роликами, м.

При мечание — В этом уравнении используется значение безопасной нагрузки, равное 0,8 от максимальной.

6 Протокол испытания

В протокол испытания должна быть включена следующая информация:

- a) прочность на изгиб, Н·м;
- b) сдвиг, м, используемый для определения точки безопасности;
- c) эквивалентная жесткость на изгиб, Н·м², рассчитанная по формуле 1 или 2;
- d) если пластиинка разрушается перед достижением точки безопасного прогиба, то это должно быть зафиксировано;
- e) идентичность пластиинки, например, ее тип, длина, мм, номер по каталогу изготовителя и номер партии, указанный стороной, предоставившей образец для проведения испытаний.

УДК 615.472:006.354

МКС 11.040.40

IDT

Ключевые слова: хирургические имплантаты, металлические пластиинки, испытание на изгиб, испытание жесткости

Редактор Д.М. Кульчицкий
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Ю.М. Прокофьев
Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Сдано в набор 13.06.2013. Подписано в печать 05.07.2013. Формат 60×84¹/₂. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 61 экз. Зак. 759.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105082 Москва, Лялин пер., 6.