

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
30805.16.1.1—
2013
(CISPR 16-1-1:2006)

[ГОСТ Р 51318.16.1.1—2007
(СИСПР 16-1-1:2006)]

Совместимость технических средств электромагнитная
ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ
И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Часть 1-1

АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ
И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ. ПРИБОРЫ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ

(CISPR 16-1-1:2006, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus, MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Санкт-Петербургским филиалом «Ленинградское отделение Научно-исследовательского института радио» (Филиал ФГУП «НИИР-ЛОНИИР») и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 марта 2013 г. № 55-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

(Поправка, ИУС 7—2019)

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. № 436-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30805.16.1.1—2013 (CISPR 16-1-1:2006) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту CISPR 16-1-1:2006 «Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура» («Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus», MOD) путем изменения его структуры для приведения в соответствие с правилами, установленными ГОСТ 1.5—2001 (подразделы 4.2 и 4.3); путем изменения фраз, слов, которые выделены в тексте курсивом.

Международный стандарт CISPR 16-1-1:2006 подготовлен Международным специальным комитетом по радиопомехам (CISPR) Международной электротехнической комиссии (IEC), Подкомитетом А «Измерения радиопомех и статистические методы».

Настоящее объединенное издание международного стандарта CISPR 16-1-1 включает в себя второе издание, опубликованное в 2006 г., и Изменение 1 (2006 г.).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2001 (подраздел 3.6).

В настоящем стандарте термин «радиочастотное возмущение» («radio disturbance») заменен на термин «индустриальная радиопомеха» в целях соблюдения принятой терминологии.

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных, приведены в дополнительном приложении ДА.

Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51318.16.1.1—2007 (СИСПР 16-1-1:2006)¹⁾

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ИЗДАНИЕ (май 2020 г.) с Поправкой (ИУС 7—2019)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

¹⁾ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. № 436-ст ГОСТ Р 51318.6.1.1—2007 (СИСПР 16-1-1:2006) отменен с 1 января 2014 г.

© Стандартинформ, оформление, 2014, 2020



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Измерительные приемники с квазипиковым детектором для полосы частот от 9 кГц до 1000 МГц	4
5 Измерительные приемники с детектором пиковых значений для полосы частот от 9 кГц до 18 ГГц	8
6 Измерительные приемники с детектором средних значений для полосы частот от 9 кГц до 18 ГГц	11
7 Измерительные приемники с детектором среднеквадратических значений для полосы частот от 9 кГц до 18 ГГц	15
8 Измерительные приемники с определением функции распределения амплитуд ИРП для полосы частот от 1 до 18 ГГц	17
9 Анализаторы кратковременных ИРП	18
Приложение А (обязательное) Расчет импульсной характеристики измерительных приемников с детекторами квазипиковых и среднеквадратичных значений	30
Приложение В (обязательное) Методы определения характеристик импульсных генераторов. Спектр сигнала	34
Приложение С (обязательное) Методы определения характеристик импульсных генераторов. Точное измерение выходного сигнала генератора наносекундных импульсов	35
Приложение D (обязательное) Влияние параметров измерительного приемника с квазипиковым детектором на его импульсную характеристику	37
Приложение E (обязательное) Импульсная характеристика измерительных приемников с детекторами пиковых и средних значений	38
Приложение F (обязательное) Проверка характеристик исключений из определения кратковременных ИРП в соответствии с ГОСТ 30804.14.1, пункт 4.2.3	46
Приложение G (справочное) Требования к нахождению функции распределения амплитуд ИРП	53
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	56
Библиография	57

Совместимость технических средств электромагнитная

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Часть 1-1

АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ
И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ

Electromagnetic compatibility of technical equipment. Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 1-1. Radio disturbance and immunity measuring apparatus. Measuring apparatus

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт является основополагающим стандартом, устанавливающим характеристики и качество функционирования аппаратуры для измерения напряжения, тока и напряженности поля промышленных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц.

В настоящем стандарте установлены также требования к специализированным приборам для измерений прерывистых ИРП.

Установленные в стандарте требования обеспечивают измерение широкополосных и узкополосных ИРП.

Настоящий стандарт распространяется на следующие виды измерителей ИРП:

- измерительный приемник с квазипиковым детектором;
- измерительный приемник с детектором пиковых значений;
- измерительный приемник с детектором средних значений;
- измерительный приемник с детектором среднеквадратических значений.

Требования настоящего стандарта должны выполняться на всех частотах и для всех уровней напряжения и тока ИРП в пределах диапазонов измерений СИСПР, установленных для измерительного оборудования.

Методы измерений установлены в [1], общая информация, относящаяся к радиопомехам, приведена в [2]. Сведения о неопределенности измерений, статистике и моделировании норм ИРП приведены в ГОСТ 30805.16.4.2 и [3].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 14777¹⁾ Радиопомехи промышленные. Термины и определения

ГОСТ 30372 (IEC 60050-161:1990) Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55055—2012 «Радиопомехи промышленные. Термины и определения».

ГОСТ 30805.11—2002 (СИСПР 11—97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Нормы и методы испытаний

ГОСТ 30805.14.1—2013 (СИСПР 14-1:2005) Совместимость технических средств устройства. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений

ГОСТ 30805.16.4.2¹⁾ (СИСПР 16-4-2:2003) Совместимость технических средств электромагнитная. Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 14777, ГОСТ 30372, [4], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **ширина полосы пропускания B_n** (bandwidth B_n): Ширина полосы частот измерительного приемника (ИП), на границах которой значение характеристики его частотной избирательности равно заданному значению, дБ. Индекс « n » — заданное значение характеристики частотной избирательности.

3.2 **ширина импульсной полосы пропускания B_{imp}** (impulse bandwidth B_{imp}): Величина, определяемая в соответствии с соотношением

$$B_{imp} = A(t)_{max} / (2G_0 \cdot IS),$$

где $A(t)_{max}$ — пиковое значение огибающей на выходе канала промежуточной частоты ИП при подаче на его вход импульса площадью IS ;

G_0 — коэффициент усиления каскадов, предшествующих детектору, на центральной частоте полосы пропускания.

В случае двух критически связанных резонансных трансформаторов $B_{imp} = 1,05B_6 = 1,31B_3$, где B_6 и B_3 — значения ширины полосы пропускания в точках 6 и 3 дБ соответственно (см. также приложение А, пункт А.2).

3.3 **площадь импульса IS** (иногда называемая мощностью импульса) (impulse area): Площадь под кривой $V(t)$, отображающей зависимость импульсного напряжения от времени, мкВс или дБ(мкВс), определяемая в соответствии с соотношением

$$IS = \int_{-\infty}^{+\infty} V(t) dt.$$

Примечание — Площадь импульса IS и спектральная плотность импульса D , мкВ/МГц или дБ(мкВ/МГц), связаны между собой. Для прямоугольных импульсов длительностью T на частотах $f \ll 1/T$ применяют соотношение D (мкВ/МГц) = $2 \cdot 10^9 IS$ (мкВс).

3.4 **постоянная времени заряда детектора T_C** (electrical charge time constant T_C): Время, необходимое для того, чтобы после подачи синусоидального напряжения постоянной амплитуды на вход

¹⁾ Утратил силу в Российской Федерации. Действует ГОСТ СИСПР 16-4-2—2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 4-2. Неопределенности, статистика и моделирование норм. Неопределенность измерений, вызываемая измерительной аппаратурой».

каскада, предшествующего детектору, напряжение на выходе детектора достигло 63 % установившегося значения.

Примечание — Постоянную времени детектора определяют следующим образом: синусоидальный сигнал постоянной амплитуды, имеющий частоту, равную центральной частоте полосы усилителя промежуточной частоты (ПЧ), подают на вход каскада, непосредственно предшествующего детектору. К усилителю постоянного тока подключают безынерционный прибор (например, осциллограф) и отмечают показание D , соответствующее установившемуся значению.

Для предотвращения перегрузки используемых каскадов устанавливают такой уровень входного сигнала, при котором выходной сигнал тракта остается в пределах линейного рабочего динамического диапазона. Затем синусоидальный сигнал такого же уровня с прямоугольной огибающей подают только на ограниченное время, устанавливаемое так, чтобы зарегистрированное показание измерительного прибора было 0,63 D . Длительность такого сигнала равна постоянной времени заряда детектора.

3.5 постоянная времени разряда детектора T_D (electrical discharge time constant T_D): Время, необходимое для того, чтобы после прекращения подачи синусоидального напряжения постоянной амплитуды на вход устройства, непосредственно предшествующего детектору, напряжение на выходе детектора уменьшилось до 37 % его первоначального значения.

Примечание — Метод измерения аналогичен методу для измерения постоянной времени заряда детектора, но вместо сигнала, подаваемого в течение ограниченного времени, этот сигнал прерывается на ограниченное время. Время, необходимое для того, чтобы показание прибора уменьшилось до 0,37 D , является постоянной времени разряда детектора.

3.6 механическая постоянная времени индикаторного прибора с критическим демпфированием T_M (mechanical time constant of a critically damped indicating instrument): Величина, определяемая в соответствии с соотношением

$$T_M = T_L / 2\pi,$$

где T_L — период свободных колебаний (при отсутствии демпфирования) подвижной системы индикаторного прибора.

Примечания

1 Для приборов с критическим демпфированием уравнение движения системы индикации может быть записано в виде

$$T_M^2 (d^2\alpha/dt^2) + 2T_M (d\alpha/dt) + \alpha = ki,$$

где α — отклонение стрелки индикаторного прибора;

i — ток через прибор;

k — константа.

Из этого соотношения можно заключить, что постоянная T_M также равна длительности прямоугольного импульса тока постоянной амплитуды, который вызывает отклонение, равное 35 % отклонения, создаваемого постоянным током (с такой же, как и у прямоугольного импульса, амплитудой).

2 Методы измерения и настройки устанавливают с учетом:

а) периода свободных колебаний, который должен быть установлен равным $2\pi T_M$; демпфирование вводят так, чтобы выполнялось соотношение $\alpha T = 0,35\alpha_{\max}$;

б) если период колебаний не может быть измерен, демпфирование устанавливают несколько ниже критического, так чтобы выброс не превышал 5 % и момент инерции движения был равен $\alpha T = 0,35\alpha_{\max}$.

3.7 коэффициент перегрузки (overload factor): Отношение максимального уровня, при котором амплитудная характеристика каскада (или группы каскадов) в установившемся режиме отличается на 1 дБ от линейной характеристики, к уровню, соответствующему отклонению стрелки индикаторного прибора на всю шкалу.

3.8 симметричное напряжение в двухпроводной схеме, например в однофазной сети питания (symmetrical voltage): Напряжение высокочастотной (ВЧ) помехи между двумя проводниками. Если V_a — векторное напряжение между одним из сетевых зажимов и землей, а V_b — векторное напряжение между другим сетевым зажимом и землей, то симметричное напряжение представляет собой разность векторов $V_a - V_b$.

Примечание — Иногда симметричное напряжение называют напряжением дифференциального режима.

3.9 диапазон измерений СИСПР (CISPR indicating range): Диапазон измерений, установленный производителем, определяющий максимальное и минимальное показания прибора, в пределах которого ИП соответствует требованиям настоящего стандарта.

4 Измерительные приемники с квазипиковым детектором для полосы частот от 9 кГц до 1000 МГц

Технические требования к измерительному приемнику (ИП) зависят от полосы частот, в которой он должен работать.

Установлены следующие полосы рабочих частот ИП:

- от 9 до 150 кГц (полоса частот А);
- от 0,15 до 30 МГц (полоса частот В);
- от 30 до 300 МГц (полоса частот С);
- от 300 до 1000 МГц (полоса частот D);
- от 1 до 18 ГГц (полоса частот E).

4.1 Входное сопротивление

ИП должен иметь несимметричный вход с номинальным значением входного сопротивления 50 Ом с КСВ по напряжению не более 2 — при ослаблении входного аттенюатора 0 дБ и не более 1,2 — при ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и более.

В полосе частот от 9 кГц до 30 МГц ИП должен иметь дополнительно симметричный вход (с использованием симметрирующего входного трансформатора).

В полосе частот от 9 до 150 кГц значение входного сопротивления должно быть равно 600 Ом. Симметрирующее входное устройство может быть включено в конструкцию соответствующего симметричного эквивалента сети, подключаемого к ИП, либо может быть встроено в ИП.

4.2 Основные параметры

Основные параметры ИП с квазипиковым детектором приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Основные параметры ИП с квазипиковым детектором

Параметр	Полоса частот		
	А 9—150 кГц	В 0,15—30 МГц	С и D 30—1000 МГц
Номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ (B_6), кГц	0,2	9	120
Постоянная времени заряда детектора, мс	45	1	1
Постоянная времени разряда детектора, мс	500	160	550
Механическая постоянная времени индикаторного прибора с критическим демпфированием, мс	160	160	100
Коэффициент перегрузки каскадов, предшествующих детектору, не менее, дБ	24	30	43,5
Коэффициент перегрузки усилителя постоянного тока между детектором и индикаторным прибором, не менее, дБ	6	12	6
<p>Примечания</p> <p>1 При определении механической постоянной времени (см. 3.6) предполагается, что индикаторный прибор является линейным, т. е. одинаковые приращения тока приводят к одинаковым приращениям отклонения. Индикаторный прибор, имеющий другое соотношение между током и отклонением, также может быть использован при условии, что прибор соответствует требованиям, установленным в настоящем разделе. При использовании электронного измерительного прибора его механическая постоянная времени может быть имитирована с использованием электронных схем.</p> <p>2 Допустимые отклонения электрических и механических постоянных времени не устанавливаются. Для обеспечения соответствия требованиям 4.4 реальные значения допустимых отклонений постоянных времени в конкретном ИП определяются его конструкцией.</p>			

4.3 Точность измерения синусоидального напряжения

Основная погрешность измерения синусоидального напряжения должна находиться в пределах ± 2 дБ при подаче напряжения от генератора синусоидального напряжения с выходным сопротивлением 50 Ом.

4.4 Точность измерения импульсного напряжения

Методы определения выходных характеристик импульсных генераторов, применяемых при испытаниях на соответствие требованиям настоящего пункта, приведены в приложениях В и С.

4.4.1 Амплитудное соотношение (абсолютная калибровка)

Показания ИП при подаче на его вход испытательных импульсов с площадью, вычисляемой через значение электродвижущей силы (ЭДС) и имеющей значение a , мкВ/с (см. таблицу 2), при сопротивлении источника 50 Ом и однородном спектре до частоты b , МГц, с частотой повторения c , Гц, должны быть на всех частотах настройки такими же, как и при подаче на его вход немодулированного синусоидального сигнала на частоте настройки со среднеквадратическим значением ЭДС 2 мВ [66 дБ(мкВ)]. Выходное сопротивление генераторов импульсов и синусоидальных сигналов должно быть одинаковым [см. также схемы, приведенные на рисунках 1b) и 1с)]. Допускаемое отклонение уровня напряжения синусоидального сигнала — не более $\pm 1,5$ дБ.

Таблица 2 — Характеристики испытательных импульсов для ИП с квазипиковым детектором

Полоса частот	a , мкВ/с	b , МГц	c , Гц
9—150 кГц	13,5	0,15	25
0,15—30 МГц	0,316	30	100
30—300 МГц	0,044	300	100
300—1000 МГц	0,044	1000	100

4.4.2 Импульсная характеристика (относительная калибровка)

Значения импульсной характеристики измерительного приемника должны находиться в пределах, обозначенных на рисунках 1а) — 1с), допустимые отклонения указаны в таблице 3.

Таблица 3 — Импульсная характеристика измерительного приемника с квазипиковым детектором

Частота повторения, Гц	Значения импульсной характеристики и ее допустимые отклонения, дБ. в полосе частот			
	A 9—150 кГц	B 0,15—30 МГц	C 30—300 МГц	D 300—1000 МГц
1000	Примечание 4	$-4,5 \pm 1,0$	$-8,0 \pm 1,0$	$-8,0 \pm 1,0$
100	$-4,0 \pm 1,0$	0 (опорное значение)	0 (опорное значение)	0 (опорное значение)
60	$-3,0 \pm 1,0$	—	—	—
25	0 (опорное значение)	—	—	—
20	—	$+6,5 \pm 1,0$	$+9,0 \pm 1,0$	$+9,0 \pm 1,0$
10	$+4,0 \pm 1,0$	$+10,0 \pm 1,5$	$+14,0 \pm 1,5$	$+14,0 \pm 1,5$
5	$+7,5 \pm 1,0$	—	—	—
2	$+13,0 \pm 2,0$	$+20,5 \pm 2,0$	$+26,0 \pm 2,0$	$(+26,0 \pm 2,0)^*$
1	$+17,0 \pm 2,0$	$+22,5 \pm 2,0$	$+28,5 \pm 2,0$	$(+28,5 \pm 2,0)^*$
Одиночный импульс	$+19,0 \pm 2,0$	$+23,5 \pm 2,0$	$+31,5 \pm 2,0$	$(+31,5 \pm 2,0)^*$
Примечания 1 Влияние параметров приемника на его импульсную характеристику рассматривается в приложении D. 2 Соотношения между импульсными характеристиками ИП с квазипиковым детектором и ИП с другими типами детекторов приведены в 5.4, 6.4.1 и 7.4.1. 3 Теоретические кривые импульсных характеристик ИП с квазипиковым детектором и детектором средних значений (совмещенных по абсолютной шкале) показаны на рисунке 1d).				

Окончание таблицы 3

<p>Ордината на рисунке 1d) показывает значения площади импульса при разомкнутой цепи в дБ (мкВс), что соответствует напряжению синусоидального сигнала E при разомкнутой цепи, равному 66 дБ(мкВ) в среднеквадратических значениях. Тогда показание U измерительного приемника, вход которого согласован с генератором синусоидального напряжения, будет 60 дБ(мкВ). Если ширина полосы измерения менее частоты повторения импульсов, кривые на рисунке 1d) соответствуют случаю, когда приемник настроен на одну дискретную линию спектра.</p> <p>4 На частотах повторения свыше 100 Гц в полосе частот от 9 до 150 кГц не представляется возможным определить отклик из-за частичного наложения импульсов в усилителе ПЧ.</p> <p>5 Метод расчета импульсных характеристик приведен в приложении А.</p> <p>6 Из-за перегрузки на входе ИП на частотах свыше 300 МГц значения импульсной характеристики при частоте повторения импульсов 2 Гц и ниже (отмечены сносками «*») являются рекомендуемыми.</p>

4.5 Частотная избирательность

4.5.1 Характеристика частотной избирательности

Значения характеристики частотной избирательности ИП должны находиться в пределах, указанных для каждой полосы частот на рисунках 2а) — 2д) соответственно.

Избирательность характеризуется зависимостью от частоты амплитуды входного синусоидального сигнала, при которой поддерживается постоянное показание ИП, полученное на частоте настройки приемника.

Примечание — Для измерения ИП от оборудования, которое требует более высокой избирательности в полосе частот от 130 до 150 кГц (например, для оборудования для передачи сигналов по электрической сети, указанного в [5]), перед ИП следует включить фильтр верхних частот, при этом должно быть обеспечено следующее значение относительного затухания:

Частота, кГц	Относительное затухание, дБ
150	≤ 1
146	≤ 6
145	≥ 6
140	≥ 34
130	≥ 81

Характеристики частотной избирательности ИП в комбинации с фильтром верхних частот должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.5.2 Коэффициент ослабления на промежуточной частоте

Отношение входных напряжений синусоидального сигнала на ПЧ и частоте настройки, при которых наблюдаются одинаковые показания ИП, должно быть не менее 40 дБ. Если в приемнике используется более чем одна ПЧ, данное требование должно выполняться на каждой промежуточной частоте.

4.5.3 Коэффициент ослабления на частоте зеркального канала

Отношение входных напряжений синусоидального сигнала на частоты зеркального канала и на частоте настройки, при которых наблюдаются одинаковые показания ИП, должно быть не менее 40 дБ. Если в приемнике используется более чем одна промежуточная частота, то это требование должно выполняться на частотах зеркального канала, соответствующих каждой промежуточной частоте.

4.5.4 Ослабление других паразитных каналов

Отношение входного напряжения синусоидального сигнала на частотах, отличных от указанных в 4.5.2 и 4.5.3, к напряжению на частоте настройки, при котором получается то же показание ИП, должно быть не менее 40 дБ. Частоты возможных паразитных каналов определяют с использованием соотношений

$$(1/m)(nf_L \pm f_j) \text{ и } (1/k)(f_c),$$

где m, n, k — целые числа;

f_L — частота местного гетеродина;

f_j — промежуточная частота;

f_c — частота настройки.

Примечание — Если в ИП используется более чем одна ПЧ, частоты f_1 и f_2 могут относиться к каждой используемой промежуточной частоте и частоте местного гетеродина. Кроме того, паразитные отклики могут возникать, если входной сигнал не подается на ИП, например когда гармоники местных гетеродинов отличаются по частоте на одну из промежуточных частот.

В этом случае требования данного подраздела не применяют. Воздействие таких паразитных откликов рассматривается в 4.7.2.

4.6 Ослабление продуктов интермодуляции

Испытание ИП на подверженность интермодуляционным воздействиям проводят следующим образом. Собирают схему измерений в соответствии с рисунком 3.

Импульсный генератор должен создавать импульс с равномерной спектральной плотностью до частоты f_3 (см. таблицу 4), выше которой амплитуда импульсов должна снижаться так, чтобы это ослабление на частоте f_4 было не менее 10 дБ. Режекторный фильтр должен иметь затухание на частоте испытания не менее 40 дБ. Полоса пропускания фильтра B_B , взятая по уровню 6 дБ относительно максимального затухания, должна находиться между частотами f_1 и f_2 , приведенными в таблице 4.

Таблица 4 — Значения частот при испытании ИП с квазипиковым детектором на эффекты интермодуляции

Полоса частот	f_1 , кГц	f_2 , кГц	f_3 , МГц	f_4 , МГц
9—150 кГц (полоса частот А)	0,4	4	0,15	0,3
0,15—30 МГц (полоса частот В)	20	200	30	60
30—300 МГц (полоса частот С)	500	2000	300	600
300—1000 МГц (полоса частот D)	500	6000	1000	2000

Ко входу измерительного приемника подключают генератор синусоидальных сигналов и подают от него сигнал такого уровня, чтобы показание индикаторного прибора ИП было легко определить. Затем генератор синусоидальных сигналов заменяют генератором импульсов, в котором устанавливают частоту повторения импульсов 100 Гц — для полосы частот А и 1000 Гц — для других полос частот, и добиваются того же самого показания.

При включении фильтра в цепь между импульсным генератором и измерительным приемником показания измерительного приемника должны уменьшиться не менее чем на 36 дБ.

4.7 Ограничение за счет собственных шумов ИП и ослабление собственных паразитных сигналов

4.7.1 Собственные шумы ИП

Дополнительная погрешность измерений, вносимая собственными шумами ИП, должна быть не более 1 дБ.

Примечание — Уровень входного сигнала, при котором погрешность, вносимая собственными шумами, составляет 1 дБ, определяют следующим образом.

Ко входу ИП подключают генератор синусоидальных сигналов и подают от него сигнал напряжением S , вызывающий показание индикаторного прибора ИП намного большее (например, на 40 дБ), чем уровень собственных шумов приемника N . Затем уровень входного сигнала снижают до значения S_1 , при котором показание индикаторного прибора ИП ($S_1 + N$) отклоняется от линейной характеристики на 1 дБ.

4.7.2 Паразитные каналы приема

Если в ИП используется двойное преобразование частоты, погрешность измерения из-за наличия паразитных каналов приема, как описано в примечании к 4.5.4, не должна быть более 1 дБ для любого входного сигнала, подаваемого на ИП.

Для ИП, в котором затухание формируется в тракте ПЧ, это требование должно считаться выполненным, если измерительный приемник при его испытании соответствует 4.7.1.

4.8 Эффективность экранирования

Под эффективностью экранирования ИП понимается мера его способности работать в электромагнитном поле без ухудшения качества функционирования. Экранирование приемника должно быть таким,

чтобы при его размещении в немодулированном электромагнитном поле напряженностью 3 В/м дополнительная погрешность на краях указанного производителем диапазона измерений СИСНР (см. 3.9) не превышала 1 дБ. Данное требование должно выполняться на любой частоте измерений в полосе частот от 9 кГц до 1000 МГц. Если требование не выполняется, производитель ИП должен указать значения соответствующих частот и значение напряженности поля, при котором погрешность снижается до 1 дБ.

Испытание проводят следующим образом.

Приемник помещают в экранированную камеру, в которой имеется источник испытательного поля. Генератор сигналов располагают вне камеры и подают от него сигнал на вход приемника через проходящий сквозь стену камеры двухметровый хорошо экранированный кабель (например, полужесткий). Ко всем другим коаксиальным разъемам приемника подключают нагрузки с сопротивлением, равным их волновому полному сопротивлению.

Отключают все соединительные провода, не требующиеся для нормального использования измерительного приемника в его минимальной конфигурации (исключая аксессуары, например головные телефоны). Провода, которые остались подсоединенными (например, входной кабель и сетевой шнур), должны иметь такую же длину и быть расположены так же, как при типовом использовании.

Диапазон изменения уровня входного сигнала должен быть достаточным для обеспечения граничных значений диапазона измерений СИСНР. Напряженность испытательного поля контролируют измерителем напряженности поля. Показание индикаторного прибора приемника при наличии испытательного поля не должно отличаться более чем на 1 дБ от показания при отсутствии поля.

4.8.1 Нормы на ИРП, создаваемые самим измерительным приемником

4.8.1.1 Напряжение ИРП на зажимах

Напряжение ИРП на любых зажимах ИП для подсоединения внешних линий (не только на сетевых зажимах) не должно превышать норм ИРП для оборудования класса Б, установленных в ГОСТ 30805.11—2002 (пункт 5.1).

Для экранированного оборудования не требуется проведение измерений напряжения ИРП на внутренних проводниках экранированных соединений.

Мощность, наведенная местным гетеродином на входе ИП при нагрузке входа на характеристическое полное сопротивление, не должна превышать 34 дБ(пВт), что эквивалентно напряжению 50 мкВ на сопротивлении 50 Ом.

4.8.1.2 Напряженность поля ИРП

Напряженность поля ИРП, создаваемых ИП, не должна превышать норм ИРП для оборудования класса Б, установленных в ГОСТ 30805.11—2002 (пункт 5.2) для полосы частот от 9 кГц до 1000 МГц. ИП должен соответствовать этим нормам также в полосах частот, выделенных для ПНМБ высокочастотных устройств (см. ГОСТ 30805.11—2002 (приложение Д)).

В полосе частот от 1 до 18 ГГц должна применяться норма 45 дБ(пВт).

До проведения измерений по 4.8.1.1, 4.8.1.2 необходимо убедиться, что собственные шумы испытательного оборудования не оказывают влияния на результаты измерений ИП (например, при компьютерном контроле).

4.9 Подключение анализатора кратковременных ИРП

Приемник должен иметь выход промежуточной частоты и выход квазипикового детектора для возможности измерения прерывистых ИРП во всех полосах частот. Подключение нагрузки к этим выходам не должно оказывать влияния на показания индикаторного прибора ИП.

5 Измерительные приемники с детектором пиковых значений для полосы частот от 9 кГц до 18 ГГц

В настоящем разделе установлены требования к ИП с детектором пиковых значений, которые используются для измерения импульсных или импульсно-модулированных ИРП. При измерениях на соответствие нормам ИРП могут быть использованы также анализаторы спектра, соответствующие требованиям настоящего раздела.

5.1 Входное сопротивление

ИП должен иметь несимметричный вход. При установках органов управления приемника в диапазоне измерений СИСНР номинальное значение входного сопротивления должно быть равно 50 Ом с КСВ по напряжению, не превышающему значений, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 — Требования по КСВ к входному сопротивлению ИП

Полоса частот	Затухание по ВЧ, дБ	КСВ, не более
9 кГц — 1 ГГц	0	2,0
9 кГц — 1 ГГц	≥ 10	1,2
1—18 ГГц	0	3,0
1—18 ГГц	≥ 10	2,0

В полосе частот от 9 кГц до 30 МГц должен быть дополнительно обеспечен симметричный вход (с помощью симметрирующего входного трансформатора). Рекомендуемое значение входного сопротивления для полосы частот от 9 до 150 кГц равно 600 Ом. Симметрирующее входное устройство может быть включено в конструкцию соответствующего симметричного эквивалента сети, подключаемого к ИП, либо встроено в ИП.

5.2 Основные параметры

5.2.1 Ширина полосы пропускания

Для широкополосных ИРП всех видов должны указываться фактическое (эффективное) значение ширины полосы пропускания с указанием измеренного уровня ИРП и значения B_B или B_{imp} , требования к которым приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Требования к ширине полосы пропускания

Полоса частот	Интервал допустимых значений B_B	Номинальное значение
9—150 кГц (полоса частот А)	100 Гц — 300 Гц ¹⁾	200 Гц (B_B)
0,15—30 МГц (полоса частот В)	8 кГц — 10 кГц ¹⁾	9 кГц (B_B)
30—1000 МГц (полосы частот С и D)	100 кГц — 500 кГц ¹⁾	120 кГц (B_B)
1—18 ГГц (полоса частот Е)	300 кГц — 2 МГц ¹⁾	1 МГц ²⁾ (B_{imp})

¹⁾ Так как показания ИП с детектором пиковых значений при измерении не перекрывающихся импульсов пропорциональны ширине его импульсной полосы пропускания (см. 3.2), то в результате учитывается либо фактическая ширина полосы пропускания, либо уровень «при ширине полосы пропускания 1 МГц», который рассчитывается делением измеренного значения на ширину полосы импульса, МГц. Для широкополосных ИРП других видов эта процедура может привести к ошибке. В спорном случае преимущество имеют данные, измеренные при опорной ширине полосы пропускания.

²⁾ Выбираемая ширина полосы пропускания ИП должна определяться как ширина импульсной полосы пропускания с допуском $\pm 10\%$.

5.2.2 Отношение постоянных времени заряда и разряда

Чтобы при частоте повторения импульсов 1 Гц показания ИП находились в пределах 10 % истинного пикового значения, отношение постоянной времени разряда к постоянной времени заряда должно быть не менее приведенных ниже значений:

- $1,89 \cdot 10^4$ — в полосе частот от 0,009 до 0,15 МГц;
- $1,25 \cdot 10^6$ — в полосе частот от 0,15 до 30 МГц;
- $1,67 \cdot 10^7$ — в полосе частот от 30 до 1000 МГц;
- $1,34 \cdot 10^8$ — в полосе частот от 1 до 18 ГГц.

Если имеется возможность удержания пикового значения, время удержания должно быть в пределах от 30 мс до 3 с.

Примечание — Требование к отношению постоянных времени заряда и разряда не предъявляется к ИП с удержанием пикового значения (и принудительным разрядом после времени удержания) и к ИП, в которых применены цифровые методы обнаружения пикового значения. Для сигналов с меняющимися по времени амплитудами допускается использование функции максимального удержания.

Если для измерений пиковых значений ИРП используют анализатор спектра, то значение ширины полосы видеотракта B_{video} устанавливают не менее полосы разрешения B_{reso} . При измерениях

пиковых значений ИРП результат считывают с дисплея анализатора спектра в линейном или логарифмическом режиме.

5.2.3 Коэффициент перегрузки

Для ИП с детектором пиковых значений коэффициент перегрузки не должен быть таким большим, как для других типов ИП. Для большинства детекторов прямого отсчета необходимо, чтобы коэффициент перегрузки был немного больше единицы. Коэффициент перегрузки должен соответствовать используемому постоянному времени заряда и разряда (см. 5.2.2).

5.3 Точность измерения синусоидального напряжения

Погрешность измерения синусоидального напряжения должна быть менее ± 2 дБ ($\pm 2,5$ дБ на частотах свыше 1 ГГц) при подаче синусоидального сигнала от источника с активным выходным сопротивлением 50 Ом.

5.4 Точность измерения импульсного напряжения

Показания ИП на частотах свыше 1000 МГц при подаче на его вход испытательных импульсов с площадью, вычисляемой через значение ЭДС и имеющей значение $1,4/V_{имп}$ мВс (где $V_{имп}$ выражено в герцах) от генератора с выходным сопротивлением 50 Ом и однородным спектром (см. таблицу 2, пункт 4.4.1), должны быть на всех частотах настройки такими же, как и при подаче немодулированного синусоидального сигнала на частоте настройки со среднеквадратическим значением ЭДС 2 мВ [66 дБ(мкВ)]. Выходные сопротивления источников (генератора импульсов и генератора сигналов) должны быть одинаковыми [см. рисунки 1b) и 1c)].

По уровню напряжения синусоидального сигнала разрешается допуск

$$\alpha = \pm 1,5 \text{ дБ.}$$

Эти требования относятся ко всем частотам повторения импульсов, при которых на выходе усилителя ПЧ не возникают перекрывающиеся импульсы.

Примечания

1 Методы определения выходных характеристик импульсных генераторов, применяемых при испытаниях на соответствие требованиям настоящего пункта, приведены в приложениях В и С.

2 Отношения показаний ИП с пиковым и квазипиковым детекторами с номинальной шириной полосы пропускания при частоте повторения 25 Гц — для полосы частот А, при частоте повторения 100 Гц — для других полос частот приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Отношение показаний ИП с пиковым и квазипиковым детекторами при одинаковой ширине полосы пропускания (полоса частот от 9 кГц до 1000 МГц)

Полоса частот	I_S , мВс	$V_{имп}$, Гц	Отношение показаний детекторов пикового и квазипикового значений, дБ, для частот повторения импульсов	
			25 Гц	100 Гц
А	$6,67 \cdot 10^{-3}$	$0,21 \cdot 10^3$	6,1	—
В	$0,148 \cdot 10^{-3}$	$9,45 \cdot 10^3$	—	6,6
С и D	$0,011 \cdot 10^{-3}$	$126,0 \cdot 10^3$	12,0	

Примечание — Значение величины $V_{имп}$ определяется только на основе номинальной ширины полосы пропускания (см. таблицу 6).

На частотах свыше 1 ГГц в качестве испытательных сигналов используют импульсно-модулированную несущую на частоте, равной частоте настройки ИП, так как генераторов импульсов с однородным спектром в полосе частот до 18 ГГц (см. приложение Е, пункт Е.6) не существует.

5.5 Частотная избирательность

Так как требования по ширине полосы пропускания ИП, приведенные в 5.2.1, допускают отклонения относительно полос, приведенных на рисунках 2a) — 2c) применительно к ИП с пиковым

детектором, эти кривые избирательности применяются только в отношении требования сохранения их формы; при этом оси частот должны быть соответственно масштабированы. Например, $B_B/2$ должно соответствовать частоте 100 Гц на рисунке 2а).

Требования к частотной избирательности ИП совпадают с требованиями, приведенными в 4.5.2—4.5.4.

Характеристика частотной избирательности ИП с эталонной шириной полосы пропускания в полосе частот Е должна находиться в пределах, указанных на рисунке 2д).

5.6 Эффекты интермодуляции, шумы приемника и экранирование

Для полосы частот ниже 1 ГГц действуют требования, приведенные в 4.6—4.8. Требования, установленные в 4.7 и 4.8.1, действуют также для полосы Е.

Требования к эффектам интермодуляции для этой полосы находятся на рассмотрении.

В этой полосе при измерении паразитных сигналов низкого уровня при наличии сильного основного сигнала на входе испытуемого приемника (внутри или снаружи) ставят фильтр (фильтр преселекции для полосы Е), который обеспечивает требуемое затухание на основной частоте, защищая входные схемы приемника от перегрузки и повреждений и предотвращая генерацию гармоник и эффекты интермодуляции.

Примечания

1 Обычно затухание фильтра на основной частоте испытуемого приемника выбирают равным 30 дБ.

2 Если основных частот больше чем одна, могут потребоваться несколько фильтров.

Требования к эффективности экранирования, т. е. к помехоустойчивости при высоких уровнях излучаемых помех в окружающей среде, находятся на рассмотрении.

6 Измерительные приемники с детектором средних значений для полосы частот от 9 кГц до 18 ГГц

Настоящий раздел устанавливает требования к ИП с детектором средних значений, которые используются для измерения среднего значения огибающей сигнала, проходящего через каскады, предшествующие детектору, и дают возможность выполнять измерения узкополосных сигналов при различных видах модуляции или при наличии широкополосного шума.

Для измерений импульсных ИРП измерительные приемники с детектором средних значений обычно не используются.

При испытаниях на соответствие нормам ИРП могут быть использованы анализаторы спектра, соответствующие требованиям настоящего раздела.

6.1 Входное сопротивление

Измерительный приемник должен иметь несимметричный вход. При установках органов управления приемником в диапазоне измерений СИСПР номинальное значение входного сопротивления должно быть равно 50 Ом с коэффициентом стоячей волны (КСВ) по напряжению, не превышающим значений, приведенных в таблице 5.

В полосе частот от 9 до 150 ГГц дополнительно должен быть обеспечен симметричный вход с номинальным значением сопротивления 600 Ом. Симметрирующий входной трансформатор может быть встроен в ИП либо в соответствующий симметричный эквивалент сети, подключаемый к ИП.

6.2 Основные параметры

6.2.1 Ширина полосы пропускания

Ширина полосы пропускания ИП B_B должна находиться в пределах значений, указанных в таблице 8.

Таблица 8 — Требования к ширине полосы пропускания ИП

Полоса частот	Ширина полосы пропускания B_B	Рекомендуемая ширина полосы пропускания
0,009—0,15 МГц (полоса частот А)	100—300 Гц ¹⁾	200 Гц (B_B)
0,15—30 МГц (полоса частот В)	8—10 кГц ¹⁾	9 кГц (B_B)

Окончание таблицы 8

Полоса частот	Ширина полосы пропускания $B_{\text{в}}$	Рекомендуемая ширина полосы пропускания
30—1000 МГц (полосы частот С и D)	100—500 кГц ¹⁾	120 кГц ($B_{\text{в}}$)
1—18 ГГц (полоса частот E)	300 кГц — 2 МГц ¹⁾	1 МГц ²⁾ ($B_{\text{втр}}$)

¹⁾ О ширине полосы пропускания ИП с детектором средних значений см. приложение E, пункт E.1. Если используют ширину полосы пропускания, отличающуюся от рекомендуемой, ее значение указывают вместе с измеренным уровнем ИРП.

²⁾ Выбираемая ширина полосы пропускания ИП должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 6.

6.2 Коэффициент перегрузки

В ИП с детектором средних значений коэффициент перегрузки каскадов, предшествующих детектору, должен быть равен $B_{\text{втр}}/n$, где n — частота повторения импульсов ($B_{\text{втр}}$ и n — в герцах). Приемник не должен перегружаться при частоте повторения импульсов, равной или большей 25 Гц — для полосы частот А, 500 Гц — для полосы частот В и 5000 Гц — для полос частот С и D.

Примечание — В общем случае для ИП с детектором средних значений невозможно обеспечить коэффициент перегрузки, позволяющий избежать нелинейности при работе приемника на очень низких частотах повторения импульсов (отклик на единичный импульс не определяется).

6.3 Точность измерения синусоидального напряжения

Погрешность измерения синусоидального напряжения должна находиться в пределах ± 2 дБ ($\pm 2,5$ дБ на частотах свыше 1 ГГц) при подаче напряжения от генератора синусоидального напряжения с выходным сопротивлением 50 Ом.

6.4 Точность измерения импульсного напряжения

Методы определения выходных характеристик импульсных генераторов, применяемых при испытаниях на соответствие требованиям настоящего подраздела, приведены в приложениях В и С.

6.4.1 Амплитудное соотношение

Показания ИП на частотах до 1 ГГц при подаче на его вход испытательных импульсов с частотой повторения n , Гц, и площадью, вычисляемой через значение ЭДС и имеющей значение $1,4/n$ мВс, от генератора с выходным сопротивлением 50 Ом и однородным спектром (см. таблицу 2, подраздел 4.4.1), должны быть на всех частотах настройки такими же, как и при подаче немодулированного синусоидального сигнала на частоте настройки со среднеквадратическим значением ЭДС, равным 2 мВ [66 дБ(мкВ)]. Выходные сопротивления источников (генератора импульсов и генератора сигналов) должны быть одинаковыми [см. рисунки 1b) и 1c)].

Значения n должны быть равны 25 Гц — для полосы частот А; 500 Гц — для полосы частот В и 5000 Гц — для полос частот С и D. Допускается отклонение уровня синусоидального напряжения от минус 0,5 до 2,5 дБ.

Примечание — Отношение показаний ИП с детектором средних значений и детектором квазипиковых значений, имеющих одинаковую ширину полосы пропускания, при частотах повторения импульсов 25, 100, 1000 и 10 000 Гц, наблюдаемых при условии, что коэффициенты перегрузки соответствуют требованиям и выходной уровень является постоянным, приведено в таблице 9.

Т а б л и ц а 9 — Отношение значений импульсных характеристик ИП с детектором средних значений и детектором квазипиковых значений, имеющими одинаковую ширину полосы пропускания

Полоса частот ИП, МГц	Отношение показаний ИП с детекторами квазипикового и среднего значений, дБ, для частот повторения импульсов				
	25 Гц	100 Гц	500 Гц	1000 Гц	5000 Гц
0,009—0,15 (полоса частот А)	12,4	—	—	—	—
0,15—30 (полоса частот В)	—	(32,9)	22,9	(17,4)	—

Окончание таблицы 9

Полоса частот ИП, МГц	Отношение показаний ИП с детекторами квазиликового и среднего значений, дБ, для частот повторения импульсов				
	25 Гц	100 Гц	500 Гц	1000 Гц	5000 Гц
30—1000 (полосы частот С и D)	—	—	—	(38,1)	26,3
Примечания 1 Импульсная характеристика получена при использовании рекомендуемой ширины полосы пропускания (см. таблицу 8). 2 Значения в скобках даны только для информации.					

На частотах свыше 1 ГГц (полоса частот E) установлены два режима функционирования детектора средних значений: линейный и логарифмический.

При линейном режиме детектора средних значений на частотах до 1 ГГц показания ИП при подаче на его вход от генератора с выходным сопротивлением 50 Ом испытательных импульсов с частотой повторения n , Гц, и площадью, вычисляемой через значение ЭДС и имеющей значение $1,4/n$ мВс, должны быть такими же, как и при подаче немодулированного синусоидального сигнала на частоте настройки со среднеквадратическим значением ЭДС, равным 2 мВ [66 дБ(мкВ)].

В качестве последовательности испытательных импульсов должна использоваться импульсно-модулированная несущая.

Значение n должно быть равно 50 000. Допускаемое отклонение уровня синусоидального напряжения $\pm 1,5$ дБ.

Для логарифмического режима показания ИП при подаче на его вход испытательных импульсов с частотой повторения 333 кГц (период следования импульсов 3 мкс) и площадью, вычисляемой через ЭДС и имеющей значение 6,7 нВс при полном сопротивлении источника 50 Ом, должны быть на всех частотах настройки такими же, как и при подаче немодулированного синусоидального сигнала на частоте настройки со среднеквадратическим значением ЭДС, равным 2 мВ [66 дБ(мкВ)]. Допускаемое отклонение уровня синусоидального напряжения ± 4 дБ (допуск 10 % — для ширины полосы пропускания обуславливает возможное отклонение приблизительно $\pm 2,5$ дБ). Более подробная информация приведена в приложении E, пункт E.6.

Примечания

1 Для детектирования средних значений могут использоваться анализаторы спектра с шириной полосы видеотракта $B_{\text{видео}} \ll B_{\text{ресол}}$. При измерениях с использованием уменьшенной ширины полосы видеотракта для нормальной работы фильтра видеосигнала необходимо обеспечить достаточно большое время сканирования.

2 При измерениях средних (взвешенных) значений в линейном режиме результат будет соответствовать среднему уровню измеряемого сигнала. В логарифмическом режиме результат будет соответствовать среднему из логарифмических значений измеряемого сигнала. Следовательно, при импульсном прямоугольном сигнале со скажностью, равной 2 (сигнале, имеющем форму меандра), принимающем попеременно значения 20 и 60 дБ(мкВ), получаемый уровень в логарифмическом режиме будет равен 40 дБ(мкВ), тогда как в линейном режиме реальное среднее значение сигнала равно 54,1 дБ(мкВ).

6.4.2 Импульсная характеристика

Отклик ИП с детектором средних значений в линейном режиме на повторяющиеся импульсы должен быть таким, чтобы при постоянном показании ИП соотношение между амплитудой и частотой повторения импульсов на входе ИП выражалось обратно пропорциональной зависимостью.

В полосе частот между наименьшей частотой повторения импульсов (выбираемой из требования к коэффициенту перегрузки) и частотой, равной $B_3/2$, допускается отклонение импульсной характеристики в пределах от +3 до -1 дБ.

Примечание — Теоретические кривые импульсных характеристик ИП с квазиликовым детектором и детектором средних значений представлены на рисунке 1г), имеющем шкалу в абсолютных единицах.

Отклик ИП с детектором средних значений в логарифмическом режиме (частота свыше 1 ГГц) на повторяющиеся импульсы зависит от уровня помех между импульсами. Используя следующие величины:

- $L_{\text{логAV}}$ — уровень, измеренный детектором средних значений в логарифмическом режиме;
- T_P — длительность импульса, мкс;
- L_P — значение амплитуды импульса, дБ(мкВ);

T_N — длительность помех между импульсами, мкс;

L_N — уровень помех, дБ(мкВ),

получим соотношение

$$L_{\log Av} = \left(\frac{T_p L_p + T_N L_N}{T_p + T_N} \right).$$

Пример — Если значение амплитуды импульсов $L_p = 85$ дБ(мкВ) и уровень помех $L_N = 8$ дБ(мкВ), $T_p = 1/V_{\text{imp}} = 1$ мкс, частота повторения импульсов $n = 100\,000$, то $T_N = 9$ мкс. Тогда $L_{\log Av} = 15,7$ дБ(мкВ).

В действительности значение $L_{\log Av}$ будет больше из-за того, что значение T_p больше, так как после окончания импульса длительностью 1 мкс импульсный сигнал на выходе ПЧ мгновенно не уменьшается до уровня помех.

6.4.3 Измерение скачкообразных, нестабильных и «дрейфующих» узкополосных ИРП

Отклик на скачкообразные, нестабильные и «дрейфующие» узкополосные помехи должен быть таким, чтобы результат измерения был равен показанию пикового прибора с постоянной времени 0,16 с — для полос частот А и В и 100 мс — для полос частот С и D, как показано на рисунке 5. Постоянная времени определена в А.3.1.

Такие измерения можно провести с помощью схемы, имитирующей индикаторный прибор, установленной после детектора огибающей. Например, пиковое значение можно получить непрерывным контролем выходного сигнала прибора с использованием аналого-цифрового преобразователя и микропроцессора, как показано на рисунке 4.

Для полосы частот Е постоянная времени детектора средних значений в линейном режиме равна 0,1 с; требования к логарифмическому детектору средних значений находятся на рассмотрении.

Из сказанного выше следует, что при высокочастотном синусоидальном входном сигнале, модулированном повторяющимися прямоугольными импульсами с длительностью и периодом, указанными в таблице 10, показание ИП с детектором средних значений должно быть максимальным в соответствии с таблицей 10, при этом разрешается допуск $\pm 1,0$ дБ.

Таблица 10 — Максимальное показание ИП с детектором средних значений при синусоидальном входном сигнале, модулированном импульсами, по сравнению с откликом на незатухающее гармоническое колебание такой же амплитуды

Длительность модулирующих прямоугольных импульсов при периоде следования 1,6 с	Полосы частот измерительного приемника А, В	Полосы частот измерительного приемника С, D
$T_M = 0,16$ с $T_M = 0,1$ с	0,353 (– 9,0 дБ) —	— 0,353 (– 9,0 дБ)
Примечание — В полосе частот Е эти показания справедливы только для линейного детектора средних значений.		

6.5 Частотная избирательность

Характеристика частотной избирательности ИП с шириной полосы пропускания 200 Гц (измерения в полосе частот 0,009—0,15 МГц) должна находиться в пределах, указанных на рисунке 2а), с шириной полосы пропускания 9 кГц (измерения в полосе частот 0,15—30 МГц) — на рисунке 2б) и с шириной полосы пропускания 120 кГц (измерения в полосе частот 30—1000 МГц) — на рисунке 2с). Для приемников, имеющих другую ширину полосы пропускания, рисунки 2а) — 2с) описывают только форму характеристики избирательности; при этом ось частоты соответственно масштабируется (см. 5.5). Характеристика частотной избирательности ИП для полосы частот Е должна находиться в пределах, указанных на рисунке 2д).

Примечание — Для измерения ИРП от технических средств, которые требуют более высокой избирательности ИП на участке частот между 130 кГц и 150 кГц (например, оборудование для передачи сигналов по электрической сети, как установлено в [5]), перед измерительным приемником устанавливают фильтр верхних частот.

Значения относительного затухания (измерительного приемника СИСПР и фильтра верхних частот) приведены ниже.

Частота, кГц	Относительное затухание, дБ
150	≤ 1
146	≤ 6
145	≥ 6
140	≥ 34
130	≥ 81

Измерительный приемник вместе с фильтром верхних частот должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.

6.6 Эффекты интермодуляции, шумы приемника и экранирование

Эффекты интермодуляции, шумы приемника и экранирование должны соответствовать требованиям 5.6.

7 Измерительные приемники с детектором среднеквадратических значений для полосы частот от 9 кГц до 18 ГГц

При измерениях на соответствие нормам ИРП могут использоваться анализаторы спектра, соответствующие требованиям настоящего раздела.

7.1 Входное сопротивление

ИП должен иметь несимметричный вход. При установках органов управления приемника в диапазоне измерений СИСПР номинальное значение входного сопротивления должно быть равно 50 Ом с КСВ по напряжению, не превышающему значений, приведенных в таблице 5.

Для измерения симметричного напряжения ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 МГц должен быть обеспечен дополнительный симметричный вход (с помощью симметрирующего входного трансформатора).

Для полосы частот от 9 до 150 кГц рекомендуемое значение входного сопротивления должно быть равно 600 Ом. Симметрирующее входное устройство может быть встроено в ИП либо включено в конструкцию соответствующего симметричного эквивалента сети, подключаемого к ИП.

7.2 Основные параметры

7.2.1 Ширина полосы пропускания

Значения ширины полосы пропускания ИП должны находиться в пределах, указанных в таблице 11.

Таблица 11 — Значения ширины полосы пропускания ИП

Полоса частот	Ширина полосы пропускания B_B	Рекомендуемая ширина полосы пропускания
0,009—0,15 МГц (полоса частот А)	100 Гц — 300 Гц ¹⁾	200 Гц (B_B)
0,15—30 МГц (полоса частот В)	8 кГц — кГц ¹⁾	9 кГц (B_B)
30—1000 МГц (полосы частот С и D)	100 кГц — 500 кГц ¹⁾	120 кГц (B_B)
1—18 ГГц (полоса частот Е)	300 кГц — 2 МГц ¹⁾	1 МГц ²⁾ ($B_{\text{нр}}$)

¹⁾ Вопрос о ширине полосы пропускания ИП с детектором средних значений рассмотрен в приложении Е, раздел Е.1. Если используют ширину полосы пропускания, отличающуюся от номинальной, ее значение указывают вместе с измеренным уровнем ИРП.

²⁾ Выбираемая ширина полосы пропускания ИП должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 6.

7.2.2 Коэффициент перегрузки

Коэффициент перегрузки каскадов, предшествующих детектору, должен быть равен $1,27(B_3/n)^{1/2}$, где n — частота повторения импульсов; n и B_3 измеряют в герцах.

Примечания

1 В общем случае при таком типе детектора будет невозможно обеспечить достаточный коэффициент перегрузки для обеспечения линейного режима работы прибора при очень низких частотах повторения импульсов (отклик на единичный импульс не определяется). При любом применении данного детектора должна быть указана минимальная частота повторения импульса, не приводящая к перегрузке детектора.

2 Расчет коэффициента перегрузки приведен в приложении А.

7.3 Точность измерения синусоидального напряжения

Погрешность измерения синусоидального напряжения должна находиться в пределах ± 2 дБ ($\pm 2,5$ дБ на частотах свыше 1 ГГц) при выходном сопротивлении источника 50 Ом.

7.4 Точность измерения импульсного напряжения

Методы определения выходных характеристик импульсных генераторов, применяемых при испытаниях на соответствие требованиям настоящего подраздела, приведены в приложениях В и С.

7.4.1 Амплитудное соотношение

Показания ИП на частотах, не превышающих 1000 МГц, при подаче на его вход испытательных импульсов с частотой повторения n , Гц, и площадью, вычисляемой через значение ЭДС и имеющей значения $|278(B_3)^{-1/2}|$ мВс — для полосы частот А и $|139(B_3)^{-1/2}|$ мВс — для полос частот В, С и D (при значении B_3 , выраженном в герцах) при сопротивлении источника 50 Ом и спектре, однородном по крайней мере до наивысшей частоты настройки приемника (см. таблицу 2, пункт 4.4.1), должны быть на всех частотах настройки такими же, как и при подаче немодулированного синусоидального сигнала на частоте настройки со среднеквадратическим значением ЭДС, равным 2 мВ [66 дБ(мкВ)]. Сопротивления источников (генератора импульсов и генератора сигналов) должны быть одинаковыми [см. рисунки 1b) и 1c)]. Значение n должно быть равно 25 — для полосы частот А и 100 — для полос частот В—D. Допустимое отклонение уровня синусоидального напряжения — $\pm 1,5$ дБ.

Примечание — Расчет импульсной характеристики детектора среднеквадратических значений приведен в приложении А. Отношение показаний ИП с детектором среднеквадратических значений и ИП с квазиликовым детектором, имеющим ту же полосу, для частот повторения импульсов 25 и 100 Гц приведено в таблице 12.

На частотах свыше 1 ГГц (полоса Е) показания ИП при подаче на его вход испытательных импульсов с частотой повторения 1000 Гц и площадью, вычисляемой через значение ЭДС и имеющей значение $|44(B_3)^{-1/2}|$ мкВс, должны быть на всех частотах настройки такими же, как при подаче немодулированного синусоидального сигнала на частоте настройки со среднеквадратическим значением ЭДС, равным 2 мВ [66 дБ(мкВ)]. В качестве последовательности испытательных импульсов должна использоваться импульсно-модулированная несущая. Более подробную информацию см. в приложении Е.6.

Т а б л и ц а 12 — Отношение показаний ИП с квазиликовым детектором и детектором среднеквадратических значений на частотах повторения импульсов 25 и 100 Гц

Полоса частот ИП	Частота повторения импульсов, Гц	Отношение показаний ИП с квазиликовым детектором и детектором среднеквадратических значений, дБ
9—150 кГц (полоса частот А)	25	4,2
0,15—30 МГц (полоса частот В)	100	14,3
30—1000 МГц (полосы частот С и D)	100	20,1

7.4.2 Импульсная характеристика

Отклик ИП с детектором среднеквадратических значений на повторяющиеся импульсы должен быть таким, чтобы при постоянных показаниях на выходе ИП амплитуда импульсов была обратно пропорциональна корню квадратному из значения частоты.

Значения импульсной характеристики должны находиться в пределах, указанных в таблице 13.

Таблица 13 — Импульсная характеристика ИП с детектором среднеквадратических значений

Частота повторения импульсов, Гц	Относительный эквивалентный уровень импульса, дБ			
	для полосы частот А	для частот полосы В	для полос частот С и D	для полосы частот Е
100 000	—	—	—	$-20 \pm 2,0$
10 000	—	—	$-20 \pm 2,0$	$-10 \pm 1,0$
1000	—	$-10 \pm 1,0$	$-10 \pm 1,0$	0 (опорный уровень)
100	$-6 \pm 0,6$	0 (опорный уровень)	0 (опорный уровень)	$-10 \pm 1,0$
25	0 (опорный уровень)	$+6 \pm 0,6$	$+6 \pm 0,6$	—
20	$+1 \pm 0,7$	$+7 \pm 0,7$	$+7 \pm 0,7$	—
10	$+4 \pm 1,0$	$+10 \pm 1,0$	$+10 \pm 2,0$	—
2	$+11 \pm 1,7$	$+17 \pm 1,7$	—	—
1	$+14 \pm 2,0$	$+20 \pm 2,0$	—	—

7.5 Частотная избирательность

Так как требования к ширине полосы пропускания, приведенные в 7.2.1, допускают отклонения относительно значений тех полос, которые приведены на рисунках 2а) — 2с) применительно к ИП с детектором среднеквадратических значений, эти кривые избирательности применяются только в отношении требования сохранения их формы; при этом оси частот соответственно масштабируются.

Например, $B_g/2$ соответствует частоте 100 Гц на рисунке 2а).

Характеристика частотной избирательности ИП с шириной полосы пропускания для полосы частот Е должна находиться в пределах, указанных на рисунке 2d).

Требования к частотной избирательности должны соответствовать требованиям, приведенным в 4.5.2—4.5.4.

7.6 Эффекты интермодуляции, шумы приемника и экранирование

В соответствии с требованиями, установленными в 5.6.

8 Измерительные приемники с определением функции распределения амплитуд ИРП для полосы частот от 1 до 18 ГГц

Функцию распределения амплитуд ИРП определяют как зависимость от амплитуды суммарного времени, в течение которого амплитуда ИРП превышает заданный уровень. В общем случае функцию распределения амплитуд ИРП определяют на фиксированной частоте, выражая амплитуду ИРП в значениях напряженности поля или напряжения на входе ИП.

Функция распределения амплитуд может быть измерена при помощи специальных схем, включенных в ИП или анализатор спектра, или при помощи отдельного устройства.

Функция распределения амплитуд ИРП может быть измерена различными способами.

При одном из них используются устройства сравнения и подсчета, которые определяют время превышения амплитудой ИРП установленных уровней напряжения из заранее выбранного набора (см. рисунок G.1). Число устройств сравнения должно быть равно числу уровней.

При другом способе используют аналого-цифровой преобразователь, логическую схему и устройство памяти (см. рисунок G.2).

Функция распределения амплитуд ИРП может быть представлена в виде графика на экране дисплея для заранее установленного числа уровней. Число выбираемых уровней зависит от разрешающей способности используемого аналого-цифрового преобразователя (например, 256 уровней — для 8-битового преобразователя).

Нахождение функции распределения амплитуд ИРП целесообразно проводить при испытании ТС, которые могут создавать помехи цифровым системам связи (относительно информации о требованиях к измерению функции распределения амплитуд ИРП см. также поправку 1 к [2]).

При нахождении функции распределения амплитуд ИРП должны выполняться следующие технические требования (обоснование этих требований приведено в приложении G):

- a) динамический диапазон амплитуды ИРП должен превышать значение 60 дБ;
- b) точность измерения амплитуд, включая погрешность установки порогового уровня, должна превышать $\pm 2,7$ дБ;
- c) максимальное время измерения помехи должно быть не менее 2 мин. Измерение прерывистых помех допускается проводить, если время отсутствия помех составляет менее 1 % всего времени измерения;
- d) минимальное значение измеряемой вероятности должно быть 10^{-7} ;
- e) измерение функции распределения амплитуд ИРП должно проводиться не менее чем при двух уровнях амплитуды. Одновременно подсчитывают вероятности, соответствующие всем предварительно выбранным уровням. Значение разрешения предварительно выбранных уровней амплитуды должно быть не ниже 0,25 дБ;
- f) скорость выборки в отчетах должна быть не менее 10 млн/с при полосе разрешения 1 МГц;
- g) для аппаратуры измерения функции распределения амплитуд ИРП с аналого-цифровым преобразователем разрешение по амплитуде дисплея, отображающего функцию распределения, должно быть менее 0,25 дБ (рекомендуемое требование).

Примечание — Измерение функции распределения амплитуд ИРП допускается проводить в полосе частот ниже 1 ГГц.

9 Анализаторы кратковременных ИРП

Анализаторы кратковременных ИРП применяют для автоматической оценки амплитуды, частоты и длительности прерывистых (кратковременных) ИРП. Кратковременная ИРП имеет следующие признаки:

- a) квазипиковое значение ИРП превышает норму квазипиковых значений непрерывных ИРП;
- b) длительность ИРП — не более 200 мс;
- c) длительность интервала, разделяющего (на оси времени) две соседние ИРП, — не менее 200 мс.

Последовательность коротких импульсов должна трактоваться как кратковременная ИРП, если длительность последовательности, измеренная от начала первого импульса до конца последнего, составляет не более 200 мс и выполняются условия a) и c). Временные параметры кратковременных ИРП определяются сигналом на выходе ПЧ измерительного приемника, превышающим заданный (опорный) уровень.

Примечания

- 1 Определения и признаки кратковременных ИРП установлены в ГОСТ 30805.14.1.
- 2 Современные анализаторы кратковременных ИРП разработаны для использования с ИП, имеющими квазипиковый детектор, работающими с ограниченным внутренним уровнем сигнала. В связи с этим современные анализаторы кратковременных ИРП могут не сопрягаться с измерительными приемниками некоторых типов.

9.1 Основные требования

a) Анализатор кратковременных ИРП должен иметь канал для измерения длительностей импульсов ИРП и разделяющих их интервалов, подключаемый к выходу ПЧ измерительного приемника. При измерениях длительностей должна рассматриваться только та часть импульса ИРП, которая превышает опорный уровень ПЧ измерительного приемника. Погрешность измерения длительности должна быть не более ± 5 %.

Примечание — Под опорным уровнем ПЧ понимают такой уровень сигнала на выходе ПЧ измерительного приемника (при подаче на его вход немодулированного синусоидального сигнала), при котором показание ИП (в квазипиковых значениях) равно норме на непрерывную ИРП.

b) Анализатор кратковременных ИРП должен иметь канал для оценки квазипикового значения амплитуды ИРП.

c) Амплитуда в канале оценки квазипиковых значений должна измеряться по прошествии 250 мс после спада заднего фронта последнего импульса ИРП в канале ПЧ.

d) Комбинация обоих каналов должна во всех отношениях соответствовать требованиям 4.1.

e) Анализатор кратковременных ИРП при необходимости должен измерять и регистрировать:

- число кратковременных ИРП;
- длительность испытания, мин;




- частоту повторения кратковременных ИРП;
 - случаи появления ИРП, превышающих норму для непрерывной ИРП (в квазициковых значениях), но не являющихся кратковременными.

Примечание — Пример блок-схемы анализатора кратковременных ИРП приведен на рисунке 6.





г) Подтверждение работоспособности анализатора по выявлению ИРП, соответствующих определению кратковременных помех, должно производиться при его работе с двенадцатью видами испытательных сигналов, параметры которых приведены в таблице 14 и на рисунке 7.

Работоспособность анализатора кратковременных ИРП по выявлению исключений, учитываемых при нормировании кратковременных ИРП в соответствии с ГОСТ 30804.14.1—2013 (пункт 4.2.3), должна проверяться на основе его работы с двенадцатью видами испытательных сигналов, параметры которых приведены в приложении F, таблица F.1 и рисунок F.1.





Таблица 14 — Испытательные сигналы, используемые для определения кратковременной помехи (КВП) при проверке характеристик анализатора кратковременных ИРП

Номер испытания	Параметр испытательного сигнала					Оценка помехи анализатором кратковременных ИРП	Графическое представление испытательного сигнала, наблюдаемого на выходе ПЧ, и связанного с ним квазицикового сигнала относительно опорного показания ИП		
	1		2		3			4	5
	импульс 1	импульс 2	импульс 1	импульс 2	Длительность интервала между импульсами (выход ПЧ), мс			Оценка помехи анализатором кратковременных ИРП	Графическое представление испытательного сигнала, наблюдаемого на выходе ПЧ, и связанного с ним квазицикового сигнала относительно опорного показания ИП
1	1	—	0,11	—	—	1 КВП			
2 ¹⁾	1	—	9,5	—	—	1 КВП			
3 ¹⁾	1	—	190	—	—	1 КВП			


Продолжение таблицы 14

Номер испытания	Параметр испытательного сигнала					Оценка помехи анализатором кратковременных ИРП	Графическое представление испытательного сигнала, наблюдаемого на выходе ПЧ, и связанного с ним квазипикового сигнала относительно опорного показания ИП
	1		2		3		
	импульс 1	импульс 2	импульс 1	импульс 2	Длительность интервала между импульсами (выход ПЧ), мс		
4	1	—	1333 ²⁾	—	—	Не является КВП	 <p>2 с</p>
5	1	—	210	—	—	Не является КВП (210 мс)	 <p>1 с</p>
6	5	5	30	30	180	Не является КВП (240 мс)	 <p>1 с</p>
7	5	5	30	30	130	1 КВП	 <p>1 с</p>

Продолжение таблицы 14

Номер испытания	Параметр испытательного сигнала					Оценка помехи анализатором кратковременных ИРП	Графическое представление испытательного сигнала, наблюдаемого на выходе ПЧ, и связанного с ним квазипикового сигнала относительно опорного показания ИП
	1		2		3		
	импульс 1	импульс 2	импульс 1	импульс 2	Длительность интервала между импульсами (выход ПЧ), мс		
8	5	5	30	30	210	2 КВП	 1 с
9	1	—	0.11	—	Минимум 21 импульс с периодичностью 10	Не является КВП	 1 с
10	-2,5	25	30	30	265	1 КВП	 1 с
11	25	-2,5 ³⁾	190	30	1034 ⁵⁾	2 КВП ⁴⁾	 2 с

Окончание таблицы 14

Номер испытания	Параметр испытательного сигнала					Графическое представление испытательного сигнала, наблюдаемого на выходе ПЧ, и связанного с ним квазипикового сигнала относительно опорного показания ИП	
	1		2		3		4
	Квазипиковое значение амплитуды импульсов, измеренное относительно квазипикового опорного показания ИП, дБ		Длительность импульсов ⁶⁾ , измеренных на выходе ПЧ измерительного приемника, мс		Длительность интервала между импульсами (выход ПЧ), мс		Оценка помехи анализатором кратковременных ИРП
импульс 1	импульс 2	импульс 1	импульс 2				
12	25	-2,5 ³⁾	190	30	1166 ⁵⁾	1 КВП	
<p>¹⁾ Испытание должно проводиться при фоновом шуме в виде импульсного сигнала с частотой повторения импульсов 200 Гц (принятого в СИСПР для имитации фонового шума), уровень которых на 2,5 дБ ниже порогового уровня (квазипиковое значение). Этот импульсный сигнал должен начинаться по крайней мере, за 1 с до начала испытательного импульса и продолжаться в течение не менее 1 с после его окончания.</p> <p>²⁾ При подаче на вход АП импульса длительностью 1,333 с проверяется порог анализатора кратковременных ИРП по импульсам, которые только на 1 дБ выше порогового уровня (квазипиковое значение).</p> <p>³⁾ Этот низкий уровень импульса 2 должен устанавливаться таким, чтобы на выходе ПЧ импульс был выше порога по ПЧ, а отклик на него детектора был ниже нормы непрерывных ИРП (квазипиковое значение).</p> <p>⁴⁾ Если эти два импульса были измерены как отдельные помехи, лишь одна кратковременная помеха должна быть зарегистрирована.</p> <p>⁵⁾ Соответствующие значения для частот свыше 30 МГц находятся на рассмотрении и будут изменены после дальнейших исследований.</p> <p>⁶⁾ Время нарастания импульсов должно быть не более 40 мкс.</p> <p>Примечания</p> <p>1 Графическая иллюстрация соответствует измерениям пиковым детектором ИП при очень коротком времени наблюдения (< 1 мс), которые показывают импульс с частотой повторения 200 Гц. При появлении синусоидального сигнала с импульсной модуляцией импульс 200 Гц становится невидимым (как видно на графике испытания № 3), но при кратковременной помехе он присутствует.</p> <p>2 Кратковременные отклики в начале графиков объясняются несовершенством программы обработки сигналов.</p>							

9.2 Валидация характеристик анализатора кратковременных ИРП: метод испытаний

9.2.1 Основные положения

Анализатор кратковременных ИРП подключают к ИП с квазипиковым детектором и настраивают на требуемую частоту.

На вход ИП на частоте настройки подают одновременно синусоидальный и импульсный сигналы. Для испытаний № 2 и № 3 дополнительно требуется сигнал, создаваемый генератором импульсов СИСПР в соответствии с приложением В с частотой повторения импульсов 200 Гц, попадающий в полосу пропускания ИП на частоте настройки.

Источник импульсных сигналов должен обеспечить создание двух независимо изменяющихся импульсов. Время нарастания импульсов не должно быть более 40 мкс. Длительность импульса должна меняться от 110 мкс до 1,3 мс, а амплитуда должна меняться в пределах 44 дБ. Любой фоновый шум источника импульсных сигналов должен быть по крайней мере на 20 дБ ниже опорного уровня [см. 9.1, перечисление а)].

Испытания проводят следующим образом:

а) подают синусоидальный сигнал на вход ИП, используемого вместе с анализатором кратковременных ИРП. Устанавливают амплитуду синусоидального сигнала, при которой показание прибора соответствует опорной точке (нулевому опорному уровню) на шкале индикаторного прибора ИП, что соответствует норме непрерывных ИРП (квазипиковое значение).


С помощью ВЧ-аттенюатора ИП устанавливают уровень сигнала выше шума приемника, но ниже нормы непрерывных ИРП, используемой как пороговое значение в канале ПЧ. Полученный уровень синусоидального сигнала на выходе ПЧ измерительного приемника соответствует опорному уровню ПЧ;

б) подают импульсный сигнал на вход ИП. Для испытаний № 2 и № 3 подают дополнительный импульсный сигнал с частотой повторения 200 Гц от генератора импульсов СИСПР, который должен суммироваться с импульсным сигналом. Параметры сигнала установлены в таблице 14. Значения амплитуды импульсов, указанные в таблице 14 (графа 1), устанавливают отдельно по показанию, соответствующему норме непрерывных ИРП (квазипиковое значение), используемому в качестве порога в канале ПЧ. Значения амплитуды импульсов должны соответствовать уровням ВЧ и ПЧ, установленным в 9.1.

9.2.2 Дополнительные требования


Метод испытания должен быть аналогичен методу, изложенному в 9.2.1, перечисление а).

Параметры испытательных сигналов указаны в приложении F, таблица F.1.

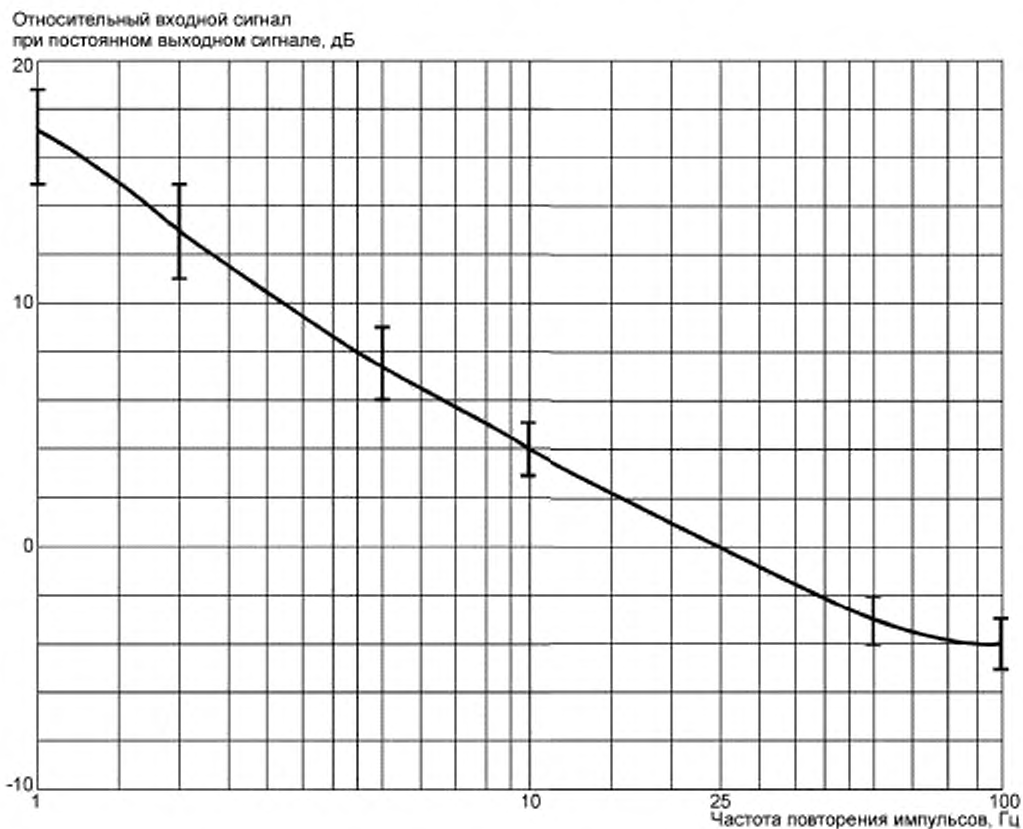


а) Импульсная характеристика ИП для полосы частот А (от 9 до 150 кГц) и допускаемые отклонения ее значений

Относительный входной сигнал
при постоянном выходном сигнале, дБ

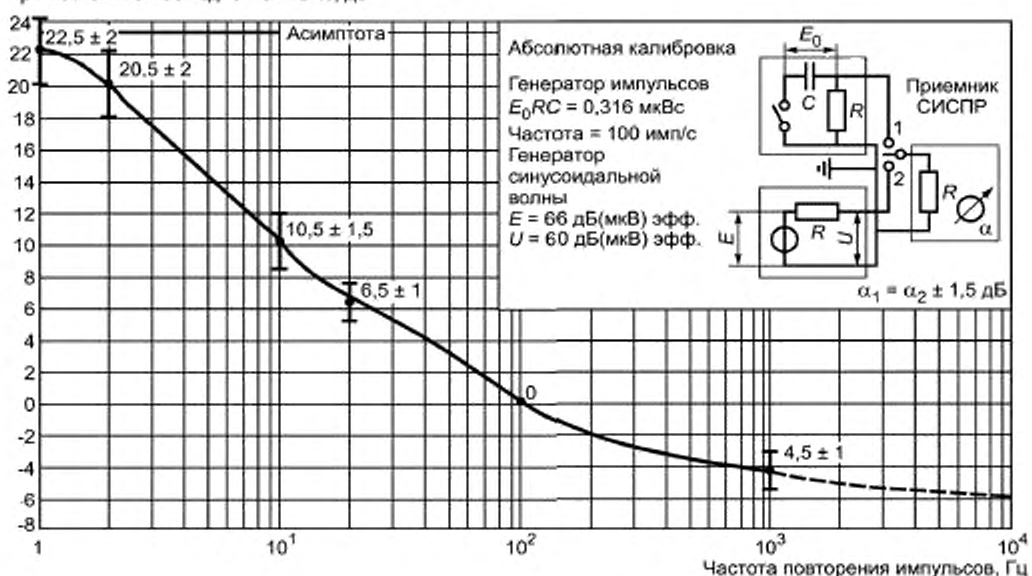


б) Импульсная характеристика ИП для полосы частот В (от 0,15 до 30 МГц)
и допускаемые отклонения ее значений

Относительный входной сигнал
при постоянном выходном сигнале, дБ

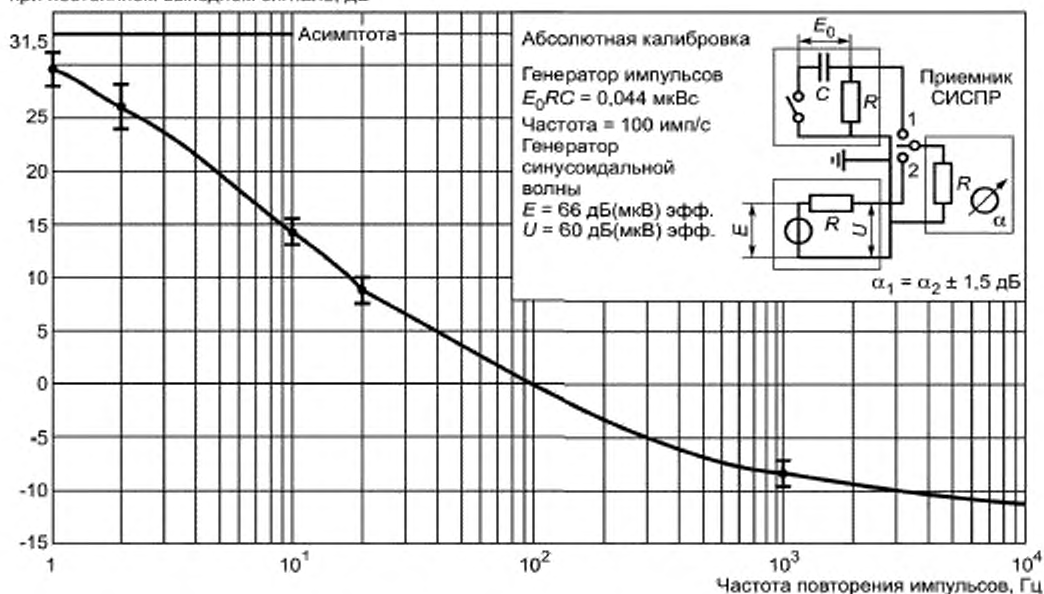


с) Импульсная характеристика ИП для полосы частот C/D (от 30 до 1000 МГц)
и допускаемые отклонения ее значений

I/S площадь импульса при постоянном показании приемника, дБ (мкВс)

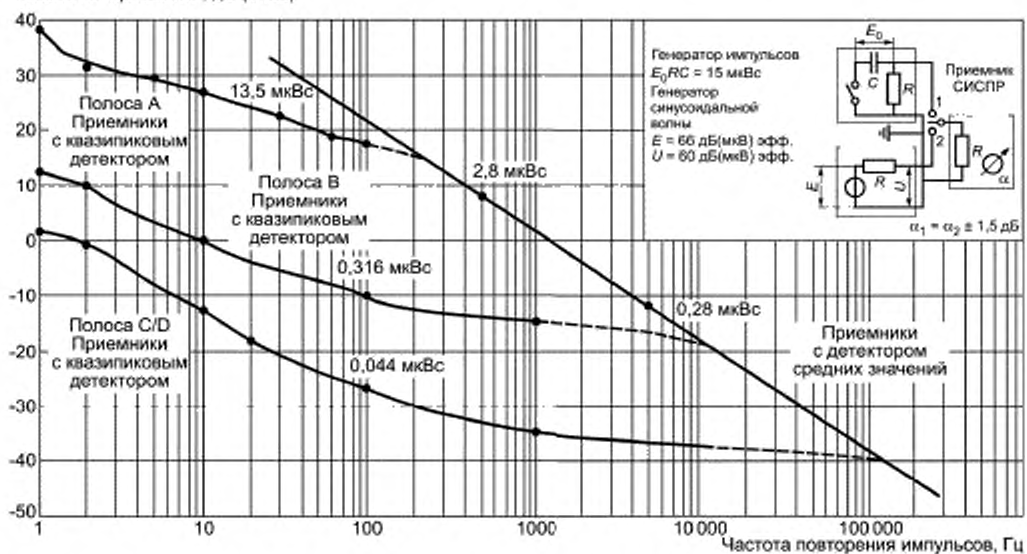


д) Теоретические кривые импульсной характеристики ИП с квазилинейным детектором и детектором средних значений (см. 6.4.2)

Рисунок 1, лист 3

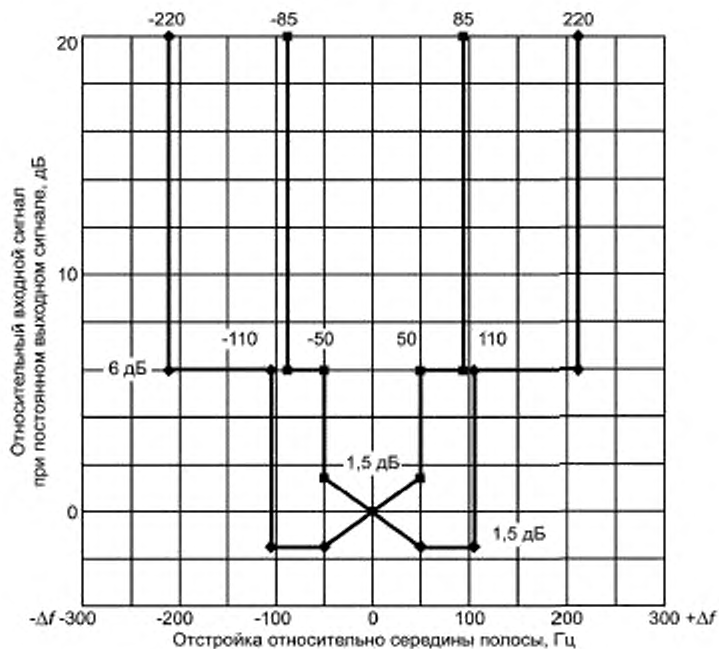


а) Пределы характеристики частотной избирательности ИП для полосы частот А (от 9 до 150 кГц)

Рисунок 2, лист 1 — Нормы частотной избирательности ИП

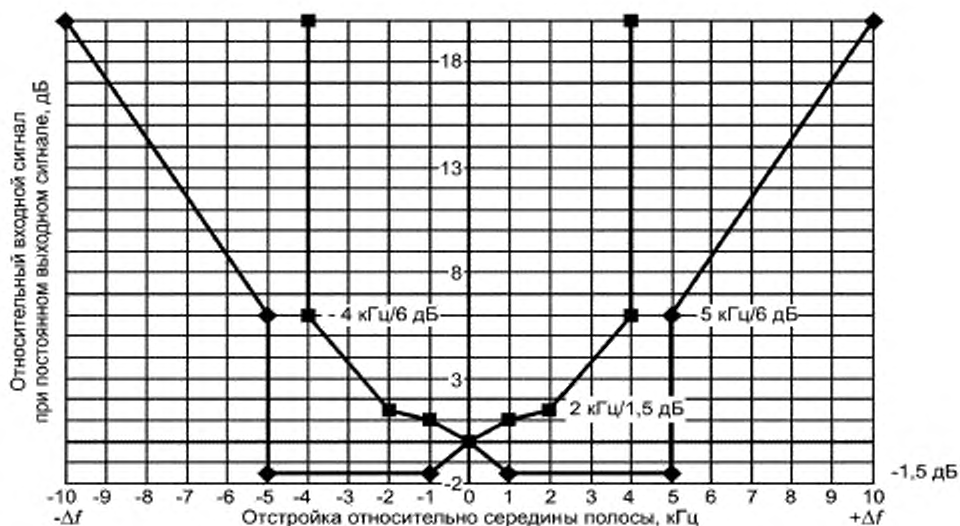


б) Пределы характеристики частотной избирательности ИП для полосы частот В (от 0,15 до 30 МГц)

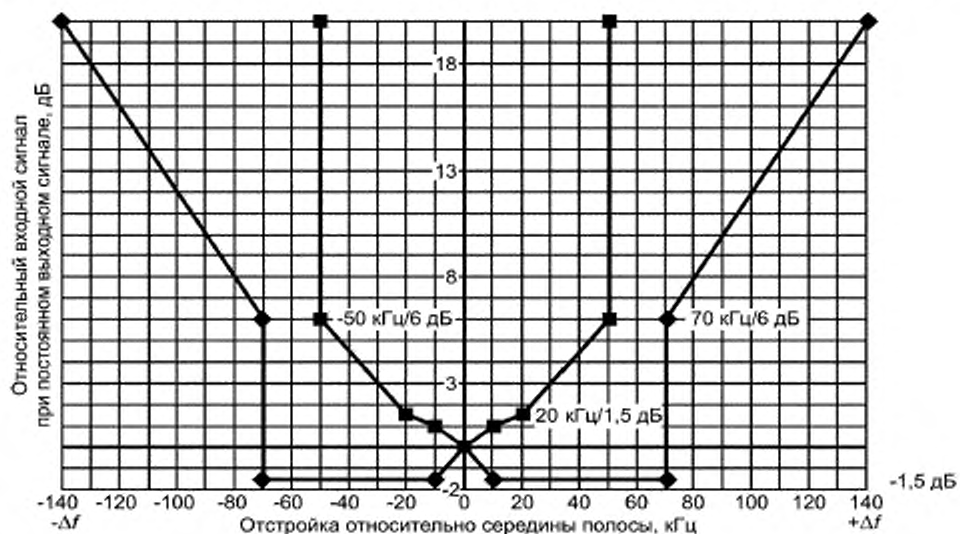

с) Пределы характеристики частотной избирательности ИП для полос частот С и D (от 30 до 1000 МГц)

Рисунок 2, лист 2

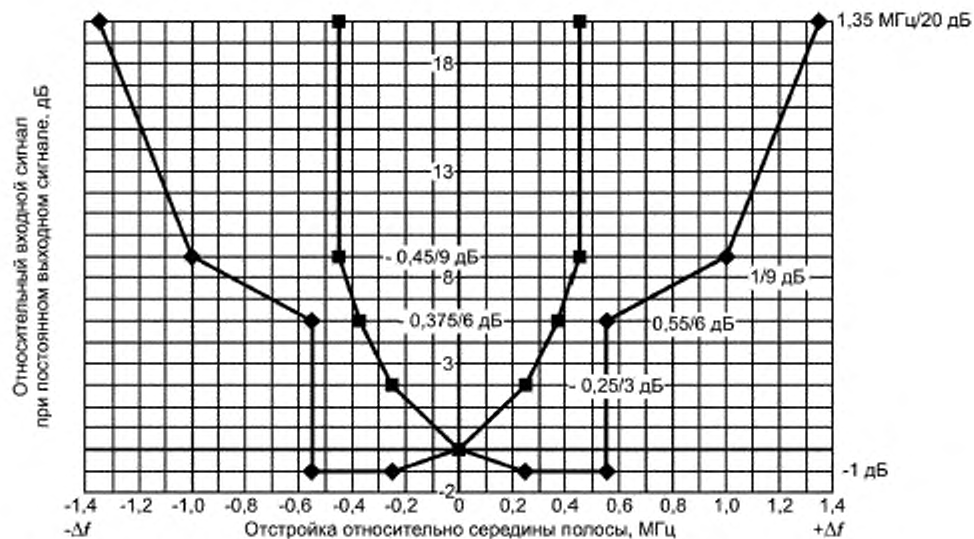


Примечания

1 Пределы для ширины импульсной полосы пропускания невозможно представить на диаграмме, так как соответствующее затухание фильтра зависит от типа фильтра. Поэтому для ориентации заданы границы для ширины полосы на уровне 6 дБ и 9 дБ.

2 Пределы полной избирательности получены от оборудования, используемого на время введения требования относительно избирательности.

д) Пределы характеристики частотной избирательности ИП для полосы частот E

Рисунок 2. лист 3

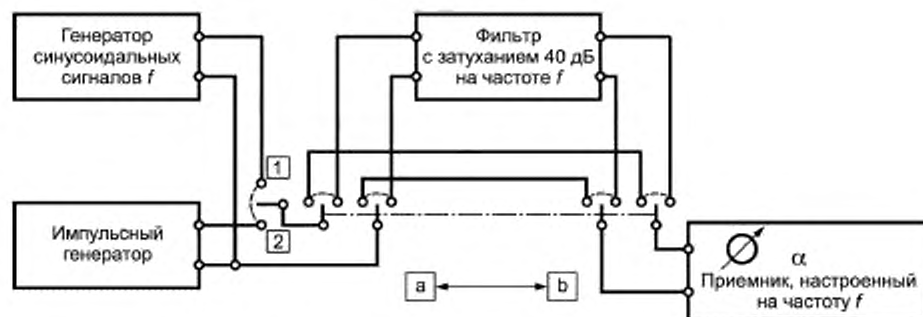

$$\alpha_{1a} = \alpha_{2a}$$

$$\alpha_{1b} = \alpha_{1a} - 40 \text{ дБ}$$

$$\alpha_{2b} = \alpha_{2a} - 36 \text{ дБ}$$

Рисунок 3 — Схема измерения ослабления продуктов интермодуляции





Рисунок 4 — Блок-схема детектора средних значений

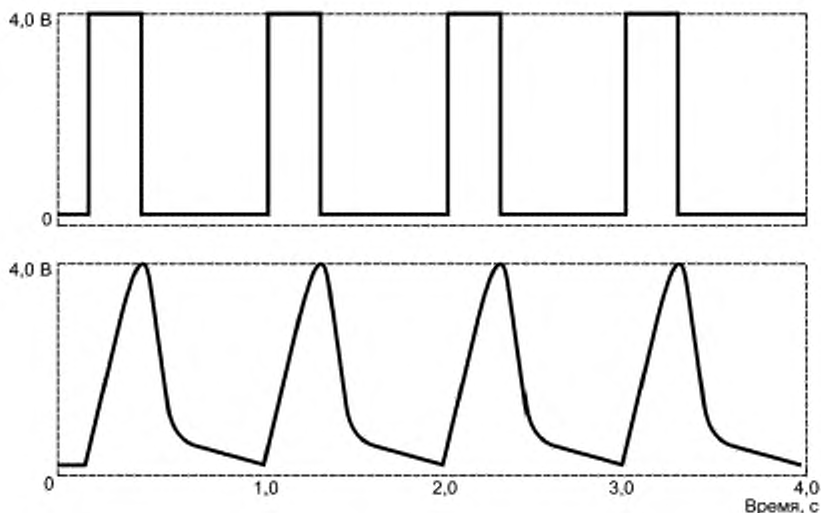

Примечания

1 Отклик на скачкообразные узкополосные помехи может быть рассчитан для детектора средних значений в логарифмическом режиме при выбранной ширине полосы частот видеотракта анализатора спектра, например 10 Гц, и работе анализатора в режиме запоминания максимума.

2 Приведенный отклик вызван скачкообразным узкополосным сигналом с длительностью 0,3 с и частотой повторения импульсов 1 Гц при постоянной времени детектора 100 мс. Если постоянная времени детектора будет равна 160 мс, пиковые значения сигнала на выходе измерителя, имитирующего схему, будут меньше.

Рисунок 5 — Отклик схемы, имитирующей индикаторный прибор, на скачкообразный узкополосный сигнал

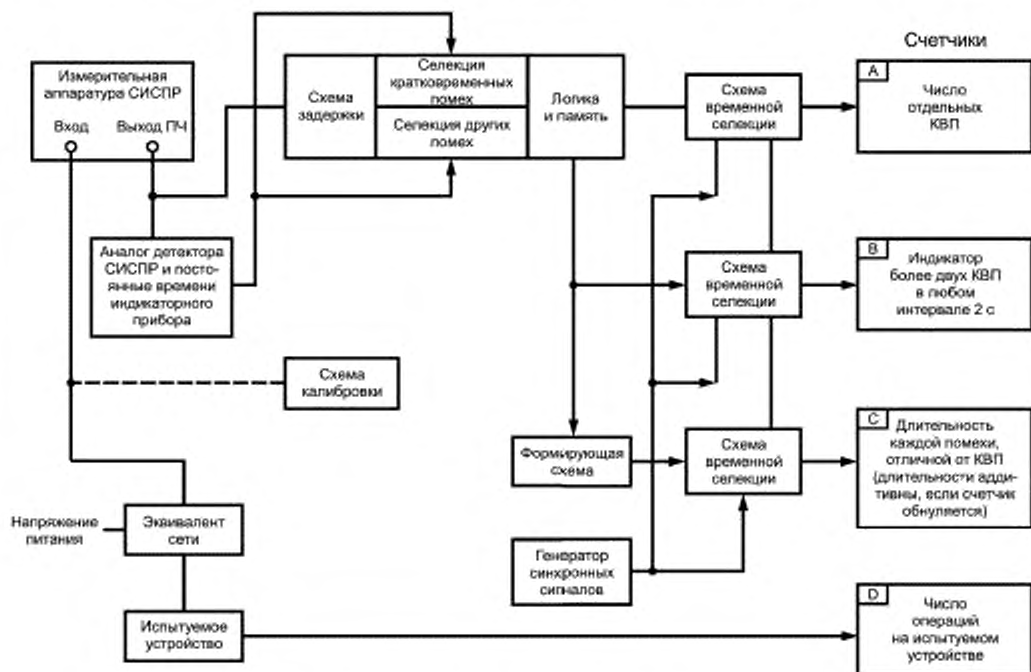


Рисунок 6 — Пример блок-схемы анализатора кратковременных ИРП















Номер испытания	Испытательный сигнал	Требуемый результат оценки
1	 0,11 мс/1 дБ	1 КВП
2	 9,5 мс/1 дБ -1 с +1 с	1 КВП
3	Фон: шум или импульсы СИСНР, 200 Гц: – 2,5 дБ (квазицикловое значение)  190 мс/1 дБ -1 с +1 с	1 КВП
4	 1333 мс/1 дБ	Не является КВП
5	 210 мс/1 дБ	Не является КВП
6	 30 мс/5 дБ 30 мс/5 дБ 180 мс	Не является КВП
7	 30 мс/5 дБ 30 мс/5 дБ 130 мс	1 КВП
8	 30 мс/5 дБ 30 мс/5 дБ 210 мс	2 КВП
9	 минимум 21 импульс / 0,11 мс с периодичностью 10 мс / 1 дБ	Не является КВП
10	 30 мс/25 дБ 265 мс	1 КВП
11	 30 мс/-2,5 дБ 190 мс/25 дБ полоса В: 1034 мс/полоса С - на рассмотрении	2 КВП
12	 190 мс/25 дБ полоса В: 1166 мс/полоса С - на рассмотрении  30 мс/-2,5 дБ/2 дБ ПЧ  30 мс/-2,5 дБ/2 дБ ПЧ	1 КВП

Рисунок 7 — Графическое представление испытательных сигналов в соответствии с таблицей 14, используемых при испытании анализатора кратковременных ИРП с целью проверки его способности выявления кратковременных помех (КВП)

**Приложение А
(обязательное)**

**Расчет импульсной характеристики измерительных приемников
с детекторами квазипиковых и среднеквадратичных значений**

А.1 Общие положения

В настоящем приложении приведены метод определения импульсной характеристики и необходимые данные для ее расчета.

А.2 Импульсная характеристика каскадов, предшествующих детектору

Импульсная характеристика каскадов, предшествующих детектору, в основном определяется каскадами усиления ПЧ, которые задают общую избирательность ИП. Принято считать, что общая избирательность может быть обеспечена схемой из двух критически связанных и соединенных последовательно трансформаторов, формирующих и требуемый вид кривой характеристики избирательности и необходимую ширину полосы пропускания на уровне – 6 дБ. Для целей расчета любую другую аналогичную схему можно свести к упомянутой выше схеме. Практическая симметрия характеристики избирательности, формируемой данной схемой, позволяет использовать для расчета огибающей импульсной характеристики эквивалентный фильтр нижних частот. Ошибка, которая получается в результате этой аппроксимации, пренебрежимо мала.

Огибающую импульсного сигнала на входе фильтра записывают следующим образом

$$A(t) = 4\omega_0 G e^{-\omega_0 t} (\sin \omega_0 t - \omega_0 t \cos \omega_0 t), \quad (\text{A.1.1})$$

где G — общий коэффициент усиления на частоте настройки,

ω_0 — угловая частота, равная $(\pi/\sqrt{2})B_3$.

Огибающая импульсного сигнала на выходе фильтра (т. е. функция отклика двух критически связанных трансформаторов на импульс площадью $\nu\tau$) будет равна

$$A(t) = (\nu\tau)4\omega_0 G e^{-\omega_0 t} (\sin \omega_0 t - \omega_0 t \cos \omega_0 t). \quad (\text{A.1.2})$$

Характеристика избирательности эквивалентного фильтра нижних частот для $\tau \ll 1/\omega_0$ может быть записана в виде

$$F(f) = G \left[\frac{2\omega_0^2}{(\omega_0 + j\omega)^2 + \omega_0^2} \right]^2, \quad (\text{A.2})$$

где $\omega = 2\pi f$.

Значения полос B_3 и B_6 , определенные по характеристике избирательности (A.2), равны:

$$B_3 = \left[\sqrt{2} \sqrt{\sqrt{2}-1} \right] \omega_0 / \pi = 0,361\omega_0, \quad (\text{A.3.1})$$

$$B_6 = \sqrt{2}\omega_0 / \pi = 0,450\omega_0. \quad (\text{A.3.2})$$

Эффективная ширина полосы пропускания ИП (включающего в себя идеальный прямоугольный фильтр, имеющий то же среднеквадратическое значение отклика, что и реальный приемник) равна ширине полосы пропускания по мощности Δf , определяемой как

$$\Delta f = \frac{1}{F_0^2} \int_{-\infty}^{+\infty} F^2(f) df, \quad (\text{A.4})$$

где $F(f)$ — характеристика избирательности;

F_0 — максимальное значение $F(f)$ (при условии что кривая избирательности имеет единственный максимум).

Ширина полосы пропускания по мощности при $F_0 = 1$

$$\Delta f = \int_{-\infty}^{+\infty} F^2(f) df. \quad (\text{A.5})$$

Используя для $F(f)$ характеристику избирательности (A.2) и принимая $G = 1$, получаем

$$\Delta f = 2 \int_0^{+\infty} \left[2\omega_0^2 / (\omega_0 + j\omega)^2 + \omega_0^2 \right]^4 df. \quad (\text{A.6})$$

Проведя интегрирование, находим

$$\Delta f = 0,265\sqrt{2} \cdot \omega_0 = 0,375\omega_0. \quad (\text{A.7})$$

Сопоставляя формулы (A.3.1) или (A.3.2) с формулой (A.7), можно найти соотношение между шириной полосы пропускания B_3 или B_0 и эффективной шириной полосы пропускания Δf .

Например, для B_3 имеем

$$B_3 = 0,963\Delta f. \quad (\text{A.8})$$

A.3 Отклик квазипикового детектора на выходной сигнал каскадов, предшествующих детектору

Расчет проводят, исходя из предположения, что подключение детектора к последнему каскаду ПЧ не изменяет амплитуду и форму поступающего от него сигнала (т. е. допускается, что выходное сопротивление каскада много меньше входного сопротивления детектора). Известно, что любой детектор может быть упрощен до одного нелинейного (реального или эквивалентного) элемента, например диода в соединении с резистором (полным прямым сопротивлением S), за которым следует схема, состоящая из конденсатора емкостью C , соединенного параллельно с разрядным резистором сопротивлением R . В такой схеме детектора постоянная времени заряда T_C определяется значением произведения SC , а постоянная времени разряда T_D — произведения RC .

Напряжение U на конденсаторе соотносится с амплитудой A подаваемого на детектор ВЧ-сигнала следующим уравнением

$$dU/dt + U/(RC) = A(\sin\theta - \theta \cos\theta)/(\pi SC), \quad (\text{A.9})$$

где θ — фазовый угол полной проводимости ($U = A \cos\theta$).

Уравнение (A.9) не интегрируется непосредственно. Значение произведения SC , которое для выбранных постоянных времени удовлетворяет вышеприведенным условиям, определяется методами аппроксимации, например:

- в полосе частот А: $T_C = 45$ мс,
 $T_D = 500$ мс,
 $2,81 SC = 1$ мс;
- в полосе частот В: $T_C = 1$ мс,
 $T_D = 160$ мс,
 $3,95 SC = 1$ мс;
- в полосах частот С и D: $T_C = 1$ мс,
 $T_D = 550$ мс,
 $4,07 SC = 1$ мс.

Подставляя полученные таким образом значения в уравнение (A.9), можно решить его либо для отдельного импульса, либо для повторяющихся импульсов (снова методами аппроксимации) путем введения вместо постоянной амплитуды A функции $A(t)$, задаваемой соотношением (A.1.2) в соответствии с формулой (A.2). Решение уравнения (A.9) в случае повторяющихся импульсов можно найти практически только путем произвольного выбора некоторого уровня выходного напряжения детектора в начале каждого импульса, определения приращения ΔU данного напряжения, вызванного импульсом, и затем для определения интервала, который должен быть между двумя последовательными импульсами для того, чтобы выполнялись допущенные начальные условия.

A.3.1 Отклик индикаторного прибора на сигнал от детектора

Расчет проводят, исходя из предположения, что нарастание значения выходного напряжения детектора происходит мгновенно. Тогда необходимо решить следующее уравнение

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \frac{2}{T_M} \frac{d\alpha}{dt} + \frac{1}{T_M^2} \alpha = \frac{1}{T_M^2} \exp\left(-\frac{t}{T_D}\right), \quad (\text{A.10})$$

где $\alpha(t)$ — отклонение стрелки индикаторного прибора;

T_M — механическая постоянная времени индикаторного прибора с критическим демпфированием;

T_D — постоянная времени электрического разряда квазипикового детектора.

Решение уравнения (A.10) при двух экстремумах на кривой отклика относительно простое: с одной стороны, для импульсов, достаточно разнесенных при нулевой и, следовательно, известной точке старта и, с другой

стороны, для импульсов, имеющих достаточно высокую частоту повторения, при инерционности прибора, не позволяющей верно следить за флюктуациями сигнала.

Для промежуточных случаев расчет более сложен, так как в точке начала каждого импульса отклонение прибора меняется, и необходимо найти решение, учитывающее первоначальное положение и скорость.

A.4 Отклик детектора среднеквадратических значений на выходное напряжение каскадов, предшествующих детектору

Выходное напряжение детектора среднеквадратических значений определяется по формуле

$$U_{rms} = \left[n \int_0^{+\infty} (A^2(t)/2) dt \right]^{1/2}, \quad (A.11)$$

где n — частота повторения импульсов, Гц.

Выходное напряжение детектора среднеквадратических значений U_{rms} может быть также найдено по характеристике частотной избирательности приемника $F(f)$

$$U_{rms} = \left[n \int_{-\infty}^{+\infty} (2\nu\tau \cdot F^2(f)/2) df \right]^{1/2}, \quad (A.12)$$

где $\nu\tau$ — площадь импульса на входе приемника.

Если входные импульсы имеют однородный частотный спектр, то приведенное выше выражение может быть преобразовано к виду

$$U_{rms} = \sqrt{2} \cdot \nu\tau \cdot \sqrt{n} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} F^2(f) df \right]^{1/2}. \quad (A.13)$$

Из формулы (A.13), учитывая формулу (A.5), получаем, что

$$U_{rms} = \sqrt{2} \cdot \nu\tau \cdot \sqrt{n} \sqrt{\Delta f}. \quad (A.14)$$

Принимая, что $U_{rms} = 2\text{ мВ}$ при $n = 100$ Гц, из уравнения (A.14) можно получить амплитудное соотношение

$$\nu\tau = (100\sqrt{2}) / \sqrt{\Delta f} \quad (\text{мкВс}), \quad (A.15)$$

или из уравнения (A.8)

$$\nu\tau = 139 / \sqrt{B_3} \quad (\text{мкВс}). \quad (A.16)$$

A.4.1 Расчет коэффициента перегрузки

Коэффициент перегрузки при частоте повторения импульсов n , Гц, рассчитывают по формуле

$$A(t)_{\text{реак}} / \sqrt{2} \cdot U_{rms} = 1,28 (B_3/n)^{1/2}, \quad (A.17)$$

где $U_{rms} = (\nu\tau) \cdot (2n\Delta f)^{1/2}$ — из уравнения (A.14);

$A(t)_{\text{реак}} = 0,944 \cdot \nu\tau \cdot \omega_0$ — максимальное значение $A(t)$ при $G = 1$ из уравнения (A.1.2).

A.5 Соотношение между показаниями измерителя квазипиковых значений и измерителя среднеквадратических значений

Амплитудное соотношение для измерителя среднеквадратических значений, определяющего значение импульса $(\nu\tau)_{rms}$ для частоты повторения 100 Гц (что эквивалентно синусоидальному сигналу 2 мВ), должно соответствовать уравнению (A.1.2).

Для характеристики избирательности, описываемой уравнением (A.2), это соответствует

$$(\nu\tau)_{rms} = 155 / \sqrt{B_3} \quad (\text{мкВс}),$$

если номинальная ширина полосы пропускания отсчитывается на уровне 6 дБ.

Для измерителя квазипиковых значений ширина импульса $(v\tau)_{qp}$, эквивалентная синусоидальному сигналу 2 мВ, равна:

$(v\tau)_{qp} = 0,316$ мкВс — для полосы частот от 0,15 до 30 МГц;

$(v\tau)_{qp} = 0,044$ мкВс — для полосы частот от 30 до 1000 МГц.

Таким образом, для ИП, имеющих характеристику избирательности в полосе пропускания в соответствии с уравнением (А.2) и ширину полосы пропускания на уровне 6 дБ, равную значениям номинальной полосы, представленным в разделах 4—7, существуют следующие соотношения для $(v\tau)_{rms}/(v\tau)_{qp}$:

$(v\tau)_{rms}/(v\tau)_{qp} = 14,3$ дБ — для полосы частот от 0,15 до 30 МГц;

$(v\tau)_{rms}/(v\tau)_{qp} = 20,1$ дБ — для полосы частот от 30 до 1000 МГц.

Эти соотношения справедливы для частоты повторения импульсов 100 Гц.

При других частотах повторения необходимо использовать соответствующие кривые отклика на импульсы.

Приложение В
(обязательное)

Методы определения характеристик импульсных генераторов. Спектр сигнала

В.1 Генератор импульсных сигналов

Генератор импульсных сигналов применяют при проверке соответствия ИП требованиям разделов 4.4, 4.6, 5.4, 6.4 и 7.4. Для каждой полосы частот импульсный генератор должен обеспечивать на выходе прямоугольные импульсы с определенной площадью при заданных частотах повторения (см. таблицу В.1). Площадь импульса должна быть задана с точностью $\pm 0,5$ дБ, а частота повторения — с точностью 1 %.

Таблица В.1 — Требуемые параметры импульсных сигналов

Полоса частот испытываемого ИП	Площадь импульса, мкВс	Частота повторения импульсов, Гц
от 0,09 до 0,15 МГц	13,5	1; 2; 5; 10; 25; 60; 100
от 0,15 до 30 МГц	0,316	1; 2; 10; 20; 100; 1000
от 30 до 300 МГц	0,044	1; 2; 10; 20; 100; 1000
от 300 до 1000 МГц	(см. примечание)	1; 2; 10; 20; 100; 1000
Примечание — Для полосы частот от 300 до 1000 МГц импульсы должны иметь соответствующую площадь и достаточно постоянный спектр до частоты не менее 1000 МГц.		

В.1.1 Спектр генерируемых импульсов

Спектр генерируемых импульсов определяется спектральной плотностью, представляющей закон изменения эквивалентного напряжения на входе измерительной установки, имеющей постоянную ширину полосы пропускания. Спектр должен быть достаточно постоянным вплоть до верхней границы полосы частот испытываемого приемника, т. е. в пределах данной полосы изменение амплитуд спектральных составляющих должно быть не более 2 дБ относительно значений этих составляющих на нижних частотах этой полосы. Площадь импульса на частоте измерения должна быть задана с точностью $\pm 0,5$ дБ.

Для проверки на соответствие требованиям 4.6 значение спектра свыше верхнего предела полосы частот должно ограничиваться (на удвоенной верхней частоте оно должен быть на 10 дБ ниже) с тем, чтобы продукты интермодуляции всех составляющих спектра не вносили заметной погрешности в результаты измерений.

В.2 Общий метод измерения

Методы определения характеристик импульсных генераторов приведены в приложении В. Если к находящему значению спектральной плотности не предъявляется требование высокой точности, используют следующий метод.

Генератор импульсов подключают ко входу ВЧ-измерительного приемника; к выходу промежуточной частоты приемника подключают осциллограф, который отображает высокочастотный импульс на выходе ПЧ.

На каждой частоте настройки приемника измеряют:

а) ширину полосы пропускания приемника на уровне минус 6 дБ (B_6 , Гц);

б) среднеквадратическое значение E_0 выходного напряжения генератора синусоидальных сигналов (имеющего такое же сопротивление, что и генератор импульсов), настроенного на центральную частоту полосы пропускания приемника и создающего на осциллографе отклонение, равное по амплитуде пику высокочастотных импульсов.

Относительную амплитуду спектральной составляющей на данной частоте [спектральную плотность $S_x(f)$] вычисляют по формуле

$$S_x(f) = E_0/B_6.$$

Измерение повторяют для различных частот испытания в рассматриваемой полосе.

Спектр генератора импульсных сигналов задается кривой, отображающей зависимость $S_x(f)$ от частоты измерения.

Используемый ИП должен быть линейным при пиковых уровнях измеряемых сигналов.

Подавление паразитных откликов, в частности на зеркальной частоте и на ПЧ, должно быть не менее 40 дБ.

Измерения могут выполняться ИП, соответствующим данным техническим требованиям и имеющим квази-пиковый детектор (при измерениях должно выполняться требование постоянства частоты повторения импульсов).

**Приложение С
(обязательное)**

**Методы определения характеристик импульсных генераторов.
Точное измерение выходного сигнала генератора наносекундных импульсов**

С.1 Измерение площади импульса

С.1.1 Общие положения

Методы измерения, приведенные в В.1.2—В.1.5, являются точными, так как погрешность получаемых на их основе результатов измерений с практической точки зрения оказывается незначительной.

С.1.2 Метод измерения площади

Измеряемые импульсы пропускают через узкополосный фильтр с симметричной амплитудной и асимметричной фазовой характеристикой, настроенный по центру полосы пропускания на частоту f (вместе с фильтром может быть использован усилитель, работающий на линейном участке).

Для определения площади импульса IS используют ее зависимость от огибающей выходного сигнала полосового фильтра $A(t, f)$

$$2(IS) = S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(t, f) dt,$$

где $S(f)$ — спектральная плотность;

$A(t, f)$ — амплитуда огибающей от единичного импульса (выраженная в единицах эквивалентного входного синусоидального напряжения).

Площадь импульса IS находят как полную площадь под огибающей $A(t, f)$ (с учетом знака ее различных частей).

Для настройки спектра импульса используют усилитель промежуточной частоты низкочастотного приемника или приемника для измерения ИРП вместе с рядом преобразователей частоты. Для измерения площади импульса выходной сигнал последнего усилителя промежуточной частоты подают непосредственно на осциллограф.

При использовании данного метода для импульсов с длительностью, намного меньшей периода частоты f , площадь импульса допускается измерять непосредственно как интегрированную площадь с помощью соответствующего осциллографа (например, для наносекундных импульсов требуется стробоскопический осциллограф), при этом интегрирование учитывает знак различных частей площади.

С.1.3 Метод стандартной линии передачи

Линия передачи, длина которой соответствует времени распространения l с напряжением V_0 разряжается через сопротивление нагрузки, равное характеристическому сопротивлению линии.

Считается, что линия передачи состоит из фактической линии, а также из зарядного участка линии, заключенного в корпусе переключателя. Установлено, что спектральная плотность $S(f)$ имеет значение $2\omega t$ в низкочастотной области спектра результирующего импульса, где амплитуда не меняется в зависимости от частоты, причем эта амплитуда не зависит от существования паразитных сопротивлений между линией и нагрузочным резистором (например, индуктивным или активным сопротивлением) или от конечного времени коммутации.

С.1.4 Измерение гармоник

Данный метод можно использовать для импульсных генераторов, создающих последовательность импульсов с довольно высокой и устойчивой частотой повторения.

Когда частота повторения импульсов F превышает размеры полосы измерительного приемника, последний может выделить одну линию из спектра импульса. В этом случае площадь импульса IS можно определить как

$$IS = V_k / 2F = V \sqrt{2} / 2F,$$

где $V_k = V \sqrt{2}$ — пиковое значение k -й гармоники.

Далее импульсный генератор можно использовать для калибровки импульсной характеристики ИП с широкой полосой пропускания, в которую на уровне 6 дБ попадает большое число гармонических составляющих (приблизительно 10 или более).

С.1.5 Метод измерения мощности

При использовании этого метода сравнивают мощность, создаваемую тепловым источником (резистором) с мощностью, создаваемой генератором импульсов. Однако точность, получаемая в данном методе, несколько ниже по сравнению с точностью приведенных выше методов. Данный метод может быть полезен на частотах вблизи 1000 МГц.

С.2 Требования к спектру генератора импульсов

С.2.1 Для определения соответствия требованиям 4.4.1, 5.4, 6.4.1 и 7.4.1 площадь импульса должна быть задана с погрешностью не более $\pm 0,5$ дБ.

С.2.2 Частота повторения импульсов должна быть задана с погрешностью не более 1 %.

С.2.3 Для определения соответствия подразделам 4.4.2, 5.4, 6.4.2 и 7.4.2 площадь импульсов не должна зависеть от их частоты повторения.

С.2.4 Для определения соответствия требованиям 4.4, 5.4, 6.4 и 7.4 частотный спектр генератора должен быть однородным в полосе пропускания ИП. Считается, что это требование выполняется в случаях:

а) если изменение частотного спектра линейно относительно частоты в пределах частотной полосы пропускания ИП, а неравномерность спектра не превышает 0,5 дБ в пределах полосы пропускания приемника, измеренной на уровне минус 6 дБ;

б) если частотный спектр имеет плавные спады по обеим сторонам от частоты настройки ИП и если ширина спектра в точках минус 6 дБ по крайней мере в пять раз превышает ширину полосы пропускания приемника на этом уровне.

В обоих случаях предполагается, что площадь импульса равна значению его уровня на частоте настройки.

Приложение D
(обязательное)**Влияние параметров измерительного приемника с квазипиковым детектором
на его импульсную характеристику**

При больших значениях частоты повторения импульсов существенное влияние на значение импульсной характеристики оказывает ширина полосы пропускания.

Для низких значений частоты повторения более важную роль играют постоянные времени. Относительно этих постоянных времени допуски в настоящем стандарте не установлены, но в качестве рекомендации можно считать приемлемым значение 20 %.

Кроме того, на очень низких частотах повторения наиболее заметным будет отсутствие перегрузки. Значения коэффициентов перегрузки должны быть такими, чтобы обеспечить точное измерение одиночного импульса при рекомендованных постоянных времени и ширине полосы пропускания.

Исследование поведения импульсной характеристики на двух крайних участках диапазона измерений индикаторного прибора гарантирует проверку возможного нелинейного поведения детектора. В этом смысле наиболее критичными частотами повторения, вероятнее всего, будут частоты вблизи (20—100) Гц.

Приложение Е
(обязательное)

**Импульсная характеристика измерительных приемников
с детекторами пиковых и средних значений**

Е.1 Отклик каскадов, предшествующих детектору

Площадь под огибающей выходного сигнала узкополосной схемы, которая имеет симметричную частотную характеристику и на вход которой подаются прямоугольные импульсы, не зависит от ширины полосы пропускания и задается формулой

$$\int_{-\infty}^{+\infty} A(t) dt = 2\nu\tau G_0, \quad (\text{Е.1})$$

где ν и τ — амплитуда и длительность прямоугольного импульса соответственно, для которого $B_{\text{нпр}}\tau \ll 1$ (G_0 — коэффициент усиления схемы на центральной частоте).

Данное утверждение справедливо только в случае огибающей, имеющей постоянный уровень (неосциллирующая огибающая). Колебательная (осциллирующая) огибающая присуща схемам с двойной настройкой, и если не используется чувствительный фазовый детектор, может потребоваться произвести компенсацию ошибки путем введения значения, вносимого осциллирующей огибающей.

В случае критической связи второй пик огибающей составляет приблизительно 8,3 % первого.

Примечание — Отклик каскадов, предшествующих детектору, как указано в разделе А.2, носит колебательный характер. Следовательно, погрешность калибровки, вносимую осциллирующим откликом, следует компенсировать с допуском (+ 2,5 — минус 0,5) дБ (как указано в 6.4.1).

Пока импульсы на выходе усилителя промежуточной частоты не перекрываются, среднее значение их площади пропорционально частоте повторения импульсов ν . Как следствие, среднее значение напряжения равно $2\nu\tau G_0 n$.

Исходя из уравнения (Е.1), определение эффективной ширины полосы для ИП с детектором средних значений не считается целесообразным.

Е.2 Коэффициент перегрузки

Для расчета коэффициента перегрузки при использовании ИП с пиковым детектором полезно определить величину, известную как «эффективная ширина импульсной полосы пропускания каскадов, предшествующих детектору $B_{\text{нпр}}$ » по формуле

$$B_{\text{нпр}} = A(t)_{\text{max}} / 2G_0, \quad (\text{Е.2})$$

где $A(t)_{\text{max}}$ — выходной сигнал (с пиковой огибающей) каскадов усиления промежуточной частоты при подаче единичного импульса.

Из уравнений, приводящих к формуле (А.17) (приложение А), имеем

$$B_{\text{нпр}} = (0,944/2)\omega_0 = 1,05B_6 \text{ или } 1,31B_3, \quad (\text{Е.3})$$

где B_6 и B_3 определены в п. 3.2.

Для других типов настраиваемых схем отношение $B_{\text{нпр}} \times B_6$ можно оценивать из рисунка Е.1, если известно отношение $B_{20} \times B_3$, где B_{20} — ширина полосы на уровне 20 дБ.

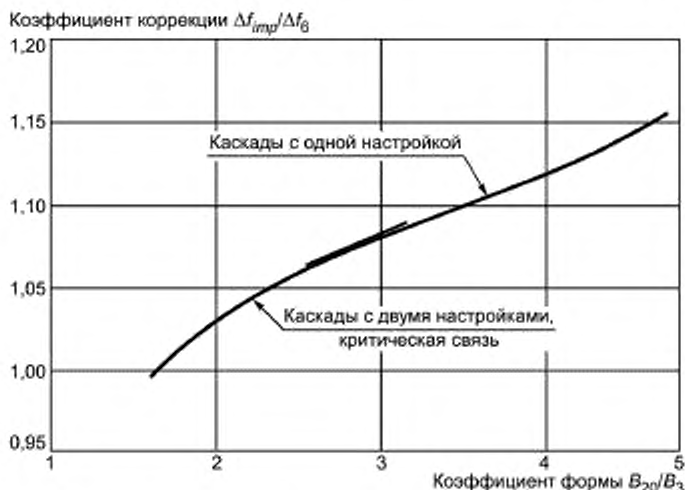


Рисунок Е.1 — Коэффициент коррекции для оценки отношения B_{imp}/B_8 для других типов настраиваемых схем

Е.3 Соотношение между показаниями измерительных приемников с детекторами средних и квазипиковых значений

Значение площади импульса, необходимое для создания такого же показания ИП средних значений, как и показания при подаче на его вход немодулированного синусоидального сигнала на частоте настройки со среднеквадратическим значением 2 мВ от генератора, имеющего тот же выходной импеданс, что и генератор импульсов, при частоте повторения импульсов λ , Гц, равно

$$v\tau = 1,4/\lambda \text{ (мВс)}.$$

При частоте повторения 100 Гц это значение составляет 14 мкВс.

Тогда в соответствии с приложением А, пункт А.5, отношение $(v\tau)_{ave}$ к $(v\tau)_{qp}$ для получения одного и того же показания будет равно:

$$(v\tau)_{ave}/(v\tau)_{qp} = 32,9 \text{ дБ — для полосы частот от 0,15 до 30 МГц;}$$

$$(v\tau)_{ave}/(v\tau)_{qp} = 50,1 \text{ дБ — для полосы частот от 30 до 1000 МГц.}$$

Вышеизложенное предполагает наличие требуемого коэффициента перегрузки при рассматриваемой частоте повторения и соответствие ширины полосы пропускания значениям, указанным в разделе 4.

При частоте повторения 1000 Гц соответствующие отношения будут 17,4 и 38,1 дБ.

Е.4 Измерительные приемники с пиковым детектором

Если в ИП используется измерительное устройство с непосредственным считыванием, требование к постоянным времени можно определить по кривой, приведенной на рисунке Е.2, на котором представлено процентное соотношение показания, отнесенного к реальному пиковому значению в зависимости от параметра, и в котором учтены коэффициент постоянных времени, ширина полосы B_8 и частота повторения импульсов. При использовании этой кривой необходимо иметь в виду, что

$$R_C/R_D = (1/4)(T_C/T_D), \quad (\text{Е.4})$$

где T_C и T_D — постоянные времени заряда и разряда.

Например, при желании получить показание ИП не менее 90 % реального пикового значения при частоте повторения 1 Гц необходимо иметь следующие соотношения постоянной времени разряда и постоянной времени заряда:

$$1,25 \cdot 10^6 \text{ — в полосе частот от 0,15 до 30 МГц;}$$

$$1,67 \cdot 10^7 \text{ — в полосе частот от 30 до 1000 МГц.}$$

Е.5 Соотношение между показаниями измерительных приемников с детекторами пиковых и квазипиковых значений

Значение площади импульса IS , необходимое для получения отклика ИП с пиковым детектором, эквивалентного отклику на немодулированный синусоидальный сигнал на частоте настройки со среднеквадратичным значением 2 мВ, равно

$$1.4/B_{\text{итр}} \text{ (мВс)}, \quad (\text{E.5})$$

где значение $B_{\text{итр}}$ выражают в герцах.

В полосах частот, указанных в 4.2, таблица 1, на уровне 6 дБ значение $B_{\text{итр}}$ равно $1,05 B_6$ (раздел E.2). Значение $B_{\text{итр}}$ и соответствующее значение IS , необходимые для ИП с пиковым детектором, будут равны:

- в полосе частот А

$$IS_{\text{пик}} = 6,67 \cdot 10^{-3}, \text{ мВс.}$$

$$B_{\text{итр}} = 0,21 \cdot 10^3, \text{ Гц};$$

- в полосе частот В

$$IS_{\text{пик}} = 0,148 \cdot 10^{-3}, \text{ мВс.}$$

$$B_{\text{итр}} = 9,45 \cdot 10^3, \text{ Гц};$$

- в полосах частот С, D

$$IS_{\text{пик}} = 0,011 \cdot 10^{-3}, \text{ мВс.}$$

$$B_{\text{итр}} \text{ Гц} = 126 \cdot 10^3, \text{ Гц.}$$

Тогда, используя значения α , мкВ/с, по 4.4.1, таблица 2, для квазипикового значения IS , получим, что отношение IS в квазипиковых значениях к IS в пиковых значениях для получения того же показания будет:

- для полосы частот А — 6,1 дБ (при частоте повторения импульсов 25 Гц);
- для полосы частот В — 6,6 дБ (при частоте повторения импульсов 100 Гц);
- для полос частот С и D — 12,0 дБ (при частоте повторения импульсов 1000 Гц).

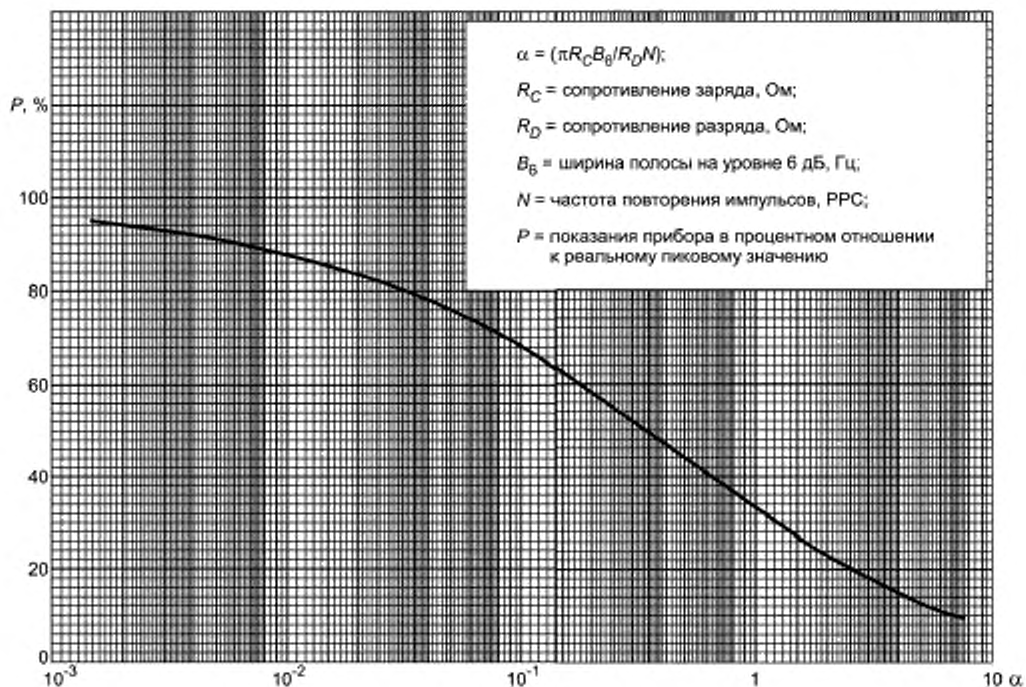


Рисунок E.2 — Коэффициент выпрямления импульсов P (показания прибора в процентном отношении к реальному пиковому значению)

E.6 Параметры испытательных импульсов для полосы частот E (1—18 ГГц)

Генераторов прямоугольных импульсов, имеющих равномерную спектральную плотность во всей полосе частот E (до частоты 18 ГГц), не существует. В связи с этим при измерении импульсной характеристики ИП в полосе частот E используют импульсно-модулированную несущую с частотой, равной частоте настройки приемника.

Длительность импульса должна быть не более $1/3 B_{имп}$; ее значение устанавливают с максимальной точностью для того, чтобы избежать недопустимо высокой погрешности устанавливаемого значения площади испытательных импульсов. Помимо традиционного измерения длительности импульса с помощью осциллографа, ее значение можно находить по расстоянию между минимумами спектральной плотности (см. рисунок Е.3).

Для ИП с пиковым детектором и шириной полосы $B_{имп}$, равной 1 МГц [см. примечание а) к таблице 6], требуемая площадь импульса $1,4/B_{имп}$ мВс (см. 5.4), будет 1,4 нВс. Два варианта значений параметров импульса, имеющего площадь $1,4/B_{имп}$ мВс, приведены в таблице Е.1.

Таблица Е.1 — Параметры испытательного импульса площадью $1,4/B_{имп}$

Ширина импульса w_p , нс	Уровень несущей (ЭДС) $L_{сигнал}$, дБ(мкВ)
100	86
200	80

Для ИП с линейным детектором средних значений требуемая площадь импульса $1,4/n$ мВс, где n — частота повторения импульсов (см. 6.4.1) при $n = 50\,000$ должна быть 28 нВс, т. е. на 26 дБ больше, чем для ИП с пиковым детектором при $B_{имп}$, равной 1 МГц.

Для ИП с детектором среднеквадратических значений требуемая площадь импульса должна составлять $44(B_{имп}^{-1/2})$ мВс (см. 6.4.1) при частоте повторения импульсов 1 кГц (см. 7.4.1). При ширине импульсной полосы пропускания $B_{имп}$, равной 1 МГц, соответствующее значение B_3 равно 700 кГц. Следовательно, необходимая площадь импульса будет равна 52,6 нВс, т. е. на 31,5 дБ больше, чем для ИП с пиковым детектором при $B_{имп}$, равной 1 МГц.

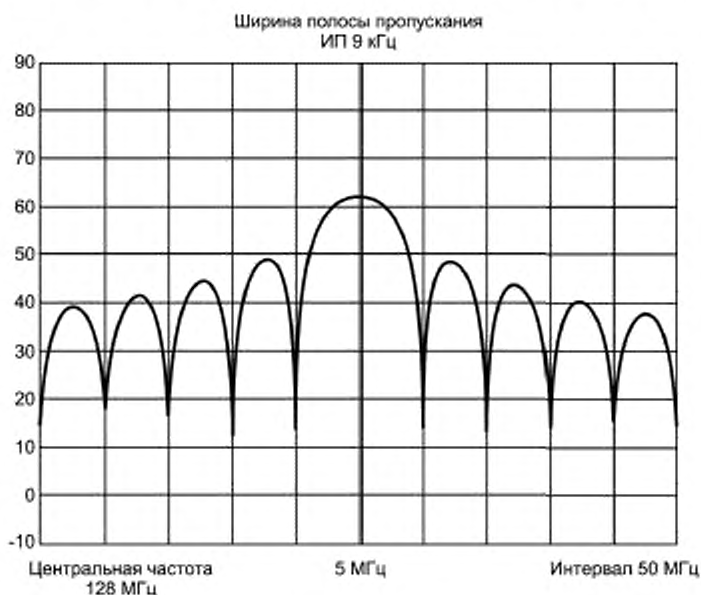


Рисунок Е.3 — Спектрограмма импульсно-модулированного сигнала при ширине импульсов 200 нс

Е.7 Измерение ширины импульсной полосы пропускания $B_{имп}$

Ширину импульсной полосы пропускания $B_{имп}$, МГц, определяют по формуле

$$B_{имп} = U_p/D, \quad (E.6)$$

где U_p — пиковое значение, измеренное приемником, мкВ;

D — спектральная плотность испытательного импульса, мкВ/МГц.

Обе величины U_p и D принято калибровать в среднеквадратичных значениях немодулированного синусоидального сигнала измерительных приемников СИСПР.

Часто точное значение спектральной плотности импульса неизвестно. В этом случае появляется неопределенность в нахождении ширины $B_{\text{имп}}$. Для уменьшения этой неопределенности могут быть использованы методы, приведенные ниже.


В методах 1 и 2 для уменьшения неопределенности проводят не одно, а два измерения. В методе 3 для расчета значения $B_{\text{имп}}$ используют кривую избирательности, так как $B_{\text{имп}}$ является «шириной полосы напряжения» ИП (не следует путать с шириной полосы мощности или эквивалентной шириной полосы шума, которые определяют среднеквадратичное значение гауссовского шума при использовании ИП с детектором среднеквадратичных значений).

Ширина полосы напряжения $B_{\text{имп}}$ шире $B_{\text{в}}$, но коэффициента для определения соотношения между $B_{\text{имп}}$ и $B_{\text{в}}$ (или B_3) в общем случае не существует.

Метод 1. Определение $B_{\text{имп}}$ по откликам на импульсы с разной частотой повторения

Данный метод используют при небольших длительностях импульсов (см. рисунок Е.4). Определение значения $B_{\text{имп}}$ в данном методе строится на сравнении откликов на импульсы с высокой ($f_p \gg B_{\text{имп}}$) и низкой ($f_p \ll B_{\text{имп}}$) частотами повторения.

При высокой частоте повторения приемник можно настроить на частоту несущей, как показано на рисунке Е.5, а при низкой частоте повторения спектр будет иметь широкополосный вид, как показано на рисунке Е.6, со спектральной плотностью импульсов $D = U_1 \tau$. Форма импульсов, т. е. амплитуда U_1 и длительность τ , не должны зависеть от частоты повторения импульсов. При $B_{\text{имп}} = 1$ МГц значение f_{p1} допускается выбирать равным 30 МГц, а f_{p2} — равным 30 кГц.

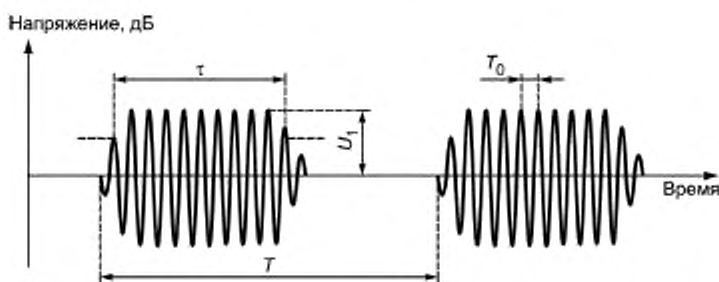

τ — ширина импульса (на уровне 50 % U_1); $f_p = 1/T$ — частота повторения импульсов;
 $f_0 = 1/T_0$ — частота несущей сигнала

Рисунок Е.4 — Импульсно-модулированный ВЧ-сигнал, подаваемый на ИП

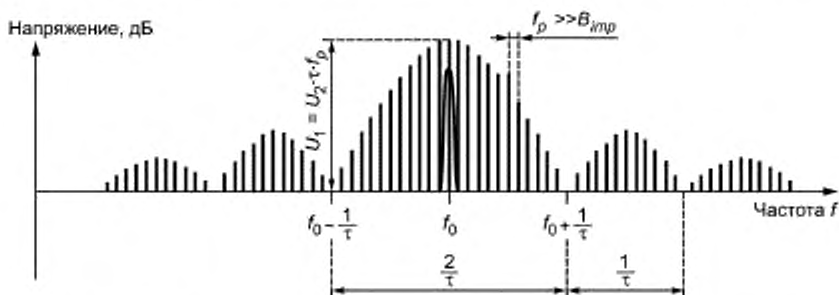


Рисунок Е.5 — Фильтрация, когда $B_{\text{имп}}$ намного меньше частоты повторения импульсов

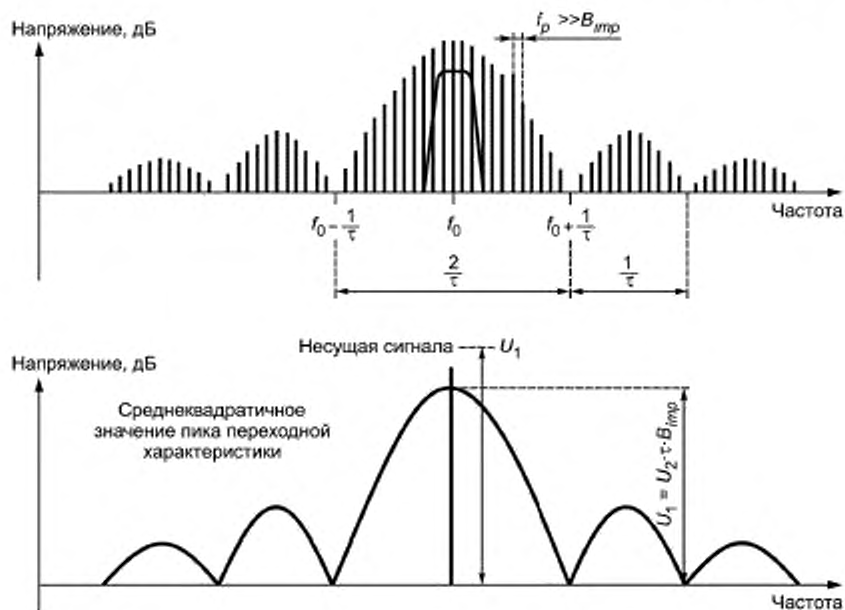


Рисунок E.6 — Фильтрация, когда значение $B_{\text{имп}}$ намного больше частоты повторения импульсов

При первом измерении (в случае $f_p \gg B_{\text{имп}}$) можно ожидать, что амплитуда U_2 в среднеквадратических значениях будет равна $U_2 = U_1 \cdot \tau \cdot f_{p1}$. Снизить неопределенность измерения можно, увеличив отношение «сигнал/шум» и обеспечив отсутствие перегрузки.

Во втором измерении (в случае $f_p \ll B_{\text{имп}}$) можно ожидать, что максимальный отклик в среднеквадратических значениях пика на переходный процесс будет

$$U_p = U_1 \cdot \tau \cdot B_{\text{имп}}$$

Если произведение $U_1 \cdot \tau$ при обоих измерениях одинаковое, то $B_{\text{имп}}$ по результатам двух измерений (см. также рисунок E.7) определяется как

$$B_{\text{имп}} = f_{p1} \cdot U_p / U_2 \quad (\text{E.7})$$

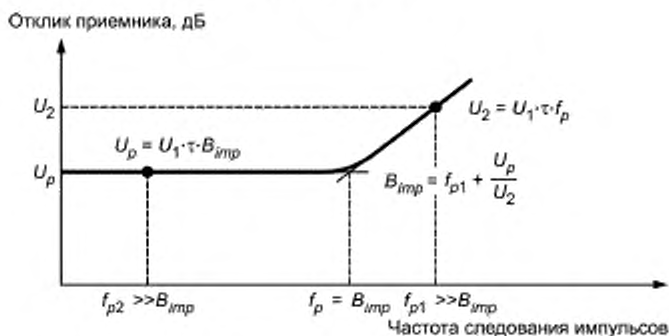


Рисунок E.7 — Расчет ширины импульсной полосы пропускания ИП

Метод 2. Определение $B_{\text{имп}}$ путем сравнения откликов на импульсный сигнал испытуемого и вспомогательного фильтров

В случае отсутствия генератора импульсов, имеющего независимую от частоты повторения импульсов амплитуду и при относительно низких значениях этой частоты, допускается применять метод 2.

Метод базируется на том же принципе, что и метод 1, однако вместо изменения частоты повторения импульсов при втором измерении в этом методе проводится замена испытуемого фильтра на вспомогательный фильтр, ширина полосы которого намного меньше частоты повторения импульсов.

Спектральную плотность импульсов D по данному методу определяют как

$$D = U_M f_p,$$

где U_M — измеренное напряжение спектральной линии (например, частоты несущей, если сигнал представляет собой импульсно-модулированную несущую, или центральной линии при частоте приемника, на которой следует измерять $B_{\text{имп}}$);

f_p — частота повторения импульсов. Значение f_p должно быть намного больше самой узкой полосы и намного меньше подлежащей измерению полосы $B_{\text{имп}}$, т. е. $B_{\text{партов}} \ll f_p \ll B_{\text{имп}}$ (примерные значения для $B_{\text{имп}} = 1 \text{ МГц}$, $B_{\text{партов}} = 9 \text{ кГц}$ и $f_p = 100 \text{ кГц}$).

Суть метода состоит в сравнении откликов узкополосного фильтра и испытуемого фильтра на немодулированный синусоидальный сигнал, поступающий на оба фильтра, и получении коэффициента коррекции c для расчета значения D ($c = U_1/U_2$, где U_1 — значение при «узкополосном» фильтре, а U_2 — при «широкополосном»).

При известном коэффициенте коррекции спектральную плотность можно найти как $D = c \cdot U_M f_p$. Когда значение D определено, измеряют значение U_p при пиковом детекторе и с помощью соотношения (Е.2) рассчитывают значение $B_{\text{имп}}$.

Метод 3. Определение $B_{\text{имп}}$ интегрированием нормализованной линейной функции частотной избирательности

Данный метод имеет среднюю точность и применяется при использовании фильтров (например, цифровых) с абсолютно линейной функцией частотной избирательности $U(f)$ и при условии, что ширина полосы видео в 10 или более раз превышает ширину импульсной полосы пропускания $B_{\text{имп}}$ ($B_{\text{video}} \gg B_{\text{имп}}$).

В этом случае импульсную ширину полосы измерительного приемника определяют как площадь нормализованной линейной функции избирательности $U(f)$ при коэффициенте нормализации $1/U_{\text{max}}$

$$B_{\text{имп}} = \frac{1}{U_{\text{max}}} \int_{-\infty}^{+\infty} U(f) df,$$

где U_{max} — максимальное значение $U(f)$.

Для измерения функции избирательности $U(f_n)$ измерительные приемники, имеющие цифровое отображение высокой разрешающей способности, можно настроить на N шагов Δf . Для корректного определения ширины импульсной полосы пропускания $B_{\text{имп}}$ измерения проводят на 100 частотах ($N = 101$), взятых с равномерным шагом Δf в пределах уровней до 60 дБ.

ИП с настройкой можно настроить так, чтобы начальная и конечная частоты совпали с точками 60 дБ кривой фильтра, а развертка позволяла получить значение амплитуды. Уровень подаваемого на вход фильтра испытательного синусоидального сигнала должен позволять отследить форму частотной характеристики испытуемого фильтра.

Значение $B_{\text{имп}}$ находят по формуле

$$B_{\text{имп}} = \frac{1}{U_{\text{max}}} \sum_{n=1}^N (U(f_n) + U(f_{n+1})) \frac{\Delta f}{2}.$$

Пример нормализованной линейной функции избирательности приведен на рисунке Е.8.

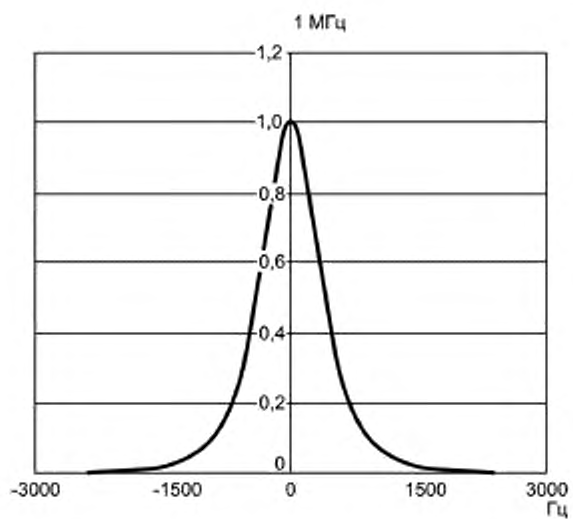


Рисунок Е.8 — Пример нормализованной линейной функции частотной избирательности

Приложение F
(обязательное)


**Проверка характеристик исключений из определения кратковременных ИРП
в соответствии с ГОСТ 30804.14.1, пункт 4.2.3**

С учетом исключений, приведенных в ГОСТ 30804.14.1—2013 (пункт 4.2.3), анализатор кратковременных ИРП должен фиксировать следующую дополнительную информацию:





- a) число кратковременных ИРП длительностью не более 10 мс;
- b) число кратковременных ИРП длительностью более 10 мс, но не более 20 мс включительно;
- c) число кратковременных ИРП длительностью более 20 мс, но не более 200 мс включительно;
- d) длительность каждой зарегистрированной ИРП, амплитуда которой превышает норму непрерывных ИРП в квазипиковых значениях;
- e) сообщение, что испытываемое техническое средство не прошло испытание на кратковременные ИРП, если результаты измерений показывают, что создаваемые ИРП не являются кратковременными (не соответствуют определению кратковременной ИРП) и не подпадают под действие какого-либо из исключений;
- f) временной интервал от начала испытания до появления ИРП;
- g) суммарную длительность ИРП, превышающих норму непрерывных ИРП в квазипиковых значениях, но не относящихся к кратковременным ИРП;
- h) частоту кратковременных ИРП.

Испытательные сигналы анализатора кратковременных ИРП В приведены в таблице F.1.




Таблица F.1 — Испытательные сигналы анализатора кратковременных ИРП а)

Номер испытания	Параметр испытательного сигнала						
	1		2		3	4	5
	Импульс 1	Импульс 2	Импульс 1	Импульс 2	Длительность интервала между импульсами (выход ПЧ), мс	Оценка помехи анализатором кратковременных ИРП	Графическое представление испытательного сигнала, наблюдаемого на выходе ПЧ, и связанного с ним квазипикового сигнала относительно опорного показания ИП
1	1		0,11				
2 ^{a)}	1		9,5			1 КВП ≤ 10 мс	


Продолжение таблицы F.1

Номер испытания	Параметр испытательного сигнала					Оценка помехи анализатором кратковременных ИРП	Графическое представление испытательного сигнала, наблюдаемого на выходе ПЧ, и связанного с ним квазипикового сигнала относительно опорного показания ИП		
	1		2		3			4	5
	Квазипиковое значение амплитуды импульсов, измеренное относительно квазипикового опорного показания ИП, дБ	Длительность импульсов ^{b)} , измеренных на выходе ПЧ измерительного приемника, мс	Длительность интервала между импульсами (выход ПЧ), мс	Импульс 1	Импульс 2			Импульс 1	Импульс 2
3а)	1	—	10,5	—	—	$10 \text{ мс} < 1 \text{ КВП} \leq \leq 20 \text{ мс}$			
4	1	—	19	—	—	$10 \text{ мс} < 1 \text{ КВП} \leq \leq 20 \text{ мс}$			
5	1	—	21	—	—	$1 \text{ КВП} > 20 \text{ мс}$			
6	1	—	190	—	—	$1 \text{ КВП} > 20 \text{ мс}$			

Продолжение таблицы F.1

Номер испытания	Параметр испытательного сигнала					Оценка помехи анализатором кратковременных ИРП	Графическое представление испытательного сигнала, наблюдаемого на выходе ПЧ, и связанного с ним квазиликового сигнала относительно опорного показания ИП		
	1		2		3			4	5
	Квазиликовое значение амплитуды импульсов, измеренное относительно квазиликового опорного показания ИП, дБ		Длительность импульсов ^{b)} , измеренных на выходе ПЧ измерительного приемника, мс		Длительность интервала между импульсами (выход ПЧ), мс				
Импульс 1	Импульс 2	Импульс 1	Импульс 2						
7	5	5	210	210	150	1 КВП > 20 мс, если сигнал появляется только один раз за цикл программы или за минимальное время наблюдения (см. примечание 1, Е.2, «правило 600 мс»)			
							1с		
							В ином случае — непрерывная помеха (570 мс)		
8	5	5	220	220	190	Непрерывная помеха (см. примечание 1, Е.2: никакое исключение не применимо, т. к. полная длительность 630 мс (> 600 мс). Вывод: ТС не проходит испытания)			
							1с		
9	5	5	190	190	190	Если частота повторения КВП менее 5, считают 2 КВП > 20 мс (см. примечание 1, Е.4; см. также примечание 3)			
							1с		
							В ином случае 1 КВП > 20 мс, если сигнал появляется только один раз за цикл программы или за минимальное время наблюдения (см. примечание 1, Е.2). В противном случае: непрерывная помеха (570 мс). Вывод: ТС не проходит испытания		

Продолжение таблицы F.1

Номер испытания	Параметр испытательного сигнала					Оценка помехи анализатором кратковременных ИРП	Графическое представление испытательного сигнала, наблюдаемого на выходе ПЧ, и связанного с ним квазипикового сигнала относительно опорного показания ИП		
	1		2		3			4	5
	Квазипиковое значение амплитуды импульсов, измеренное относительно квазипикового опорного показания ИП, дБ		Длительность импульсов ^{b)} , измеренных на выходе ПЧ измерительного приемника, мс		Длительность интервала между импульсами (выход ПЧ), мс				
Импульс 1	Импульс 2	Импульс 1	Импульс 2						
10	5	5	50	50	185	Если конечная частота КВП менее 5, считают 2 КВП > 20 мс (см. примечание 1, Е.4; см. также примечание 3)	 <p style="text-align: right;">1с</p>		
						В ином случае, если сигнал появляется не более одного раза за цикл программы или за минимальное время наблюдения, считают 1 КВП < 600 мс (см. примечание 1, Е.2, 2 · 285 мс > > 20 мс). В противном случае: непрерывная помеха (285 мс). Вывод: ТС не проходит испытания	—		
11	20	20	15	5	1 импульс · 1 + + 9 импульсов 2, повторяются до регистрации 40 КВП при расстоянии между каждым импульсом 13 с	36 КВП < 10 мс; 20 мс ≥ 4 КВП > > 10 мс; более 90 % КВП < 10 мс. Вывод: ТС проходит испытания. (см. примечание 1, Е.3; см. также примечание 4; измерение амплитуд КВП не требуется)	—		

Продолжение таблицы F.1

Номер испытания	Параметр испытательного сигнала					Оценка помехи анализатором кратковременных ИРП	Графическое представление испытательного сигнала, наблюдаемого на выходе ПЧ, и связанного с ним квазиликового сигнала относительно опорного показания ИП		
	1		2		3			4	5
	Импульс 1	Импульс 2	Импульс 1	Импульс 2	Длительность интервала между импульсами (выход ПЧ), мс			Квазиликовое значение амплитуды импульсов, измеренное относительно квазиликового опорного показания ИП, дБ	Длительность импульсов ^{б)} , измеренных на выходе ПЧ измерительного приемника, мс
12	20	20	15	5	1 импульс 1 + 8 импульсов · 2, повторяются до регистрации 40 КВП при расстоянии между каждым импульсом 13 с	35 КВП < 10 мс; 20 мс ≥ 5 КВП > 10 мс; менее 90 % КВП < 10 мс (см. примечание 1, Е.3; см. также примечание 4). Исключение не применяется. После применения метода верхнего квартиля итоговым результатом будет вывод: ТС не проходит испытания, так как амплитуды КВП слишком велики	—		

а) Испытательные сигналы, используемые для проверки характеристик с учетом исключений из определения КВП в соответствии с ГОСТ 30805.14.1—2013 (пункт 4.2.3).

б) Время нарастания импульсов должно быть не более 40 мкс.

Примечания

1 В ГОСТ 30805.14.1—2013 (пункт 4.2.3), установлены следующие исключения.

Е1 — «отдельные операции коммутации»

Применить данное исключение может только оператор; оно не может быть оценено автоматически анализатором кратковременных ИРП. Данное исключение учтено в настоящем разделе, для того чтобы избежать путаницы с проставлением номеров исключений для пользователей настоящего стандарта и ГОСТ 30805.14.1.

Е2 — «комбинация кратковременных помех (КВП) во временном интервале менее 600 мс» («правило 600 мс»)

В испытуемых ТС с программным управлением комбинация КВП во временном интервале менее 600 мс допускается один раз за выбранный цикл программы. Для других испытуемых ТС такая комбинация КВП допускается 1 раз за минимальное время наблюдения. Это также относится к трехфазным коммутаторам с термостатическим управлением, создающим три помехи в каждой из трех фаз соответственно, и нейтральном проводе. Комбинация КВП рассматривается как 1 КВП.

Е3 — «мгновенная коммутация»

Технические средства, создающие помехи, отвечающие условиям:

- частота повторения КВП не более 5;
- ни одна из создаваемых КВП не имеет длительность более 20 мс;
- 90 % создаваемых КВП имеют длительность менее 10 мс,

должны считаться прошедшими испытания (соответствующими нормам) независимо от амплитуды КВП. Если одно из трех условий не выполнено, применяют нормы непрерывных ИРП.

Е4 — «разделение КВП длительностью менее 200 мс»

Для технических средств, у которых частота КВП менее 5, любые две помехи, каждая из которых имеет максимальную длительность 200 мс, должны расцениваться как 2 КВП, даже если интервал времени между помехами менее 200 мс. В этом случае, например для помех от холодильников, такие помехи должны расцениваться как две КВП, а не как непрерывная помеха.

Окончание таблицы F.1

2 Исключение E.2 должно применяться в том случае, если неприменимо исключение E.4.

3 Проверочные сигналы 11 и 12 применяются только в случае, если можно использовать исключение E.3, так как следующий расчет показывает, что включая КВП при «0» секунд для проверочных сигналов 11 и 12 требуемые 40 КВП будут отсчитываться после $13 \text{ с} \cdot 39 = 507 \text{ с}$, т. е. 8,45 мин. Частота КВП составляет $40/8,45 = 4,734$ (менее 5, как и требуется, — здесь все зависит от того, длительность 90 % КВП менее 10 мс или нет).

4 Ослабление нормы для КВП в соответствии с ГОСТ 30805.14.1 равно $20 \lg(30/4,734) = 16,04$ (дБ). Следовательно, при проверочных сигналах 11 и 12 (амплитуда на 20 дБ превышает норму) испытываемое ТС не проходит проверку по методу верхнего квартиля (допускающего, что не более 25 % КВП могут превысить норму кратковременных ИРП) в соответствии с ГОСТ 30805.14.1.













Номер испытания	Испытательный сигнал	Оценка с помощью анализатора
1	 0,11 мс/1 дБ	1 КВП ≤ 10 мс
2	 9,5 мс/1 дБ	1 КВП ≤ 10 мс
3	 10,5 мс/1 дБ	10 мс < 1 КВП ≤ 20 мс
4	 19 мс/1 дБ	10 мс < 1 КВП ≤ 20 мс
5	 21 мс/1 дБ	1 КВП > 20 мс
6	 190 мс/1 дБ	1 КВП > 20 мс
7	 210 мс/5 дБ 150 мс 210 мс/5 дБ	1 КВП ≤ 600 мс (программно-управляемые ТС)
8	 220 мс/5 дБ 190 мс 220 мс/5 дБ	Непрерывные ≥ 600 мс
9	 190 мс/5 дБ 190 мс 190 мс/5 дБ	1 КВП ≤ 600 мс (считаются как 2 КВП по правилу рефрижератора)
10	 50 мс/5 дБ 185 мс 50 мс/5 дБ	Для $N < 5$ – 2 КВП Для $N \geq 5$ – непрерывные или 1 КВП < 600 мс – для программно-управляемых ТС
11	 15 мс/20 дБ 9 импульсов/5 мс/20 дБ 15 мс/20 дБ повторяются до регистрации 40 КВП	36 КВП ≤ 10 мс 10 мс < 4 КВП ≤ 20 мс
12	 15 мс/20 дБ 8 импульсов/5 мс/20 дБ 15 мс/20 дБ повторяются до регистрации 40 КВП	35 КВП < 10 мс 10 мс < 5 КВП ≤ 20 мс

Рисунок F.1 — Графическое представление испытательных сигналов, используемых при проверке работы анализатора кратковременных ИРП, соответствующего дополнительным требованиям, приведенным в таблице E.1

Приложение G
(справочное)

Требования к нахождению функции распределения амплитуд ИРП

а) Динамический диапазон амплитуд ИРП

Динамический диапазон амплитуд ИРП определяют как интервал, включающий в себя все возможные значения амплитуд ИРП, необходимый для измерения функции распределения амплитуд. Верхний предел динамического диапазона должен быть больше пикового уровня измеряемой ИРП, а нижний — меньше нормы ИРП, установленной для конкретного испытуемого ТС.

В соответствии с ГОСТ 30805.11 норма ИРП (пиковое значение) для ПНМБ устройств группы 2 класса В установлена равной 110 дБ мкВ/м, а «взвешенная» норма составляет 60 дБ мкВ/м. Следовательно, динамический диапазон должен быть больше 60 дБ (с запасом 10 дБ).

б) Частота выборки

В идеальном случае функцию распределения амплитуд ИРП определяют с использованием эквивалентной ширины полосы защищаемой радиослужбы. Однако для частот свыше 1 ГГц полосу разрешения анализаторов помех определяют как 1 МГц. Поэтому скорость выборки должна быть более 10 млн отсчетов в секунду.

с) Максимальное время измерения

В ГОСТ 30805.11 определено максимальное время удержания 2 мин при измерениях ИРП от микроволновых печей для приготовления пищи с применением измерителя с пиковым детектором на частоте свыше 1 ГГц. Следовательно, время измерения при определении функции распределения должно быть не менее 2 мин. Размер счетчика или ограниченность памяти могут затруднить проведение непрерывных измерений в течение длительных периодов. Поэтому допускаются периодические измерения при условии, что общее время пауз между измерениями составляет менее 1 % полного времени измерения.

д) Минимальное время измерения

Для получения достоверно значимого результата могут потребоваться около 100 циклов измерений. Поэтому минимальное значение фиксируемой вероятности рассчитывают следующим образом.

Считают, что время измерения равно 2 мин, а число отсчетов — 10 млн в секунду; следовательно, минимальная вероятность определяется как

$$100 / (120 \cdot 10 \cdot 10^6) = 10^{-7}.$$

е) Отображение данных распределения вероятностей амплитуд ИРП

Амплитудное разрешение при отображении результатов распределения амплитуд ИРП зависит от динамического диапазона и разрешающей способности аналого-цифрового преобразователя. Например, разрешение отображения становится менее 0,25 дБ (~ 60 дБ/256) при использовании 8-битового аналого-цифрового преобразователя при динамическом диапазоне амплитуд ИРП, равном 60 дБ.

Блок-схемы устройств измерения функции распределения амплитуд ИРП представлены на рисунках G.1, G.2. Пример функции распределения амплитуд ИРП приведен на рисунке G.3.

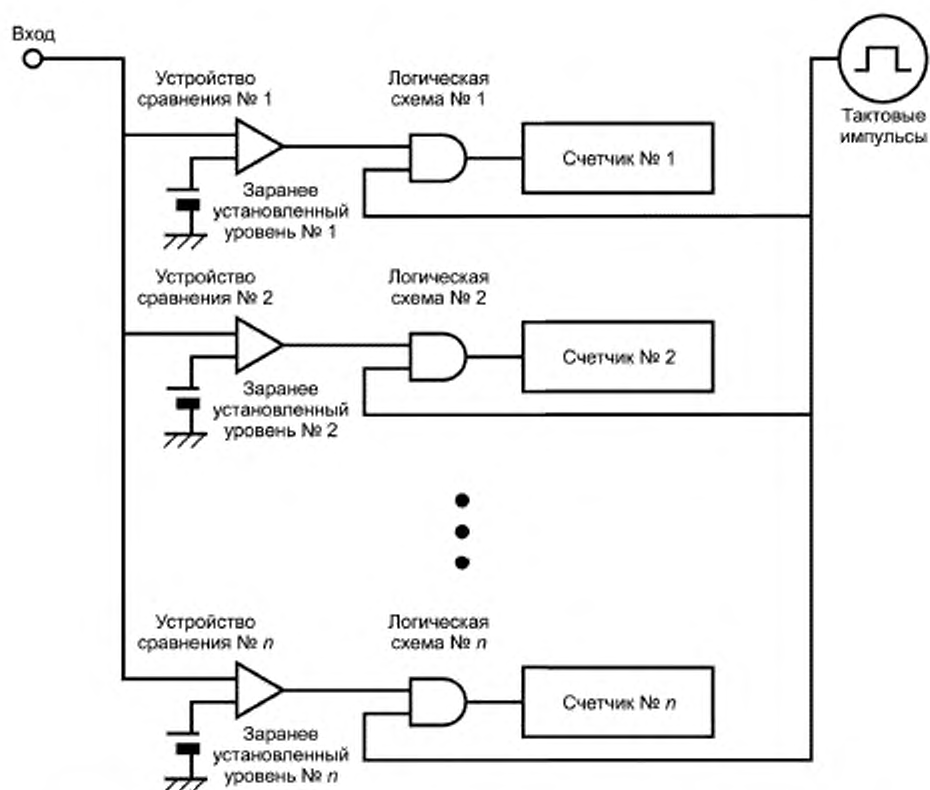


Рисунок G.1 — Блок-схема устройства измерения функции распределения амплитуд ИРП без аналого-цифрового преобразователя

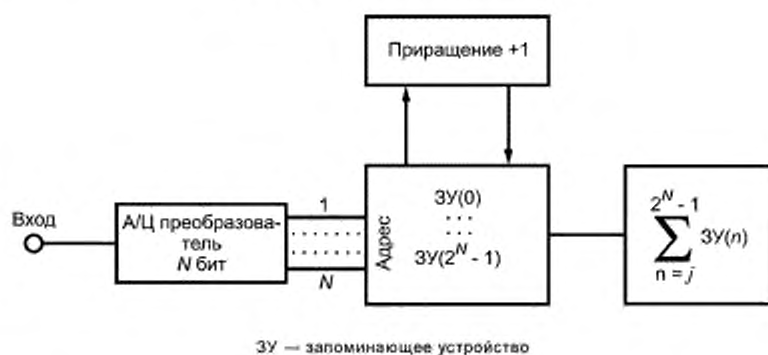


Рисунок G.2 — Блок-схема устройства измерения функции распределения амплитуд ИРП с аналого-цифровым преобразователем

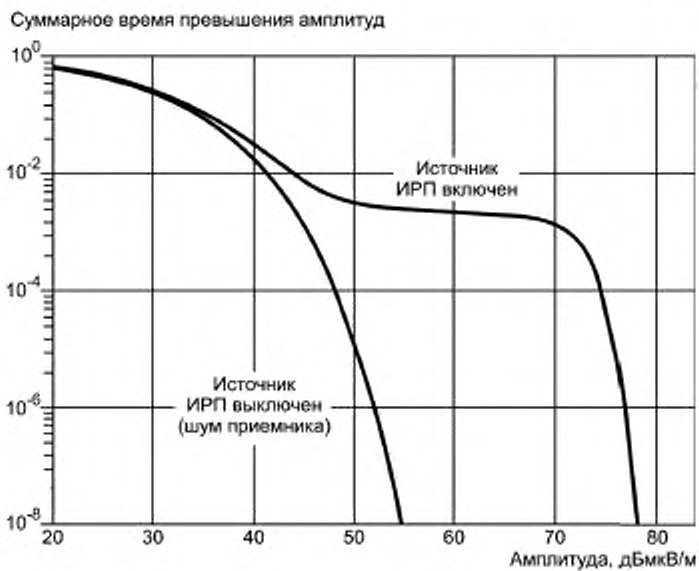


Рисунок G.3 — Пример функции распределения амплитуд ИРП

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов
международным стандартам, использованным в качестве ссылочных
в примененном международном стандарте**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ 30372 (IEC 60050-161:1990)	MOD	IEC 60050-161 «Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная совместимость»
ГОСТ 30805.11—2002 (CISPR 11—97)	MOD	CISPR 11 «Промышленное, научное и медицинское оборудование. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений»
ГОСТ 30805.14.1—2013 (CISPR 14-1:2005)	MOD	CISPR 14-1 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых устройств, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
<p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD — модифицированные стандарты.</p>		

Библиография

- [1] CISPR 16-2 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Methods of measuring of disturbance and immunity
(Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Методы измерения радиопомех и помехоустойчивости)
- [2] CISPR 16-3:2003¹⁾ Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 3: CISPR technical reports
(Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 3. Технические отчеты СИСПР)
- [3] CISPR 16-4²⁾ Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Uncertainties, statistics and limit modelling
(Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Неопределенности, статистика и моделирование норм)
- [4] IEC 60050-161:1990 International electrotechnical vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility
(Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная совместимость)
- [5] EN 50065-1/A2: 2001 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz — Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances
(Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Часть 1. Общие требования, полосы частот и электромагнитные помехи)

¹⁾ Заменен на CISPR/TR 16-3 (2012).

²⁾ Заменен на CISPR 16-4-2 (2018).

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, измерительные приемники, детектор, полоса частот, импульсная характеристика, промышленные радиопомехи, кратковременные радиопомехи

Редактор переиздания *Е.В. Яковлева*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.И. Рычкова*
Компьютерная верстка *Д.В. Кардановской*

Сдано в набор 27.05.2020. Подписано в печать 17.08.2020. Формат 60 × 84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 6,98. Уч.-изд. л. 5,30.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.junsizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ 30805.16.1.1—2013 (CISPR 16-1-1:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения промышленных радиопомех

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан

(ИУС № 7 2019 г.)