

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
8.766—  
2011

---

Государственная система обеспечения единства  
измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА  
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ  
КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННЫХ В ВОДЕ  
ГАЗОВ (КИСЛОРОДА, ВОДОРОДА)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1097-ст

4 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА  
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  
РАСТВОРЕНИЙ В ВОДЕ ГАЗОВ (КИСЛОРОДА, ВОДОРОДА)

State system for ensuring the uniformity of measurements.  
State verification schedule for instruments measuring mass concentration  
dissolving in water gasses (oxygen, hydrogen)

Дата введения — 2013—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему [рисунок А.1 (приложение А)] для средств измерений единиц массовой концентрации растворенных в воде кислорода и водорода и устанавливает порядок передачи размеров единиц массовой концентрации растворенного в воде кислорода в диапазоне от 5 до 100000 мкг/дм<sup>3</sup> и массовой концентрации растворенного в воде водорода в диапазоне от 5 до 20000 мкг/дм<sup>3</sup> от государственного первичного эталона с помощью рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ 22018—84 Анализаторы растворенного в воде кислорода амперометрические ГСП. Общие технические требования

**П р и м е ч а н и е** — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при использовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

**3 Государственный первичный эталон**

3.1 В состав Государственного первичного эталона входят следующие средства измерений и оборудование: рабочая камера; блок компрессора; ресивер-азратор; магнитная мешалка; манометр; вакуумметр; термостат; эталонный термометр; барометр образцовый; баллоны со смесями газовыми поверочными — стандартные образцы состава.

3.2 Государственный первичный эталон обеспечивает:

- воспроизведение единицы массовой концентрации растворенного в воде кислорода в диапазоне от 5 до 100000 мкг/дм<sup>3</sup>, среднее квадратическое отклонение (СКО) от 0,2 до 30 мкг/дм<sup>3</sup>, неисключенная систематическая погрешность (НСП) от 0,5 до 130 мкг/дм<sup>3</sup>;
- воспроизведение единицы массовой концентрации растворенного в воде водорода в диапазоне от 5 до 20000 мкг/дм<sup>3</sup>, СКО от 0,8 до 80 мкг/дм<sup>3</sup>, НСП от 1,0 до 120 мкг/дм<sup>3</sup>.

3.3 Государственный первичный эталон воспроизводит единицы массовой концентрации растворенных в воде кислорода и водорода (мг/дм<sup>3</sup>).

3.4 Государственный первичный эталон применяют для хранения и передачи единиц массовой концентрации растворенных в воде кислорода и водорода рабочим эталонам методом непосредственного сличения и методом сличения с помощью компаратора и рабочим средствам измерений методом непосредственного сличения.

#### 4 Рабочие эталоны

4.1 В качестве рабочих эталонов применяют:

- анализаторы кислорода, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 5 до 100000 мкг/дм<sup>3</sup>;
- анализаторы водорода, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода от 5 до 20000 мкг/дм<sup>3</sup>;
- водные растворы — рабочие эталоны растворенного в воде кислорода (диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 5 до 100000 мкг/дм<sup>3</sup>) и водорода (диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода от 5 до 20000 мкг/дм<sup>3</sup>).

4.2 Относительная погрешность измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода рабочими эталонами не должна превышать 1,5 %.

4.3 Относительная погрешность измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода рабочими эталонами не должна превышать 2 %.

4.4 Рабочие эталоны применяют для передачи единиц массовой концентрации растворенных в воде кислорода и водорода рабочим средствам измерений методом непосредственного сличения и методом сличения с помощью компаратора.

#### 5 Рабочие средства измерений

5.1 В качестве рабочих средств измерений применяют:

- анализаторы кислорода амперометрические (оксиметры), диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 5 до 100000 мкг/дм<sup>3</sup>, по ГОСТ 22018;
- анализаторы кислорода оптические (волоконно-оптические анализаторы кислорода), диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 5 до 100000 мкг/дм<sup>3</sup>;
- кислородные титраторы автоматические, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 5 до 100000 мкг/дм<sup>3</sup>;
- анализаторы водорода амперометрические, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода от 5 до 20000 мкг/дм<sup>3</sup>.

5.2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода рабочими средствами измерений составляют от 1,5 % до 10 %.

5.3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода рабочими средствами измерений составляют от 2 % до 15 %.

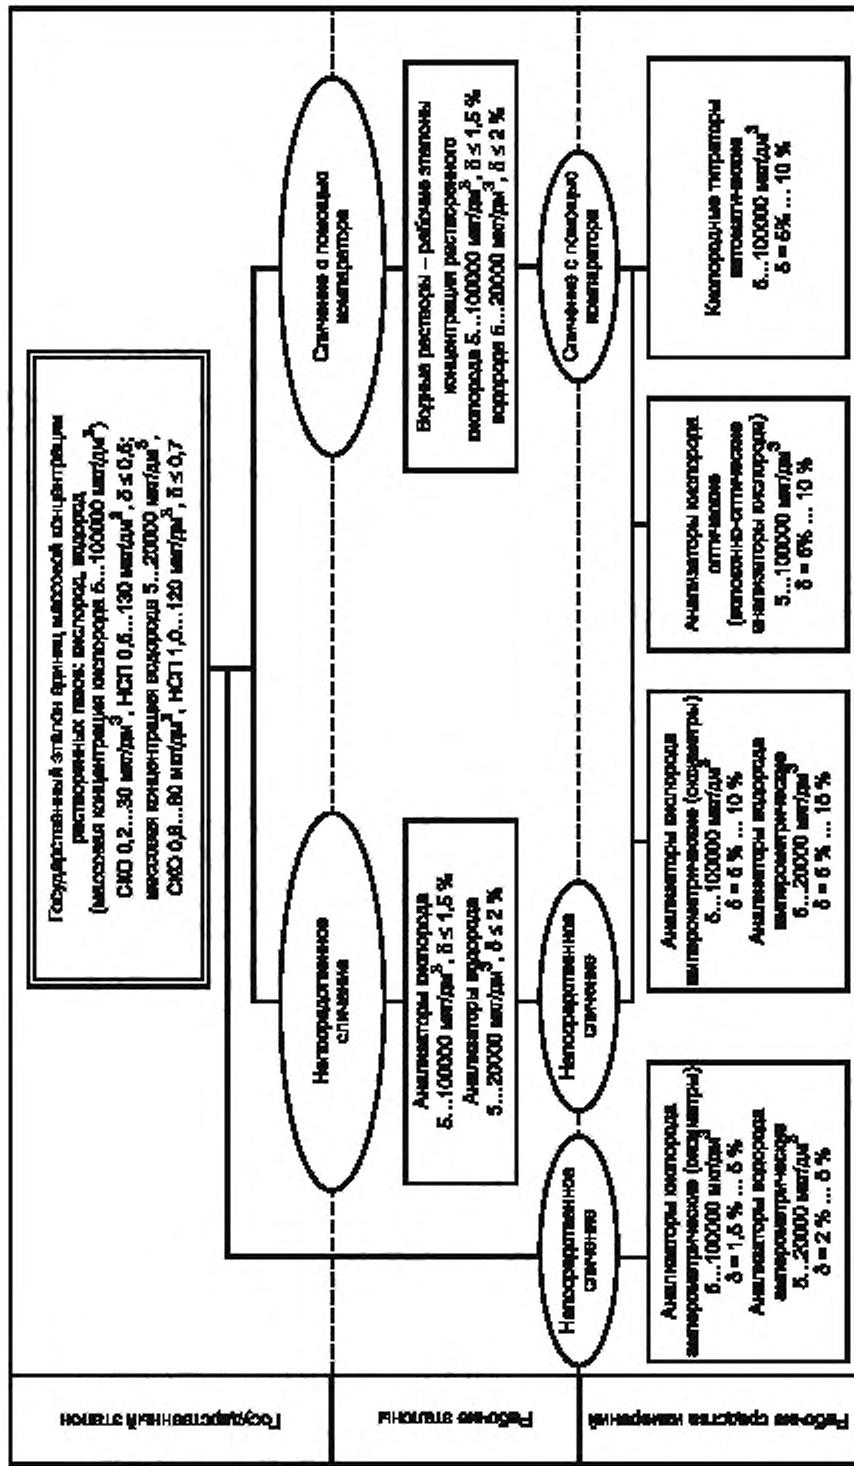
Приложение A  
(обязательное)

Рисунок А.1 – Гидрохимическая обработка поверхности стальных

**ГОСТ Р 8.766—2011**

---

УДК 544.023.523:006.354

ОКС 17.020

Т84.5

ОКСТУ 0008

Ключевые слова: поверочная схема, кислород, водород, массовая концентрация, государственный первичный эталон

---

Редактор *О.А. Стояновская*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *М.И. Першина*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 23.12.2013. Подписано в печать 15.01.2014. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,45. Тираж 123 экз. Зак. 33.

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)