
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
33312—
2015

ПРОДУКЦИЯ СОКОВАЯ

Определение гваяколя методом газовой хроматографии

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Российский союз производителей соков» (РСПС) при участии Закрытого акционерного общества «Мултон» (ЗАО «Мултон»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 18 июня 2015 г. № 47)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2015 г. № 1048-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33312—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, оформление, 2016, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ПРОДУКЦИЯ СОКОВАЯ

Определение гвайакола методом газовой хроматографии

Juice products. Determination of guaiacol by gas chromatography

Дата введения — 2017—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы (далее — соковая продукция) и устанавливает метод газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ГХ-МС) для качественного определения гвайакола.

Предел обнаружения гвайакола — 0,3 мкг/дм³.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4233 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 9293 Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 17433 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

ГОСТ 22300 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы. Основные параметры и размеры

ГОСТ 26313 Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 26671 Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов

ГОСТ 31643 Продукция соковая. Определение аскорбиновой кислоты методом высокоеффективной жидкостной хроматографии

ГОСТ ОИМЛ R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ ISO 3696* Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ ISO 7886-1 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования

ГОСТ ISO/IEC 17025—2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501—2005 «Вода для лабораторного анализа. Технические условия».

ГОСТ ИСО 5725-1* Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

При меч ани е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения, сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 гвяжол (2-метоксифенол): Органическое вещество класса фенолов, продукт жизнедеятельности бактерий рода *Alicyclobacillus*, с характерным сладковатым, фенольным, немного дымным ароматом, напоминающим аромат копчения.

3.2 режим SIM (selected ion monitoring mode): Режим селективного мониторинга ионов, обеспечивающий идентификацию и количественное определение заданных веществ из библиотечного списка [1] по характерным для этих веществ ионам.

4 Сущность метода

Метод основан на извлечении гвяжола из пробы этилацетатом, концентрировании экстракта, газохроматографическом разделении на кварцевой капиллярной колонке с последующей идентификацией на масс-спектрометре путем сравнения времен удерживания и масс-спектров электронной ионизации.

Определению не мешают нерастворимые в воде вещества.

5 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда и реактивы

5.1 Хроматограф газовый, оснащенный масс-спектрометрическим детектором, позволяющим проводить измерения в диапазоне масс от 15 до 350 а. е. м. в режиме электронной ионизации при энергии электронов 70 эВ, масс-спектральном разрешении не менее 1 а. е. м. по всей шкале масс и программным обеспечением для сбора и обработки данных, включающим справочную библиотеку масс-спектров [1].

5.2 Колонка кварцевая капиллярная с неполярной фазой состава: 5 % фенилдиметилполисилаксан и 95 % силикагель, длиной 60 м и внутренним диаметром 0,25 мм**.

5.3 Весы лабораторные по ГОСТ ОИМЛ R 76-1 с наибольшим пределом взвешивания 220 г и пределом допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,01$ г.

5.4 Микрошприцы вместимостью 1 мм^3 с пределами допускаемой относительной погрешности дозирования $\pm 6,0$ %.

5.5 Дозаторы пипеточные одноканальные переменного объема от 100 до 1000 мм^3 с допустимой относительной погрешностью дозирования ± 2 % по воде с соответствующими наконечниками.

5.6 Контейнеры для проб (виалы) вместимостью 2 см^3 с завинчивающейся крышкой и силикон-телефлоновой септой для анализа жидких проб.

5.7 Стаканы В-1-100 и В-1-50 по ГОСТ 25336.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения».

** Допускается применение капиллярных колонок других типов, обеспечивающих разделение, аналогичное приведенному в приложении А, рисунки А.1—А.3. Данная информация является рекомендуемой и приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

5.8 Центрифуга лабораторная с частотой вращения не менее 9000 мин⁻¹ с адаптером для пробирок вместимостью 50 см³.

5.9 Пробирки центрифужные полимерные вместимостью 50 см³ с завинчивающейся крышкой.

5.10 Оборудование для концентрирования пробы, например концентратор или испаритель ротационный с испарительной колбой вместимостью 50 см³.

5.11 Гвяякот для хроматографии, с массовой долей основного вещества не менее 99,5 %.

5.12 Этилацетат по ГОСТ 22300, х. ч.

5.13 Натрий хлористый по ГОСТ 4233, х. ч.

5.14 Азот газообразный по ГОСТ 9293, о. ч.

5.15 Гелий с содержанием гелия не менее 99,9999 %.

5.16 Воздух сжатый класса «0» по ГОСТ 17433. Допускается использовать компрессоры любого типа, обеспечивающие необходимое давление и чистоту воздуха.

5.17 Шприц медицинский номинальной вместимостью 10 см³ по ГОСТ ISO 7886-1.

5.18 Стандарт калибровочный для масс-спектрометрического детектора — перфтор-5,8-диметил-3,6,9-триоксидодекан (ПФДТД).

5.19 Пропилбензол с содержанием основного вещества не менее 99,8 %.

5.20 Вставки для виал вместимостью 2 см³ (см. 5.6) для измерения микроколичеств проб.

5.21 Колбы мерные 2-50-2, 2-100-2 по ГОСТ 1770.

5.22 Цилиндр 2-100-1 по ГОСТ 1770.

5.23 Вода по ГОСТ ISO 3696, 2-й степени чистоты.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, посуды не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, а также реагентов, по качеству не хуже вышеуказанных.

6 Отбор и подготовка проб

6.1 Отбор проб — по ГОСТ 26313, подготовка лабораторных проб — по ГОСТ 26671.

6.2 Подготовка проб осветленной соковой продукции — по ГОСТ 31643—2012 (пункт 6.2.1).

Подготовка проб соковой продукции с объемной долей мякоти до 10,0 % включительно или содержащих нерастворимые в воде вещества — по ГОСТ 31643—2012 (пункт 6.2.2).

Концентрированную соковую продукцию разбавляют водой в пять раз весовым методом и далее проводят подготовку по ГОСТ 31643—2012 (пункты 6.2.1, 6.2.2).

7 Условия выполнения измерений

При приготовлении растворов, подготовке к проведению измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7;
- относительная влажность, % не более 85;
- напряжение в питающей сети, В 220 ± 20;
- частота тока в питающей сети, Гц 50 ± 1.

Хроматографические измерения проводят при условиях, указанных в руководстве по эксплуатации прибора.

Помещение, в котором проводят работы с реагентами, должно быть обеспечено приточно-вытяжной вентиляцией.

Все операции с реагентами следует проводить в вытяжном шкафу.

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Подготовка прибора к выполнению измерений

Подготовку хромато-масс-спектрометра к работе, вывод его на рабочий режим и выключение по окончании работы осуществляют в соответствии с руководством по эксплуатации и устанавливают параметры, рекомендуемые изготовителем капиллярных колонок.

Настройку масс-спектрометрического детектора проводят по калибровочному стандарту — перфтор-5,8-диметил-3,6,9-триоксидодекан (ПФДТД), согласно инструкции по эксплуатации.

Для капиллярной колонки устанавливают следующие рабочие параметры:

- режим программирования температуры термостата колонки в соответствии с таблицей 1;

Таблица 1

Область графика температуры	Скорость нагрева, °С/мин	Значение температуры, °С	Время выдержки, мин
Начальная точка	—	35	0
Участок 1	8	140	0
Участок 2	3	170	0
Участок 3	8	300	3

- температура термостата испарителя (инжектора), °С 225 ± 2 ;
- тип инжектора без деления потока;
- температура детектора, °С 200 ± 2 ;
- объемная скорость газа-носителя, см³/мин $1,0 \pm 0,1$;
- объем вводимой пробы, мм³ 1—2.

При меч ани е — Объем вводимой пробы зависит от чувствительности детектора и разрешающей способности колонки.

Масс-спектрометрический детектор:

- температура ионного источника, °С 230 ± 1 ;
- температура квадрупольного анализатора, °С 150 ± 1 ;
- температура интерфейса, °С 280 ± 1 ;
- задержка на растворитель, мин 12 ± 2 ;
- режим ионизации электронный удар;
- режим сканирования SIM;
- скорость сканирования 5 ск/с.

Допускается применения других условий и параметров настройки масс-спектрометрического детектора, обеспечивающих необходимую чувствительность и разделение, аналогичное приведенному в приложении А, рисунки А.1—А.2.

9 Проведение измерений

9.1 Приготовление основного стандартного раствора гвяколя с массовой концентрацией 500 мг/дм³

В мерной колбе вместимостью 100 см³ взвешивают ($0,05 \pm 0,01$) г гвяколя, доводят до метки этилацетатом и тщательно перемешивают.

Срок хранения раствора при температуре не выше 4 °С — не более 30 сут.

9.2 Приготовление рабочего стандартного раствора гвяколя с массовой концентрацией 1 мг/дм³

В мерную колбу вместимостью 100 см³ вносят 0,2 см³ основного стандартного раствора, приготовленного по 9.1, доводят этилацетатом до метки и перемешивают.

Раствор используют свежеприготовленным при измерениях.

9.3 Приготовление рабочего стандартного раствора гвяколя с массовой концентрацией 1 мкг/дм³

В мерную колбу вместимостью 100 см³ вносят 0,1 см³ рабочего стандартного раствора, приготовленного по 9.2, доводят этилацетатом до метки и перемешивают.

Раствор используют свежеприготовленным для проверки чувствительности детектора.

9.4 Проведение измерений

9.4.1 В две центрифужные пробирки вместимостью 50 см³ помещают по 15 г хлорида натрия, 40 см³ пробы соковой продукции, подготовленной по 6.2, и 5 см³ этилацетата, завинчивают крышкой и встряхивают до полного перемешивания. Пробирки с подготовленной смесью центрифицируют при 9000 об/мин в течение 10 мин. Затем из каждой пробирки через иглу отбирают в медицинский шприц отделившийся верхний слой этилацетата и переносят в стакан вместимостью 50 см³ по ГОСТ 25336. Объем пробы уменьшают до 100 мм³ посредством вытеснения этилацетата током азота («отдувка» азотом), концентрируя тем самым пробу примерно в 800 раз. Полученный объем (около 100 мм³) этилацетата переносят во вставку для микролитражей (см. 5.20), которую помещают в виалу вместимостью 2 см³ (см. 5.6) и проводят хроматографические измерения.

9.4.2 Проводят измерения двух проб в условиях повторяемости в соответствии с требованиям ГОСТ ИСО 5725-1, регистрируют на масс-спектрах набор характерных для гвяяколя ионов, соответствующих области времени удерживания гвяяколя.

Измерения проводят в автоматическом режиме с помощью программы управления автосамплера и хроматографа или в режиме ручного ввода.

Масс-спектр хроматографического пика, полученного при хроматографировании пробы, сравнивают со стандартным для искомого вещества масс-спектром по базе данных (например, библиотека [1]) или стандарта гвяяколя (рабочий стандартный раствор гвяяколя с массовой концентрацией 1 мг/дм³, приготовленный по 9.2). Детектирование гвяяколя проводят по группе индивидуальных характерных ионов $m/z = 81, 109, 124$ (режим SIM). Оценивают совпадение времени удерживания и совпадение масс-спектра по характерным ионам идентифицируемого соединения с масс-спектром гвяяколя по [1] или масс-спектром стандарта гвяяколя (см. 5.11).

9.4.3 Гвяякол в пробе считают обнаруженным при следующих условиях:

- время удерживания искомого соединения отличается от среднего времени удерживания гвяяколя, найденного при измерении рабочего раствора (см. приложение А, рисунок А.1) не более чем на 5 %;

- вероятность совпадения масс-спектра хроматографического пика, полученного по 9.4.2, с масс-спектром стандарта гвяяколя (см. 5.11) или с масс-спектром гвяяколя по [1] не менее 80 %.

Указанные критерии касаются только идентификации гвяяколя в пробе.

Вывод о наличии гвяяколя в пробе в пределах чувствительности метода должен следовать из сравнения пика гвяяколя в стандартном растворе для определения чувствительности и пика гвяяколя в пробе.

10 Оформление результатов измерений

Результаты измерений регистрируют в протоколе испытаний согласно ГОСТ ISO/IEC 17025 с указанием метода и настоящего стандарта.

В случае положительной идентификации в протоколе указывают факт присутствия гвяяколя в пробе в пределах чувствительности метода.

Контроль качества результатов измерений проводят в соответствии с приложением Б.

11 Требования безопасности

11.1 Условия безопасного проведения работ

При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реагентами по ГОСТ 12.1.007.

Эксплуатация хромато-масс-спектрометра и проведение соответствующих измерений требуют соблюдения правил электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и инструкции по эксплуатации прибора.

11.2 Требования к квалификации операторов

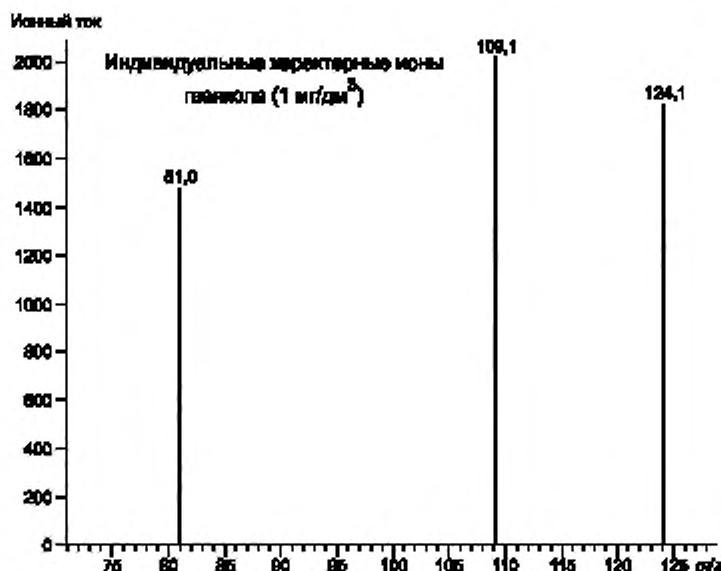
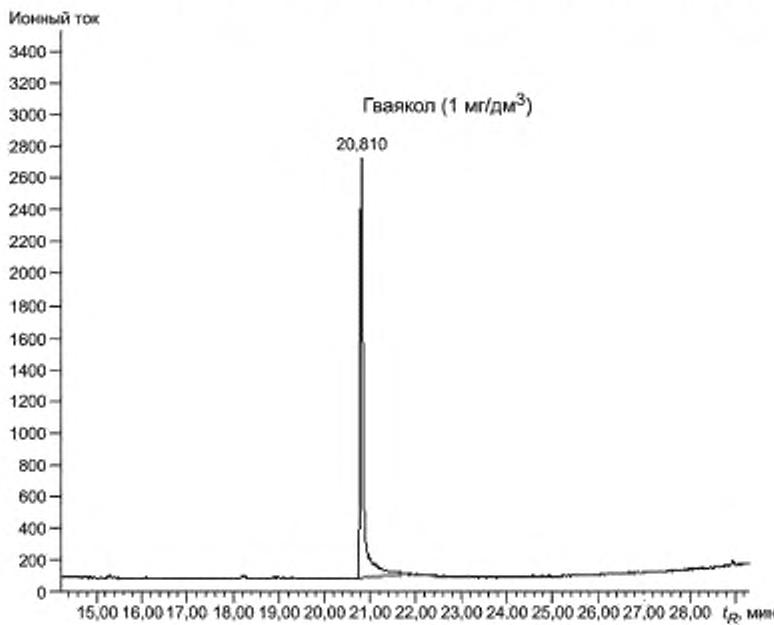
К выполнению измерений, обработке и оформлению результатов допускаются сотрудники, изучившие инструкцию по эксплуатации оборудования, освоившие настоящий метод и имеющие стаж работы в лаборатории не менее одного года.

Внедрение метода в лаборатории должно проводиться под руководством специалиста, владеющего методом хромато-масс-спектрометрии и имеющего практические навыки в этой области.

Приложение А
(справочное)

Примеры хроматограмм и параметры идентификации гвайакола

А.1 Примеры хроматограмм и параметры идентификации гвайакола приведены на рисунках А.1, А.2.

Рисунок А.1 — Хроматограмма и масс-спектр рабочего раствора гвайакола с массовой концентрацией 1 мг/дм³

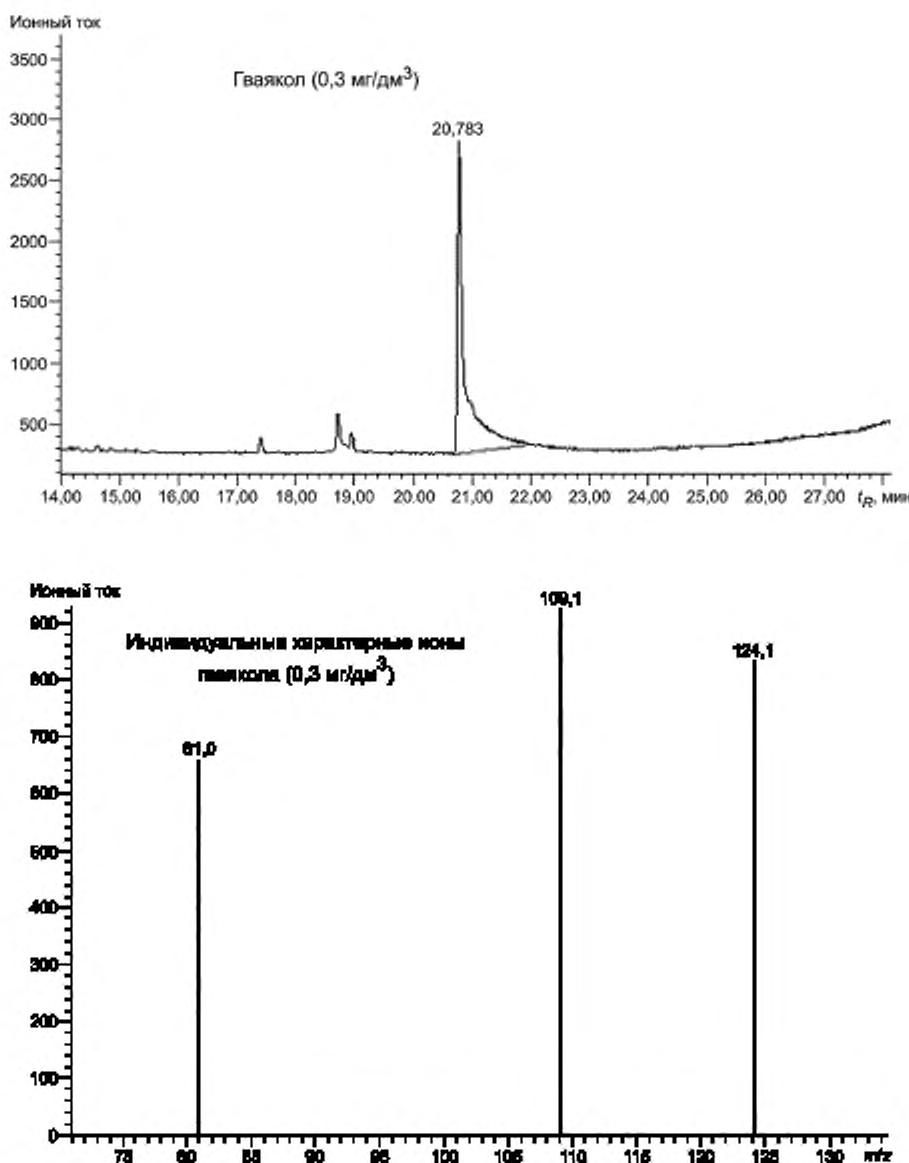


Рисунок А.2 — Хроматограмма и масс-спектр пробы яблочного сока, содержащего 0,3 мкг/дм³ гвайкола

Приложение Б
(рекомендуемое)

Контроль качества результатов измерений

Б.1 Проверка правильности измерения

Проверку правильности измерения выполняют для контроля возможных потерь гвайакола при пробоподготовке и получения ошибочного результата измерений. Проверку правильности измерения проводят с использованием внутреннего стандарта. В качестве внутреннего стандарта используют пропилбензол.

В одну из проб добавляют пропилбензол в таком количестве, чтобы его концентрация в пробе составляла 10 мг/дм³. Далее проводят все операции, описанные в 9.4.1. Параллельно готовят стандартный раствор пропилбензола с концентрацией 10 мг/дм³. Для этого 1,0 мг пропилбензола помещают в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят до метки этилацетатом и перемешивают.

Проводят хроматографические измерения в соответствии с 9.4.2 в условиях, указанных в 7.1, сравнивают концентрацию стандартного раствора пропилбензола и концентрацию пропилбензола в пробе после проведения пробоподготовки. В случае если относительная погрешность между значениями концентраций не превышает 10 %, делают вывод о правильности измерения.

Проверку правильности выполняют в случае получения сомнительного результата, например, несовпадение данных двух параллельных определений, получение отклика на уровне шумов и др.

Б.2 Контроль чувствительности измерения

Проверку чувствительности прибора в случае подозрительных результатов измерений или при резком уменьшении регистрируемых сигналов проводят по рабочему раствору гвайакола с массовой концентрацией 1 мкг/дм³ (см. 9.3) в условиях, указанных в 7.1.

Отношение сигнал/шум должно быть не менее 10:1.

При более низких отношениях или при обоснованных сомнениях в достоверности результатов чувствительность прибора настраивают в соответствии с рекомендациями производителя оборудования или изложенными в инструкции по эксплуатации.

Библиография

- [1] Справочная библиотека масс-спектров NIST MS 05 Национального Института Стандартов и Технологий (NIST), США (The National Institute of Standards and Technology)

УДК 664.863.001.4:006.354

МКС 67.050
67.080

Ключевые слова: продукция соковая, гвяжол, хромато-масс-спектрометр, идентификация, массовая концентрация

Редактор *Ю.А. Расторгуева*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *О.В. Лазарева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 25.11.2019. Подписано в печать 09.12.2019. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,20.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru