

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
НПО ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
[НПО «ВНИИОФИ»]

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений.

Государственная поверочная схема для средств измерений
спектральной чувствительности приемников излучения
в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм

МИ 1615—87

Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1987

**РАЗРАБОТАНЫ НПО «ВНИИОФИ» Государственного комитета
СССР по стандартам**

ИСПОЛНИТЕЛИ

**В. И. Саприцкий, канд. физ.-мат. наук (руководитель темы); М. И. Духани-
на, канд. физ.-мат. наук; В. В. Мальцев; О. А. Минаева; Л. Н. Самойлов,
д-р техн. наук; В. И. Сачков, канд. техн. наук; Г. С. Солодкова**

**ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследо-
вательским институтом метрологической службы Государственно-
го комитета СССР по стандартам**

**Ведущий инженер В. В. Василенко
Ст. эксперт В. А. Гинько**

УТВЕРЖДЕНЫ НПО «ВНИИОФИ» 21 ноября 1986 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений
спектральной чувствительности приемников излучения в
диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм**

МИ 1615—87

Дата введения 01.01.88

Настоящие методические указания распространяются на государственную поверочную схему для средств измерений спектральной чувствительности приемников излучения в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм и устанавливают назначение установки высшей точности для воспроизведения единицы относительной спектральной чувствительности — относительной величины в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм, комплекс основных средств измерений, входящих в ее состав, основные метрологические характеристики установки высшей точности и порядок передачи размера единицы относительной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм и единицы абсолютной спектральной чувствительности — ампер на ватт (А/Вт) в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм от установки высшей точности при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроизведения и хранения единицы относительной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм и передачи размера данной единицы и единицы абсолютной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм от установки высшей точности при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. Установка высшей точности состоит из комплекса следующих средств измерений:

осветитель, состоящий из ленточной лампы типа СИ 10—300 У; газоразрядная дейтериевая лампа типа ДДС-400 и ртутной лампы высокого давления типа ДРШ-500 с блоком питания типа СПС-250-500;

© Издательство стандартов, 1987

двойной монохроматор с комплексом измерительной и вспомогательной аппаратуры;

образцовый приемник излучения типа ПП-1;

приемник излучения РТН-28С;

вычислительный управляющий комплекс.

1.3. Диапазон значений относительной спектральной чувствительности приемников излучения, воспроизведенных установкой высшей точности, составляет $0,2 \div 1,0$ в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм.

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение единицы относительной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм со средним квадратическим отклонением результата измерений $S_{0_{\text{отн}}}$, составляющим от $0,2 \cdot 10^{-2}$ до $0,5 \cdot 10^{-2}$ при 10 независимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность $\theta_{0_{\text{отн}}}$ составляет от $0,4 \cdot 10^{-2}$ до $0,7 \cdot 10^{-2}$.

Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение единицы абсолютной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм со средним квадратическим отклонением результата измерений $S_{0_{\text{абс}}}$, составляющим от $0,4 \cdot 10^{-2}$ до $0,7 \cdot 10^{-2}$, при 20 независимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность $\theta_{0_{\text{абс}}}$ составляет от $1,0 \cdot 10^{-2}$ до $1,5 \cdot 10^{-2}$.

1.5. Для обеспечения воспроизведения единицы относительной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения установки высшей точности, утвержденные в установленном порядке.

1.6. Установку высшей точности применяют для передачи размера единиц относительной и абсолютной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм образцовым средствам измерений сличием при помощи компаратора (двойного монохроматора).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют приемники оптического излучения типов ПП, РТН-28С и ФД-24К в диапазоне значений относительной спектральной чувствительности $0,2 \div 1,0$ в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм с образцовой измерительной установкой, построенной по типу КСВУ.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей образцовых средств измерений относительной спектральной чувствительности приемников излучения $\Delta_{0_{\text{отн}}}$ составляют от $3 \cdot 10^{-2}$ до $5 \cdot 10^{-2}$.

Пределы допускаемых относительных погрешностей образцовых средств измерений абсолютной спектральной чувствительности приемников излучения $\Delta_{0_{\text{абс}}}$ составляют от $4 \cdot 10^{-2}$ до $6 \cdot 10^{-2}$.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки рабочих средств измерений сличением при помощи компаратора (спектральной установки типа КСВУ).


3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют приемники оптического излучения в диапазоне значений относительной спектральной чувствительности $0,1 \div 1,0$ в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей $\Delta_{0_{отн}}$ рабочих средств измерений относительной спектральной чувствительности приемников излучения составляют от $4 \cdot 10^{-2}$ до $8 \cdot 10^{-2}$.

Пределы допускаемых относительных погрешностей $\Delta_{0_{абс}}$ рабочих средств измерений абсолютной спектральной чувствительности приемников излучения составляют от $5 \cdot 10^{-2}$ до $10 \cdot 10^{-2}$.

Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной чувствительности приемников излучения в диапазоне длин волн $0,22 \div 2,5$ мкм

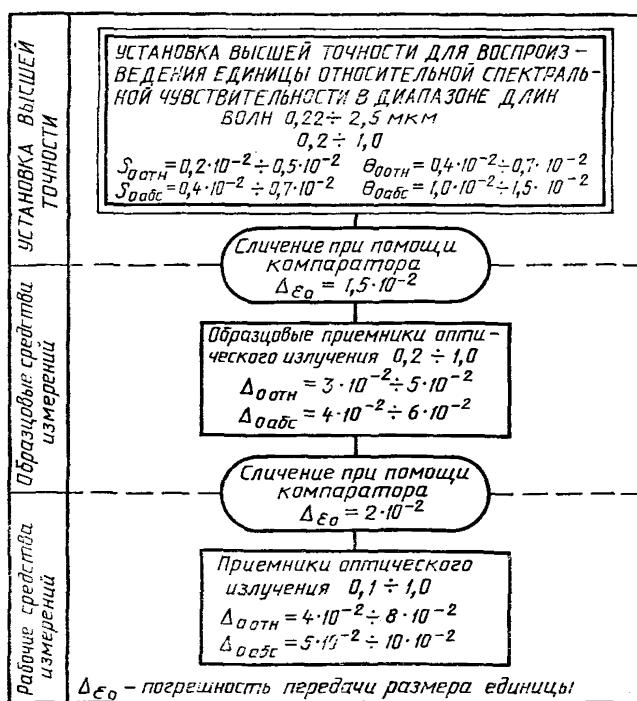

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений.

**Государственная поверочная схема для средств измерений
спектральной чувствительности приемников излучения
в диапазоне длин волн 0,22—2,5 мкм**

МИ 1615—87

Редактор *М. В. Глушкова*

Технический редактор *В. Н. Прусакова*

Корректор *Т. И. Кононенко*

Сдано в набор 30.04.87 Подп. к печ. 16.07.87 Формат 60×90¹⁶ Бумага типографская № 1
Гарнитура литературная Печать высокая 0,375 усл. п. л. 0,375 усл. кр.-отт.
0,22 уч.-изд. л. Тир. 2000 Зак. 717 Изд. № 9556/4 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялян пер., 6.