

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

КАЛИБРЫ

Ч а с т ь 1

Издание официальное

М о с к в а
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
2 0 0 3

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Калибры» часть 1 содержит стандарты, утвержденные до 1 мая 2003 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАЛИБРЫ-СКОБЫ ГЛАДКИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

Технические условия

ГОСТ
2216—84

Adjustable plain snap gauges. Specifications

МКС 17.040.30
ОКП 39 3100Дата введения 01.01.85

Настоящий стандарт распространяется на гладкие двухпределные калибры-скобы с односторонней регулировкой, предназначенные для контроля валов диаметром до 340 мм с допусками по ЕСДП и системе ОСТ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Калибры-скобы должны изготавляться двух исполнений.

1 — с двумя подвижными вставками со сферической рабочей поверхностью и двумя неподвижными пятками с плоской рабочей поверхностью (чертеж);

2 — с двумя подвижными вставками и одной неподвижной губкой с плоскими рабочими поверхностями (чертеж).

1.2. Основные параметры и размеры калибров-скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

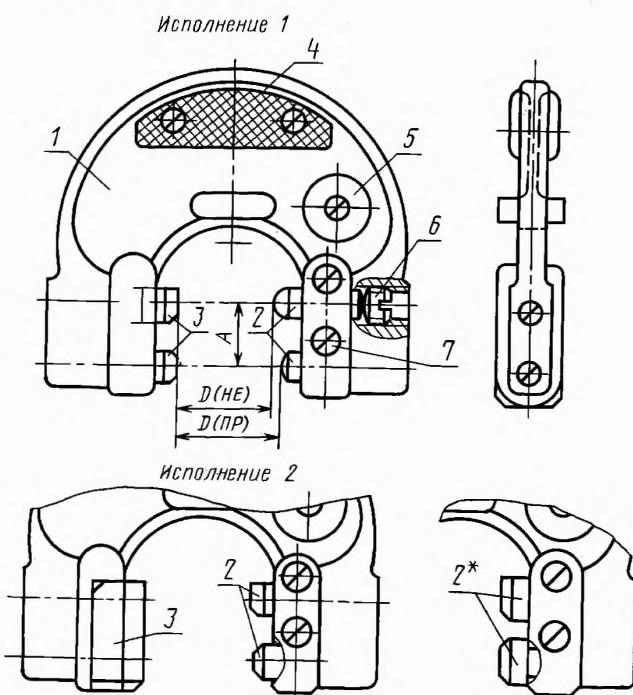

* Вставки с головкой изготавливают по требованию потребителя калибров-скоб.

1 — корпус, 2 — подвижная вставка, 3 — неподвижная пятка (для исполнения 2 — губка), 4 — теплоизоляционная накладка, 5 — маркировочная шайба, 6 — регулировочный винт, 7 — узел зажима вставки

C. 2 ГОСТ 2216—84

Размеры, мм

Таблица 1

Обозначение калибров-скоб	Применяемость	Диапазон контролируемых размеров	Номер корпуса калибров-скоб	Контролируемое изделие		Межосевое расстояние <i>A</i>	Посадочный диаметр вставок <i>d</i> , не менее
				Квалитет	Класс точности		
8118-0001*		До 5 Св. 5 до 10	1				
8118-0002*							
8118-0003		Св. 10 до 15	2			16	
8118-0004		» 15 » 20					
8118-0005		Св. 20 до 28	3				8
8118-0006		» 28 » 35					
8118-0007		Св. 35 до 43	4				
8118-0008		» 43 » 50					
8118-0009		Св. 50 до 58	5			20	
8118-0010		» 58 » 65					
8118-0011		Св. 65 до 73	6				
8118-0012		» 73 » 80					
8118-0013		Св. 80 до 90	7				10
8118-0014		» 90 » 100					
8118-0015		Св. 100 до 110	8				
8118-0016		» 110 » 120					
8118-0017		Св. 120 до 130	9			25	
8118-0018		» 130 » 140					
8118-0019		Св. 140 до 150	10				10
8118-0020		» 150 » 160					
8118-0021		Св. 160 до 170	11				
8118-0022		» 170 » 180					
8118-0023		Св. 180 до 190	12				
8118-0024		» 190 » 200					
8118-0025		Св. 200 до 210	13				
8118-0026		» 210 » 220					
8118-0027		Св. 220 до 235	14				
8118-0028		» 235 » 250					
8118-0029		Св. 250 до 265	15				
8118-0030		» 265 » 280					
8118-0031		Св. 280 до 295	16				
8118-0032		» 295 » 310					
8118-0033		Св. 310 до 325	17				
8118-0034		» 325 » 340					

* Калибры-скобы 8118-0001 и 8118-0002 изготавляются только исполнения 1.

Пример условного обозначения калибра-скобы с диапазоном контролируемых размеров от 120 до 130 мм, исполнения 1:

Калибр-скоба 8118-0017—1 ГОСТ 2216—84

То же, исполнения 2:

Калибр-скоба 8118-0017—2 ГОСТ 2216—84

1.1; 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Калибры-скобы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежкам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкция калибров-скоб должна обеспечивать возможность установки на любой размер заданного диапазона с перекрытием нижнего предела на 1 мм.

2.3. Корпус калибра-скобы должен обеспечивать возможность его использования для двух диапазонов контролируемых размеров в соответствии с табл. 1.

2.4. Корпуса калибров-скоб должны изготавляться из чугуна или стали, иметь антакоррозионное покрытие, а также теплоизоляционные накладки.

2.5. Корпуса калибров-скоб для размеров более 100 мм должны иметь облегчающие отверстия.

2.6. Корпус калибра-скобы должен быть подвергнут старению, кроме корпусов, изготавляемых из чугуна марки КЧ 30—6 по ГОСТ 1215 или из стали марки 45Л по ГОСТ 977.

2.7. Конструкция калибра-скобы должна обеспечивать продольное перемещение вставок без их вращения при установке на размер.

2.8. Узлы зажима вставок должны надежно закреплять вставки и предохранять их от смещений.

2.9. Конструкция калибра-скобы должна обеспечивать возможность опломбирования регулировочного винта.

2.10. Сопряжение «отверстие корпуса — вставка» должно быть выполнено для калибров-скоб исполнения 1 с посадкой $\frac{H8}{J_s 6}$, для калибров-скоб исполнения 2 — с посадкой $\frac{H7}{J_s 5}$.

2.11. Рабочие поверхности вставок, пяток и губок должны быть изготовлены из твердого сплава марок ВК8, ВК6 или ВК6М, ВК8В по ГОСТ 3882.

По требованию потребителя допускается изготовление вставок, пяток и губок из стали марок У8А, У10А или У12А по ГОСТ 1435.

2.12. Твердость стальных рабочих поверхностей должна быть в пределах 58 . . . 64,1 HRC.

2.10; 2.11. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.13. На рабочих поверхностях, на поверхностях заходных и выходных фасок, а также на остальных поверхностях, калибров-скоб не должно быть дефектов, ухудшающих внешний вид или влияющих на эксплуатационные качества калибров-скоб.

2.14. Предельные отклонения рабочих поверхностей калибра-скобы исполнения 2 от параллельности при установке в диапазоне измерений калибра-скобы должны быть не более величин, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Диапазоны контролируемых размеров, мм	0—10	10—20	20—35	35—50	50—80	80—120	120—180	180—250	250—340
Предельные отклонения, мкм	4	5	6	7	8	9	11	13	15

2.15. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.

Допускается назначать неуказанные симметричные предельные отклонения по квалитету $\pm \frac{IT14}{2}$.

2.14; 2.15. (Измененная редакция, Изм. № 1).

С. 4 ГОСТ 2216—84

2.16. Параметр шероховатости R_a по ГОСТ 2789 рабочих поверхностей вставок должен быть не более 0,080 мкм для размеров до 100 мм и не более 0,16 мкм — для размеров более 100 мм.

2.17. Плоские рабочие поверхности должны иметь заходные и выходные фаски у проходной и непроходной сторон. Острые кромки должны быть притуплены.

2.18. По требованию потребителя калибры-скобы могут изготавляться установленными на определенный размер.

2.19. Исполнительные размеры калибров-скоб определяют по ГОСТ 21401 или ГОСТ 24853 при контроле изделий с допусками по ЕСДП и по ОСТ 1205, ОСТ 1219, ОСТ 1220, ОСТ НКМ 1221, в зависимости от классов точности, при контроле изделий с допусками по системе ОСТ.

2.20. Каждый калибр-скоба должен быть снабжен маркировочной алюминиевой шайбой, пред назначенной для маркировки на ней размеров калибра-скобы.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. На каждом калибре-скобе должно быть нанесено:

диапазон контролируемых размеров;
обозначение и исполнение калибра-скобы;
обозначение настоящего стандарта;
товарный знак предприятия-изготовителя.

3.2. Перед упаковкой калибры-скобы должны пройти консервацию по ГОСТ 9.014. Срок действия консервации — 2 года.

3.1; 3.2. (**Измененная редакция, Изм. № 1**).

3.3. Калибры-скобы должны быть завернуты в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569 и уложены в коробки, изготовленные по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.4. На каждой коробке должна быть этикетка или штамп с указанием:

наименования изделия,
обозначения и исполнения калибров-скоб,
количества изделий в коробке,
даты выпуска,
товарного знака предприятия-изготовителя,
обозначения настоящего стандарта.

3.5. Каждая партия калибров-скоб должна сопровождаться документом, удостоверяющим их соответствие требованиям настоящего стандарта.

3.6. Для транспортирования коробки с калибрами-скобами должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 2991, выложенные внутри водонепроницаемым материалом.

3.7. Калибры-скобы в упаковке по п. 3.6 транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах либо в контейнерах в соответствии с правилами, действующими на транспорте конкретных видов.

Ящики с калибрами-скобами должны быть установлены так, чтобы исключить возможность их перемещения при транспортировании.

(**Измененная редакция, Изм. № 1**).

3.8. Упакованные калибры-скобы должны храниться в вентилируемом помещении при температуре от 10 до 35 °С. В воздухе не должно быть присутствия паров кислот и щелочей. Относительная влажность воздуха — не более 80 %.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие калибров-скоб требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования, установленных в настоящем стандарте.

4.2. Гарантийный срок хранения — 12 мес с момента изготовления.

4.1; 4.2. (**Измененная редакция, Изм. № 1**).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.03.84 № 980**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 2216—68**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.014—78	3.2	ГОСТ 9569—79	3.3
ГОСТ 977—88	2.6	ГОСТ 21401—75	2.19
ГОСТ 1215—79	2.6	ГОСТ 24853—81	2.19
ГОСТ 1435—99	2.11	OCT 1205	2.19
ГОСТ 2789—73	2.16	OCT 1219	2.19
ГОСТ 2991—85	3.6	OCT 1220	2.19
ГОСТ 3882—74	2.11	OCT НКМ 1221	2.19

- 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)**
- 6. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1988 г. (ИУС 12—88)**

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 27284—87	Калибры. Термины и определения	3
ГОСТ 2015—84	Калибры гладкие нерегулируемые. Технические требования	7
ГОСТ 24851—81	Калибры гладкие для цилиндрических отверстий и валов. Виды	11
ГОСТ 24852—81	Калибры гладкие для размеров выше 500 до 3150 мм. Допуски	17
ГОСТ 24853—81	Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски	21
ГОСТ 2216—84	Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия	29
ГОСТ 5939—51	Калибры предельные гладкие для отверстий менее 1 мм. Допуски	34
ГОСТ 6485—69	Калибры для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60°. Типы. Основные размеры и допуски	36
ГОСТ 13810—68	Калибры гладкие для размеров выше 500 мм. Допуски	45
OCT 1202	Калибры рабочие для валов и отверстий 1-го класса точности. Допуски	54
OCT 1203	Калибры рабочие для валов 2 и 2a классов точности. Допуски	57
OCT 1204	Калибры рабочие для отверстий 2-го класса точности. Допуски	60
OCT 1205	Калибры рабочие для отверстий 2a класса точности и для валов отверстий 3-го и За классов точности. Допуски	63
OCT 1220	Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 4-го класса точности. Допуски	66
OCT 1219	Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 5-го класса точности. Допуски	72
OCT 1207	Калибры приемные для валов и отверстий 1-го класса точности. Допуски	77
OCT 1208	Калибры приемные для валов 2-го и 2a классов точности и для отверстий 2-го класса точности. Допуски	80
OCT 1209	Калибры приемные для отверстий 2a класса точности и для валов и отверстий 3-го и За классов точности. Допуски	83
OCT 1213	Калибры контрольные к рабочим калибрам для валов 2-го и 2a классов точности. Допуски	86
OCT 1214	Калибры контрольные К—И к рабочим калибрам для отверстий 2-го класса точности. Допуски на неточность изготовления	88
OCT 1215	Калибры контрольные к рабочим калибрам для валов 3-го и За классов точности. Допуски	89
OCT 1216	Калибры контрольные К—И к рабочим калибрам для отверстий 3-го класса точности. Допуски на неточность изготовления	91
ГОСТ 2534—77	Калибры предельные для глубин и высот уступов. Допуски	92
ГОСТ 24932—81	Калибры для конических соединений. Допуски	105
ГОСТ 2849—94	Калибры для конусов инструментов. Технические условия	116
ГОСТ 20305—94	Калибры для конусов конусностью 7:24. Технические условия	127
ГОСТ 24959—81	Калибры для шлицевых соединений. Технические условия	136
ГОСТ 24960—81	Калибры комплексные для контроля шлицевых прямобочных соединений. Виды, основные размеры	138
ГОСТ 7951—80	Калибры для контроля шлицевых прямобочных соединений. Допуски	164
ГОСТ 24969—81	Калибры для контроля шлицевых эвольвентных соединений с углом профиля 30°. Допуски	176
ГОСТ 6528—53	Калибры для шлицевых валов и отверстий с эвольвентным профилем. Допуски	188
ГОСТ 24109—80	Калибры для шпоночных соединений. Допуски	199
ГОСТ 16085—80	Калибры для контроля расположения поверхностей. Допуски	212
ГОСТ 15876—90	Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. Технические условия	232
ГОСТ 14025—84	Калибры предельные для изделий из древесины и древесных материалов. Допуски	235

КАЛИБРЫ

Ч а с т ь 1

БЗ 9—2002

Редактор *P. Говердовская*
Технический редактор *H. С. Гришанова*
Корректор *H. И. Гаврищук*
Компьютерная верстка *T. В. Александровой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 27.02.2003. Подписано в печать 28.05.2003. Формат 60Ч84^{1/8}. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,83. Уч.-изд. л. 25,10. Тираж 850 экз. Зак. 690.
Изд. № 3024/2. С 10700.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138