

**ГОСТ 12170—85**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**

---

## **ОГНЕУПОРЫ**

**СТАЦИОНАРНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ**

**Издание официальное**

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****ОГНЕУПОРЫ****ГОСТ  
12170—85****Стационарный метод измерения теплопроводности**

Взамен

**ГОСТ 12170—76**

Refractories.

Stationary method of thermal conductivity determination

МКС 81.080  
ОКСТУ 1509

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 апреля 1985 г. № 1128 дата введения установлена**

**01.01.86**

**Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)**

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения теплопроводности огнеупоров с теплопроводностью от 0,13 до 15 Вт/(м·К) при стационарном одномерном температурном поле в плоском образце и при температуре на горячей стороне образца от 400 до 1350 °C.

Стандарт не распространяется на волокнистые и сыпучие огнеупоры.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4552—84.

**1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ**

1.1. Метод отбора образцов, подлежащих измерению, их количество, а также температура измерения устанавливаются по нормативно-технической документации на конкретный материал. Если в ней не установлено количество образцов, теплопроводность определяют на одном образце.

1.2. Образец должен иметь форму прямоугольного параллелепипеда с размерами 114 × 114 × (65—32) мм. Огнеупоры с теплопроводностью 0,13—0,18 Вт/(м·К) испытывают на образцах толщиной 32 мм. Отклонения по размерам образца допускаются ±2 мм.

Допускается применение образцов больших размеров, если это не приводит к увеличению погрешности определения теплопроводности.


**2. АППАРАТУРА**

Установка для измерения теплопроводности (см. чертеж):

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена***Переиздание. Февраль 2003 г.*

© Издательство стандартов, 1985  
 © ИПК Издательство стандартов, 2003

С. 2 ГОСТ 12170—85

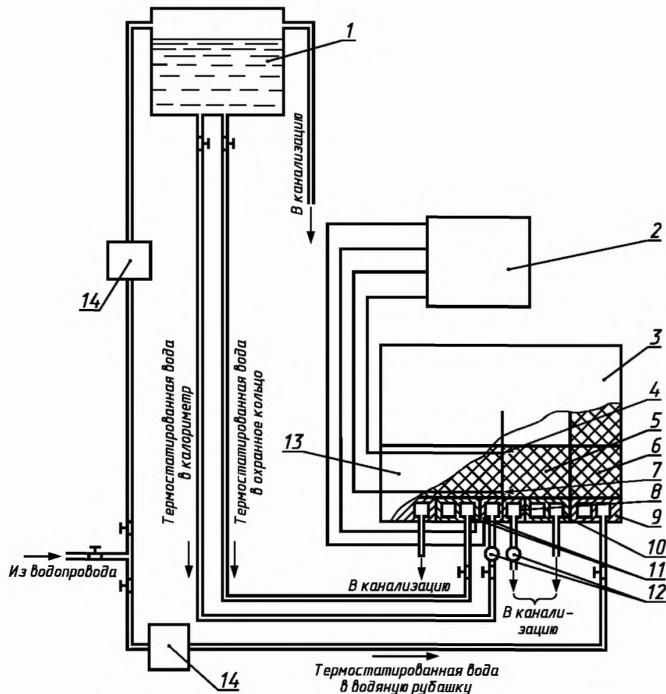

1 — водонапорный бак; 2 — прибор для измерения термоэдс; 3 — верхняя часть печи; 4 — термоэлектрический преобразователь платинородий-платиновый; 5 — образец; 6 — теплоизоляция боковой поверхности образца; 7 — термопреобразователь хромель-алиумелевый; 8 — калориметр; 9 — водяная рубашка; 10 — охранное кольцо; 11 — термопреобразователи хромель-копелевые; 12 — термометры для измерения повышения температуры воды в калориметре; 13 — нижняя часть печи; 14 — регулирующее устройство для поддержания заданной температуры воды

2.1. Электропечь, обеспечивающая односторонний нагрев испытуемого образца (его горячей поверхности) до заданной температуры в воздушной среде. Печь состоит из двух частей — верхней и нижней. В верхней части расположено не менее трех карбидокремниевых нагревателей. Допускается применение других видов нагревателей, обеспечивающих заданную температуру нагрева образца. В нижней части печи в одной горизонтальной плоскости расположены калориметр с охранным кольцом и водяная рубашка. Площадь поверхности калориметра, контактирующей с образцом, должна составлять 10—30 % площади образца.

2.2. Трансформатор по ГОСТ 9680—77. Допускается применение системы автоматического регулирования нагрева образца и других источников автоматического регулирования нагрева образца.

2.3. Водонапорный бак вместимостью не менее 100 дм<sup>3</sup> с постоянным уровнем воды, установленный на высоте не менее 2,5 м от плоскости калориметра. Допускается другая высота установки бака, если обеспечивается указанный в п. 4.2 расход воды.

2.4. Термостат жидкостный лабораторный. Допускается применять регулирующее устройство, обеспечивающее поддержание заданной температуры воды с погрешностью не более 0,5 °C и нестабильностью во время измерения не более 0,1 °C.

2.5. Прибор для измерения термоэдс от 0 до 50 мВ с пределом допускаемой погрешности ±0,025 мВ.

2.6. Коммутирующее устройство, позволяющее подключить к измерительному прибору не менее четырех термоэлектрических преобразователей (термопреобразователей).

2.7. Термопреобразователь платинородий-платиновый, изготовленный из платиновой проволоки марки ПлТ и проволоки платинородиевого сплава марки ПР-10 диаметром 0,5 мм по ГОСТ 10821—75.

2.8. Термопреобразователь хромель-алиумелевый, изготовленный из проволоки диаметром 0,5 мм сплавов хромель Т и алюмел по ГОСТ 1790—77.

2.9. Два термопреобразователя хромель-копелевых (или хромель-алиумелевых), изготовленных из проволоки диаметром не более 0,5 мм сплавов хромель Т и копель (или алюмел) по ГОСТ 1790—77.

Допускается дифференциальное соединение термопреобразователей.

2.10. Три ртутных термометра с ценой деления шкалы не более 0,1 °С, обеспечивающие измерение температуры в интервале от 0 до 50 °С по ГОСТ 28498—90.

2.11. Два метастатических ртутных термометра с ценой деления основной шкалы не более 0,01 °С, обеспечивающие измерение разности температур от 0 до 3 °С.

Допускается применять термобатареи или другие датчики, обеспечивающие измерение разности температур с пределом допустимой погрешности ±0,015 °С.

2.12. Три термометра с ценой деления шкалы не более 0,5 °С, обеспечивающие измерение температуры в интервале от 0 до 50 °С, по ГОСТ 28498—90.

2.13. Устройство для измерения расхода воды с пределом допускаемой погрешности ±2,5 %, например, цилиндр мерный вместимостью от 200 до 250 см<sup>3</sup> с ценой деления шкалы не более 5 см<sup>3</sup> по ГОСТ 1770—74 и секундомер с ценой деления шкалы не более 0,2 с.

2.14. Штангенциркуль с ценой деления шкалы не более 0,1 мм, обеспечивающий измерение размеров от 0 до 125 мм, по ГОСТ 166—89.

2.15. Весы технические с пределом допускаемой погрешности ±0,5 г.

2.16. Допускается применять другую аппаратуру, удовлетворяющую требованиям пп. 2.2—2.14.

### 3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

3.1. Нижнюю поверхность образца подшлифовывают.

3.2. По середине больших граней образца пропиливают канавки глубиной и шириной от 1,5 до 2,5 мм.

При испытании электропроводных огнеупоров (карбидокремниевых, углеродистых и др.) канавка выполняется ступенчатой. Вышеуказанный размер канавки выдерживают только в центре образца на длине от 20 до 30 мм, а на остальной длине допускается его увеличение в соответствии с диаметром электроизоляции термоэлектродов, однако не более 4 × 4 мм.

3.3. Образец высушивают при температуре от 105 до 120 °С до постоянной массы. Масса считается постоянной, если результат последующего взвешивания, проведенного после 1 ч сушки, отличается от предыдущего не более чем на 0,1 %.

3.4. Измеряют штангенциркулем толщину образца между основаниями канавок и диаметры спаев термопреобразователей.

Спаи термопреобразователей располагают в середине верхней и нижней канавок, плотно прижимают к образцу и закрепляют при помощи замазки из измельченного огнеупора того же состава (фракции не более 0,2 мм) с добавлением связующего вещества, не вступающего в химическое взаимодействие с термопреобразователями и образцом (например, увлажненной огнеупорной пластичной глины).

На верхней (горячей) поверхности образца устанавливают платинородий-платиновый термопреобразователь, на нижней (холодной) — хромель-алюмелевый.

При температуре нагрева верхней поверхности образца не более 900 °С допускается применять хромель-алюмелевые термопреобразователи на обоих сторонах образца. При разовом применении допускается использовать хромель-алюмелевые термопреобразователи до 1100 °С.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Образец устанавливают на калориметр с охранным кольцом.

При испытании плотных огнеупоров рекомендуется образец устанавливать на тонкий слой огнеупорной засыпки (например, шамотной, корундовой, магнезитовой и др.) толщиной не более 2 мм (фракции не более 0,2 мм) или на четыре пластинки одинаковой толщины из плотного огнеупора или асбоцемента, расположенные по углам образца. Толщина пластинок не должна превышать 1 мм, расхождение толщин допускается не более 0,15 мм.

Боковую поверхность образца теплоизолируют огнеупором с теплопроводностью, не превышающей теплопроводность испытуемого образца, но не более 0,25 Вт/(м·К) при минимальной температуре измерения и 0,5 Вт/(м·К) при максимальной температуре измерения. Верхнюю часть печи устанавливают над образцом и опускают до соприкосновения с теплоизоляцией боковой поверхности образца.

4.2. Подают воду в калориметр, охранное кольцо и водянную рубашку.

Устанавливают постоянный расход воды, протекающей через калориметр, и измеряют его.

## C. 4 ГОСТ 12170—85

Расход воды при испытании теплоизоляционных огнеупоров рекомендуется поддерживать в пределах от 6 до 12 дм<sup>3</sup>/ч, при испытании плотных огнеупоров — от 10 до 18 дм<sup>3</sup>/ч.

Расход воды, проходящей через охранное кольцо и водяную рубашку, должен быть в 5—7 раз больше, чем через калориметр.

4.3. Включают печь и производят ее плавный разогрев со скоростью не более 500 °C/ч.

Наблюдение за разогревом печи ведут по термопреобразователю, помещенному на горячей стороне образца.

4.4. Регулируют температуру воды в калориметре, охранном кольце и водяной рубашке при помощи регулирующего устройства, а также путем изменения расхода воды, проходящей через охранное кольцо и водяную рубашку.

Средняя температура воды в калориметре не должна отличаться от температуры в воздушном пространстве непосредственно под нижней частью печи более, чем на 1 °C — для теплоизоляционных и на 3 °C — для плотных огнеупоров. Контроль температуры воды производят в соответствии с п. 4.6. Температуру воздушного пространства измеряют термометром с ценой деления шкалы не более 0,5 °C.

Температура охранного кольца не должна отличаться от температуры калориметра более, чем на 1 °C — для теплоизоляционных и на 3 °C — для плотных огнеупоров. Контроль осуществляют с помощью хромель-копелевых термопреобразователей, припаянных к калориметру и охранному кольцу, и прибора для измерения термоэдс, температуру холодных спаев термопреобразователей определяют по термометру с ценой деления шкалы не более 0,5 °C.

Температура воды в водяной рубашке не должна отличаться от температуры помещения более, чем на 4 °C. Контроль осуществляют термометром с ценой деления шкалы не более 0,5 °C.

4.5. После достижения на горячей стороне образца заданной температуры испытания с отклонением не более ±20 °C ее поддерживают на достигнутом уровне до окончания испытания с нестабильностью не более ±3 °C.

4.6. После достижения стационарного распределения температуры по образцу (распределение считается стационарным, если в течение 1 ч нестабильность температуры горячей и холодной сторон образца не превышает ±3 °C) через каждые 10—15 мин в течение 1 ч производят следующие замеры:

измеряют температуры на верхней и нижней сторонах образца с помощью термопреобразователей и прибора для измерения термоэдс, температуру холодных спаев термопреобразователей определяют по термометру с ценой деления шкалы не более 0,5 °C;

измеряют повышение температуры воды в калориметре: при повышении температуры воды более, чем на 1,5 °C — для огнеупоров с теплопроводностью не более 1,5 Вт/(м·К) — используют термометры с ценой деления шкалы не более 0,1 °C, при повышении температуры воды на 1,5 °C и меньше — используют метастатические термометры с ценой деления шкалы не более 0,01 °C, при этом температуру на входе в калориметр измеряют термометром с ценой деления шкалы не более 0,1 °C, установленным последовательно с метастатическим термометром;

измеряют расход воды, протекающей через калориметр.

4.7. Измерения считаются законченными, если четыре последовательных измерения теплового потока с разбросом от среднего его значения — не более 4 %. В случае невыполнения данного условия измерения следует повторить.

4.8. При измерении разности температур (пп. 4.4 и 4.6) систематическую погрешность исключают совместной градуировкой термометров (или термопреобразователей).

4.9. Запись результатов измерений производят по форме, приведенной в приложении.

4.10. Огнеупоры, претерпевающие в процессе измерения структурные и физико-химические превращения, приводящие к нарушению температурного поля в образце, например, безобжиговые, надлежит испытывать после термической обработки, режим которой должен соответствовать установленному в нормативно-технической документации на конкретные огнеупоры.

## 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Теплопроводность ( $\lambda$ ) в Вт/(м·К) вычисляют для каждого измерения по формуле

$$\lambda = \frac{Q \delta}{S(t_{\text{top}} - t_{\text{хол}})} ; \quad Q = c \cdot v \cdot \Delta t,$$

где  $Q$  — тепловой поток, проходящий через образец, Вт;

$c$  — удельная теплоемкость воды, равная  $4,19 \cdot 10^3$  Дж/(кг·К);

$v$  — массовый расход воды, проходящей через калориметр, кг/с;

$\Delta t$  — повышение температуры воды в калориметре, К, вычисляемое по формуле  $\Delta t = t_{\text{вых}} - t_{\text{вх}}$ ,

где  $t_{\text{вх}}$ ,  $t_{\text{вых}}$  — температура воды на входе и выходе из калориметра, °C;

$\delta$  — расстояние между центрами спаев термопреобразователей в образце, м;

$S$  — площадь калориметра, м<sup>2</sup>;

$t_{\text{гор}}$ ,  $t_{\text{хол}}$  — температуры на горячей и холодной сторонах образца, °C.

5.2. За результат измерения теплопроводности принимают среднее арифметическое результатов последних четырех измерений, округленное до трех значащих цифр.

5.3. Вычисленное значение теплопроводности относят к средней температуре образца  $t_{\text{ср}} = \frac{t_{\text{гор}} + t_{\text{хол}}}{2}$  и обозначают  $\lambda_{t_{\text{ср}}}$ . Например,  $\lambda_{457}$ .

5.4. Относительная погрешность измерения теплопроводности по данной методике не превышает:

для огнеупоров с  $\lambda$  более 0,4 Вт/(м·К) — 10 %,

для огнеупоров с  $\lambda$  от 0,18 до 0,4 Вт/(м·К) — 10 % при измерении образцов толщиной 32 мм и 15 % при измерении образцов толщиной 65 мм,

для огнеупоров с  $\lambda$  менее 0,18 Вт/(м·К) — 15 %.

5.5. Результат измерения заносят в протокол, в котором указывают:

обозначение настоящего стандарта;

номер партии и номер образца;

наименование огнеупора, марку, типоразмер;

результат измерения: температуры на горячей, холодной сторонах образца, среднюю температуру измерения и теплопроводность;

место, дату измерения и подпись исполнителя.

**ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ**

Дата измерения	Номер партии	Наимено-вание огнеупора, марка, типоразмер, обозначение стандарта	Номер образца	Площадь калориметра, м <sup>2</sup> ; расстояние между центрами спаев термопар $\delta \cdot 10^3$ , м	Номер измерения	Время измерения	Температура холодных спаев термопар, °C	Temperatura образца	
								на горячей стороне	
								Термоэдс, мВ	$t_{\text{гор}}$ , °C

*Продолжение*

Расход воды			Temperatura воды в калориметре		Повышение температуры воды в калориметре, $\Delta t = t_{\text{вых}} - t_{\text{вх}}$ , K	Тепловой поток $Q = c \cdot v \cdot \Delta t$ , Вт	Теплопроводность $\lambda = \frac{Q \delta}{S(t_{\text{гор}} - t_{\text{хол}})}$ , Вт/(м·K)	Средняя температура образца, $t_{\text{ср}} = \frac{t_{\text{гор}} + t_{\text{хол}}}{2}$ , °C
длительность измерения $\tau$ , с	объем по цилиндуру $V \cdot 10^6$ , м <sup>3</sup>	массовый расход $V \cdot 10^3 = \frac{V}{\tau} \cdot 10^6$ , кг/с	на выходе $t_{\text{вых}}$ , °C	на входе $t_{\text{вх}}$ , °C				

Редактор Р.С. Федорова  
 Технический редактор Н.С. Гришанова  
 Корректор М.С. Кабашова  
 Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 28.02.2003. Подписано в печать 20.03.2003. Усл. печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,70.  
 Тираж 68 экз. С 10064. Зак. 249.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
 Плр № 080102