

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Метод измерения коэффициента  
неравномерности яркости экрана

ГОСТ  
21815.16-86

Image intensifier and image converter tubes.  
Method of measuring the output brightness  
non-uniformity ratio

Взамен  
ГОСТ 21815-76  
в части п. 4.17

ОКП 63 4930

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 сентября 1986 г. № 2909 срок действия установлен

с 01.01.88  
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения коэффициента неравномерности яркости экрана электронно-оптических преобразователей (ЭОП), предназначенных для применения в приборах видения.

Общие требования к проведению измерений и требования безопасности по ГОСТ 21815.0-86.


## 1. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Принцип измерения состоит в измерении экстремальных значений яркости участков экрана ЭОП, предварительно оцененных.

## 2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

2.1. Для измерения коэффициента неравномерности яркости экрана ЭОП следует применять измерительные приборы и вспомогательные устройства, входящие в установку, функциональная схема которой должна соответствовать чертежу.

2.2. Размер анализирующей диафрагмы яркомера должен быть указан в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

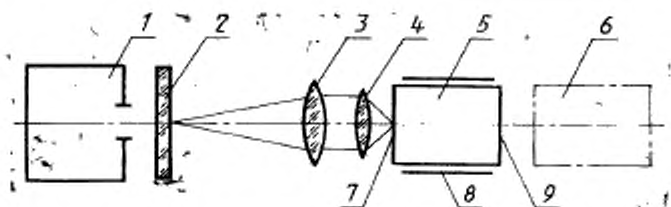

1—осветитель; 2—сетка; 3—коллимационный объектив; 4—проекционный объектив; 5—ЭОП; 6—источник; 7—фотокатод; 8—светонепроницаемая камера; 9—экран

2.3. Осветитель должен обеспечивать равномерную освещенность всего рабочего поля фотокаатода. Неравномерность создания освещенности не должна быть более 5 %.

2.4. Сетка коллимационного объектива, установленная в его фокальной плоскости, должна удовлетворять требованиям ГОСТ 21815.15—86.

2.5. Допускается теневой способ создания изображения сетки на фотокатоде ЭОП с соблюдением условий, вычисляемых по формуле

$$L \geq \frac{(d+a_n)l_k}{d+\delta K_n} \cdot 100, \quad (1)$$

где  $L$  — расстояние между телом накала лампы или апертурной диафрагмой осветителя и сеткой, мм;

$d$  — диаметр окружности сетки, мм;

$a_n$  — максимальный поперечный размер тела накала лампы или апертурной диафрагмы осветителя, мм;

$l_k$  — расстояние между сеткой и плоскостью фотокаатода, мм;

$$l_k = l_1 + \frac{\Delta c}{n_1} \quad (1a)$$

$l_1$  — расстояние между сеткой и стеклом фотокаатода, мм;

$\Delta c$  — толщина стекла фотокаатода, мм;

$n_1$  — показатель преломления стекла фотокаатода;

$\delta K_n$  — составляющая погрешности в определении  $K_n$ , связанная с размытием изображения сетки и параллаксом между плоскостью сетки и плоскостью входа ЭОП, устанавливаются равной 2 %.

### 3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. Испытуемый ЭОП устанавливают в светонепроницаемую камеру и соединяют с источником питания.

3.2. Осветители создают на входе ЭОП освещенность, заданную в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

3.3. На ЭОП подают напряжения, указанные в стандартах или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Фокусируют изображение сетки на фотокатоде ЭОП, наблюдая его через окулярную оптику на экране ЭОП.

4.2. В заданной зоне находят не менее двух участков экрана с экстремальными значениями яркости и проводят относительное измерение яркости этих участков.

#### 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Коэффициент неравномерности яркости экрана вычисляют по формуле

$$K_n = \frac{B_1 - B_2}{B_1 + B_2}, \quad (2)$$

где  $B_1$  и  $B_2$  — яркости участков экрана.

Измерения и вычисления коэффициента неравномерности повторяют не менее трех раз. Результаты усредняют.

5.2. Суммарная относительная погрешность измерения коэффициента неравномерности яркости экрана ( $\varepsilon_{K_n}$ ) при соблюдении требований настоящего стандарта при доверительной вероятности  $P=0,95$  не более 5,0 %.