

**ГОСТ Р 51414—99  
(ИСО 5530-3—88)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

---

**Мука пшеничная**

**ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА**

**Определение водопоглощения и реологических свойств  
с применением валориграфа**

**Издание официальное**

**ГОСТ Р 51414—99**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки» (ГНУ ВНИИЗ)

**ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 2 «Зерно, продукты его переработки и маслосемена»

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 22 декабря 1999 г. № 569-ст

**3** Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст ИСО 5530—3:1988 «Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Часть 3. Определение водопоглощения и реологических свойств с применением валориграфа», кроме разделов 2, 5

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5 ПЕРЕИЗДАНИЕ**

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Мука пшеничная

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА

Определение водопоглощения и реологических свойств с применением валориграфа

Wheat flour. Physical characteristics of doughs.  
Determination of water absorption and rheological properties using a valorigraph

Дата введения 2001—03—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает метод определения водопоглощения муки из зерна мягкой пшеницы (*Triticum aestivum Linnaeus*) и реологических свойств теста, замешиваемого из нее, с применением валориграфа\*.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ИСО 2170—97 Зерновые и бобовые. Отбор проб молотых продуктов

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 29143—91 (ИСО 712—85) Зерно и зерновые продукты. Определение влажности. Рабочий контрольный метод

**3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:  
**консистенция:** Сопротивляемость теста замешиванию в валориграфе при установленной постоянной скорости в единицах валориграфа (ЕВ).

**водопоглощение:** Объем воды, необходимый для получения теста с требуемой консистенцией, равной 500 ЕВ, при соблюдении условий замеса, установленных настоящим стандартом.

Водопоглощение выражают в кубических сантиметрах воды на 100 г муки влажностью 14 % (по массе).

**4 Сущность метода**

Метод состоит в измерении и регистрации консистенции теста в процессе его образования из муки и воды, развития теста и изменения его консистенции во времени в процессе замеса, с применением валориграфа.

П р и м е ч а н и е — Требуемая консистенция 500 ЕВ теста достигается подбором количества добавляемой воды. Установленное таким образом количество добавляемой воды используют для получения полной валориграммы замеса. Различные показатели валориграммы замеса характеризуют реологические свойства (силу) муки.

**5 Реактивы**

Дистиллированная вода — по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.

\* Стандарт разработан на основе характеристик валориграфа Лабор-МИМ.

## 6 Аппаратура

6.1 Валориграф (приложение А) с рабочими характеристиками:

- частота вращения медленно вращающейся лопасти ( $64\pm2$ ) мин<sup>-1</sup>;

- соотношение частот вращения перемешивающих лопастей  $1,50\pm0,01$ ;

- отклонение пера самописца при нагруженном кронштейне рычага в соответствующем положении (75 мм от центра) калиброванным грузом (900 г — приложение к инструментам) с перемешивающими лопастями, вращающимися в пустой тестомесилке ( $500\pm10$ ) ЕВ;

- скорость движения бланка диаграммы ( $1,00\pm0,03$ ) см/мин.

6.2 Бюретки:

- бюретка градуированная от 25 до 35 см<sup>3</sup>, ценой деления 0,1 см<sup>3</sup>;

- бюретка градуированная от 32 до 42 см<sup>3</sup>, ценой деления 0,1 см<sup>3</sup>.

Время вытекания воды от 0 до 35 см<sup>3</sup> или от 0 до 42 см<sup>3</sup> — не более 20 с.

6.3 Весы лабораторные с допустимой погрешностью взвешивания  $\pm0,1$  г.

6.4 Пластмассовый шпател.

6.5 Водяная баня, отрегулированная на температуру ( $31\pm1$ ) °С.

## 7 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ ИСО 2170.

## 8 Проведение испытаний

### 8.1 Определение влажности муки

Влажность муки определяют по ГОСТ 29143.

### 8.2 Подготовка образцов и аппаратуры

8.2.1 Температуру муки при необходимости доводят до ( $25\pm5$ ) °С. Наполняют колбу валориграфа водой. Включают предварительное и основное (регулируемое) нагревание. Когда температура воздуха в камере достигнет 28 °С, предварительное нагревание отключают. Начинают пропускать воду из крана через охлаждающие трубы валориграфа. До и во время замеса теста контролируют температуру воздуха в центральной части камеры. После установления тестомесилки температура воздуха в центральной части камеры должна быть от 28 до 30 °С (не менее чем за 10 мин до помещения в нее первой испытуемой пробы муки). Во время испытания температура воздуха в камере должна быть ( $30\pm0,2$ ) °С.

8.2.2 Рычаг пишущего пера устанавливают так, чтобы получить нулевое отклонение при вращении лопастей в пустой чистой тестомесилке.

Регулятор масляного амортизатора устанавливают так, чтобы при работающем моторе время, необходимое для перехода пишущего пера от 1000 до 100 ЕВ, составляло ( $1,0\pm0,2$ ) с.

8.2.3 Заполняют бюретку (включая кончик) водой, выливают 1 см<sup>3</sup> воды в сосуд, затем бюретку снова наполняют.

### 8.3 Подготовка навески

Навеску муки 50 г влажностью 14 % (по массе) взвешивают с точностью 0,1 г. Масса муки  $m$  (в граммах) при различной влажности приведена в таблице 1.

Затем основное нагревание выключают. Высыпают муку в тестомесилку. Закрывают тестомесилку крышкой до конца замеса (8.4.1), открывая только на короткое время для добавления воды и сокабливания теста шпателем со стенок тестомесилки (A.2.2). Включают основное регулируемое нагревание.

### 8.4 Проведение испытаний

8.4.1 Муку перемешивают в течение 1 мин. Затем добавляют воду из бюретки в тестомесилку в течение 1 мин, при этом перо самописца записывает процесс начала замеса и образования теста.

П р и м е ч а н и е — Для сокращения времени ожидания бланк диаграммы продвигают вперед во время перемешивания муки. Бланк не следует двигать в обратном направлении.

Добавляют воду в количестве, при котором возможно получить консистенцию, равную 500 ЕВ (9.1). Во время образования и замеса теста со стенок тестомесилки счищают шпателем (6.4) все прилипшие частицы и присоединяют их к общей массе теста, не останавливая тестомесилки. Если полученная консистенция теста слишком крепкая, добавляют немного воды для достижения требуемой консистенции, равной 500 ЕВ (9.1). Затем прекращают замес и очищают тестомесилку.

8.4.2 После очистки помещают части тестомесилки не менее чем на 2 мин в водяную баню (6.5) при температуре  $(31 \pm 1)$  °С. Высушивают и быстро устанавливают. Перед следующим замесом делают перерыв не менее 5 мин с включенным основным нагревом.

8.4.3 При необходимости делают дополнительные замесы до тех пор, пока не будут получены два приемлемых, при которых:

- время добавления воды не превышает 25 с;
- требуемая консистенция теста находится в пределах 480—520 ЕВ (9.1);
- регистрацию замеса продолжают не менее 12 мин после образования теста (9.2), если разжижение началось.

Затем замес прекращают и очищают тестомесилку. Между последовательными замесами повторяют операции, указанные в 8.4.2.

## 9 Обработка результатов

### 9.1 Расчет водопоглощения

По результатам замеса каждого образца муки при требуемой консистенции в пределах 480—520 ЕВ рассчитывают точный объем воды  $V_c$ , см<sup>3</sup>, соответствующий требуемой консистенции 500 ЕВ по формуле

$$V_c = V + 0,016 (c - 500), \quad (1)$$

где  $V$  — объем добавленной воды, см<sup>3</sup>;

$c$  — требуемая консистенция в единицах валориграфа (рисунок 1), рассчитанная по формуле

$$c = \frac{c_1 + c_2}{2}, \quad (2)$$

где  $c_1$  — максимальное значение верхнего контура валориграммы, ЕВ;

$c_2$  — максимальное значение нижнего контура валориграммы, ЕВ.

П р и м е ч а н и е — В случаях, когда валориграмма имеет два максимума, используют более высокое значение.

Для вычисления среднего значения используют результаты двух определений точного объема воды  $V_c$  при условии, что разница между ними не превышает 0,5 см<sup>3</sup>.

Определенное с применением валориграфа водопоглощение  $BPC$ , см<sup>3</sup> на 100 г муки влажностью 14 % (по массе), рассчитывают по формуле

$$BPC = (\bar{V}_c + m - 50)2, \quad (3)$$

где  $\bar{V}_c$  — среднее значение двух определений экспериментально установленного объема воды в кубических сантиметрах, соответствующее требуемой консистенции 500 ЕВ;

$m$  — масса навески муки, г, по таблице 1.

Результат определяют с точностью до 0,1 см<sup>3</sup> на 100 г муки.

Таблица 1 — Масса муки в граммах, эквивалентная 50 г муки влажностью 14 % (по массе)

Влажность, % (по массе)	Масса муки $m$ , г	Влажность, % (по массе)	Масса муки $m$ , г	Влажность, % (по массе)	Масса муки $m$ , г
9,0	47,3	10,5	48,0	12,0	48,9
9,1	47,3	10,6	48,1	12,1	48,9
9,2	47,4	10,7	48,2	12,2	49,0
9,3	47,4	10,8	48,2	12,3	49,0
9,4	47,5	10,9	48,3	12,4	49,1
9,5	47,5	11,0	48,3	12,5	49,1
9,6	47,6	11,1	48,4	12,6	49,2
9,7	47,6	11,2	48,4	12,7	49,3
9,8	47,7	11,3	48,5	12,8	49,3
9,9	47,7	11,4	48,5	12,9	49,4
10,0	47,8	11,5	48,6	13,0	49,4
10,1	47,8	11,6	48,6	13,1	49,5
10,2	47,9	11,7	48,7	13,2	49,5
10,3	47,9	11,8	48,8	13,3	49,6
10,4	48,0	11,9	48,8	13,4	49,7

Окончание таблицы 1

Влажность, % (по массе)	Масса муки $m$ , г	Влажность, % (по массе)	Масса муки $m$ , г	Влажность, % (по массе)	Масса муки $m$ , г
13,5	49,7	15,1	50,6	16,7	51,6
13,6	49,8	15,2	50,7	16,8	51,7
13,7	49,8	15,3	50,8	16,9	51,7
13,8	49,9	15,4	50,8	17,0	51,8
13,9	49,9	15,5	50,9	17,1	51,9
14,0	50,0	15,6	50,9	17,2	51,9
14,1	50,1	15,7	51,0	17,3	52,0
14,2	50,1	15,8	51,1	17,4	52,1
14,3	50,2	15,9	51,1	17,5	52,1
14,4	50,2	16,0	51,2	17,6	52,2
14,5	50,3	16,1	51,3	17,7	52,2
14,6	50,4	16,2	51,3	17,8	52,3
14,7	50,4	16,3	51,4	17,9	52,4
14,8	50,5	16,4	51,4	18,0	52,4
14,9	50,5	16,5	51,5		
15,0	50,6	16,6	51,6		

П р и м е ч а н и е — Значения  $m$ , приведенные в таблице, рассчитаны по формуле

$$m = \frac{4300}{100 - H},$$

где  $H$  — влажность испытуемой навески муки, % (по массе).

## 9.2 Время образования теста

За время образования теста принимают время от начала добавления воды до точки на кривой непосредственно перед появлением первых признаков снижения консистенции (рисунок 1).

П р и м е ч а н и е — В случаях, когда волориграмма имеет два максимума, для измерения времени образования теста используют более высокое значение.

За результат принимают среднее значение времени образования теста, рассчитанное по двум волориграммам с точностью до 0,5 мин, при условии, что разница между двумя определениями не превышает 1 мин — в случаях, когда время образования теста до 4 мин, или 25 % их среднего значения — в случаях, когда время образования теста более 4 мин.

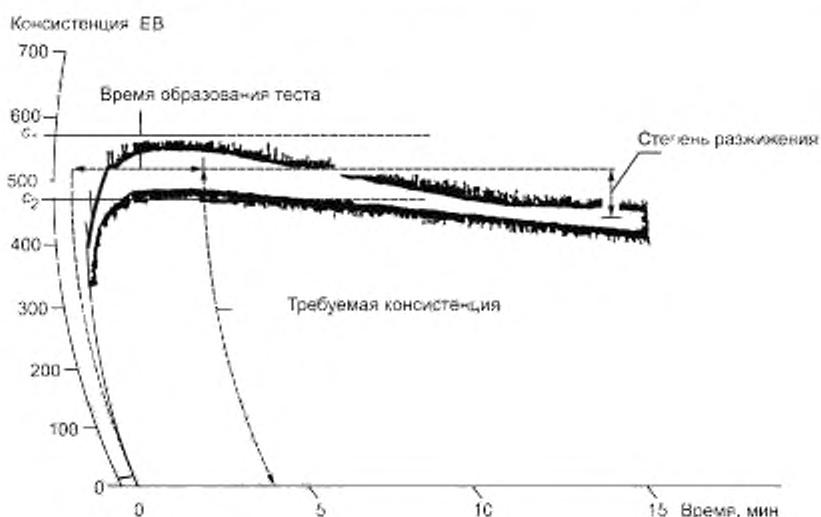


Рисунок 1 — Валориграмма, отражающая измеряемые показатели

### 9.3 Степень разжижения

Степень разжижения теста представляет собой разность между центром валориграммы, полученной в конце образования теста, и центром валориграммы, полученной через 12 мин после окончания образования теста (рисунок 1).

За результат принимают среднеарифметическое значение степени разжижения, рассчитанное по двум валориграммам с точностью до 5 ЕВ, при условии, что разница между ними не превышает 20 ЕВ — для степени разжижения до 80 ЕВ или 25 % их среднеарифметического — для степени разжижения более 80 ЕВ.

### 9.4 Сходимость испытаний

Если в одном или нескольких случаях разница между измерениями двух валориграмм превышает значения, указанные в 9.1—9.3, проводят два новых замеса в соответствии с 8.4.3.

### 9.5 Воспроизводимость испытаний

Межлабораторные испытания, включающие 4 серии испытаний на пробах муки различного диапазона качества, были проведены в 1985 г. с привлечением 11 лабораторий. Результаты сходимости и воспроизводимости валорграфических измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Сходимость и воспроизводимость валорграфических измерений

Параметр	Сходимость	Воспроизводимость
Водопоглощение	0,7 см <sup>3</sup> на 100 г муки	5 см <sup>3</sup> на 100 г муки
Время образования теста	1,0 мин	Результаты неубедительны
Степень разжижения	До 80 ЕВ — 20 ЕВ, св. 80 ЕВ — 25 % среднеарифметического значения	60 % среднеарифметического значения

## 10 Отчет об испытании

Отчет об испытании должен содержать:


- использованный метод и полученные результаты;
- детали и процедуры, не установленные настоящим стандартом, которые могут повлиять на результаты испытаний;
- информацию, необходимую для полной идентификации испытуемой пробы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное)

**Описание валориграфа**

**A.1 Общее описание**

Валориграф состоит из тестомесилки, бюретки и средств для записи консистенции теста в виде валориграмм (A.2). Схема устройства валориграфа показана на рисунке A.1.

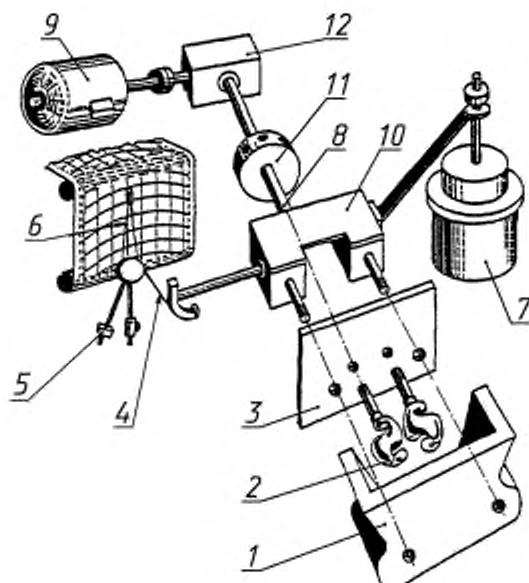

1 — отсоединяемая часть тестомесилки; 2 — смещающие лопасти; 3 — задняя стенка тестомесилки; 4 — бронзовая лента между кронштейном тестомесилки и системой рычагов записывающего устройства; 5 — система рычагов записывающего устройства; 6 — кронштейн пера записывающего устройства; 7 — масляный амортизатор; 8 — ведущий вал; 9 — мотор; 10 — редуктор; 11 — сцепление; 12 — червячная передача

Рисунок А.1 — Схема устройства валориграфа

Валориграф заключен в металлический корпус. В центральной части камеры расположены тестомесилка, бюретка и колба с водой. Доступ к ним осуществляется через плексигласовую дверцу в передней части камеры. Температура воздуха в центре камеры терmostатически регулируется (A.3).

**A.2 Устройство валориграфа**

**A.2.1** Валориграф состоит из:

- тестомесилки (A.2.2), части которой могут быть отделены друг от друга;
- электромотора с редуктором (A.2.3), вращающим лопасти тестомесилки;
- системы рычагов, действующей как динамометр для измерения момента вращения тестомесилки;
- амортизатора (A.2.3) для демпфирования движений динамометра;
- записывающего прибора (A.2.4), перо которого приводится в движение динамометром;
- бюретки для дозирования воды, добавляемой к муке.

**A.2.2** Тестомесилка, снабженная двумя лопастями и предназначенная для замешивания теста из 50 г муки, состоит из четырех частей:

- a) задней стенки, через которую проходят оси для прикрепления смещающих лопастей;
- b) и в) двух смещающих лопастей;
- г) отсоединяемой части тестомесилки (две боковые и передняя стенки и дно соединены в одно целое).

Части а) и г) соединяют при помощи двух болтов с крыльчатыми гайками. Части б), в) и г) могут быть разъединены для очистки.

Медленно смещающая лопасть тестомесилки приводится в движение напрямую от вала редуктора с частотой вращения  $64 \text{ мин}^{-1}$ .

Быстро смещающая лопасть снабжена приводом из зубчатых колес и вращается с частотой в 1,5 раза большей, чем медленно смещающая лопасть.

Тестомесилку закрывают плоской пластмассовой пластинкой, расположенной в верхней ее части. Пластинку снимают только для добавления воды или соскребания теста.

**A.2.3** Конструкция тестомесилки допускает поворот ее вместе с редуктором на ведущем валу. Сопротивление теста при замесе создает несбалансированное усилие вращения тестомесилки, которое может вызывать ее поворот.

С левой стороны тестомесилки расположен кронштейн, соединенный с системой рычагов пера записывающего устройства. Противодействие усилию вращения тестомесилки пропорционально степени отклонения пера записывающего устройства.

В результате отклонение пера записывающего устройства (при условии, что два усилия вращения уравновешивают друг друга) пропорционально усилию вращения в тестомесилке, т.е. сопротивлению замешиваемого теста.

Движение тестомесилки, системы рычагов и пера записывающего устройства тормозится плунжером, погруженным в силиконовое масло; плунжер соединен с кронштейном с правой стороны тестомесилки. Степень торможения можно регулировать; усиление торможения приводит к образованию более узкой кривой.

**A.2.4** Диаграммная бумага поставляется в виде рулона. Записывающее устройство приводится в действие электрическим мотором с часовым механизмом. Скорость движения бумаги в записывающем устройстве 1,00 см/мин. Вдоль рулона диаграммная бумага имеет шкалу в минутах. Поперек диаграммной бумаги нанесена циркулярная шкала (радиусом 200 мм) от 0 до 1000 ЕВ.

**A.2.5** Бюretteк управляет двумя кнопками, одна из которых служит для наполнения, а вторая — для выливания воды в тестомесилку. Выбор бюretteк осуществляют на основе ожидаемого водопоглощения.

#### **A.3 Регулирование температуры**

Регулирование температуры в центральной части камеры осуществляется циркуляцией воздуха через воздухопроводы, оборудованные:

- а) электрическим элементом предварительного подогрева большой мощности, контролируемым кнопкой;
- б) электрическим нагревательным элементом малой мощности, контролируемым терморегулятором в);
- в) терморегулятором в центральной части камеры, установленным на 30 °С, контролирующим нагревательный элемент б);
- г) вентилятором с электромотором;
- д) металлическим змеевиком для охлаждения прибора потоком водопроводной воды.

Температура масла 40 °С в масляном амортизаторе поддерживается электрическим нагревательным элементом и терморегулятором, контролирующими нагревательный элемент.

---

ОКС 67.060

Н39

ОКСТУ 9293

Ключевые слова: пшеничная мука, тесто, испытания физических свойств, определение, водопоглощение, реологические свойства, валориграф, валориграмма

---