
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
8.683—
2009

Государственная система обеспечения
единства измерений

ВОЛЬТМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ

Методика поверки

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 1128-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2011, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Операции поверки	2
5 Средства поверки	2
6 Требования к квалификации поверителей	4
7 Требования безопасности	4
8 Условия проведения поверки и подготовка к ней	4
9 Проведение поверки	4
10 Оформление результатов поверки	9
Приложение А (обязательное) Основные метрологические характеристики селективных вольтметров, подлежащих поверке по настоящему стандарту	10
Библиография	11

**Поправка к ГОСТ Р 8.683—2009 Государственная система обеспечения единства измерений.
Вольтметры электронные селективные. Методика поверки (Издание, март 2019 г.)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 1. Дата введения	— 2011—01—01	— 2011—07—01

(ИУС № 5 2021 г.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

ВОЛЬТМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements. Selective electronic voltmeters. Verification methods

Дата введения — 2011—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электронные селективные вольтметры (далее — вольтметры), предназначенные для измерения переменного напряжения в диапазоне частот от 20 Гц до 35 МГц, и устанавливает методы их первичной и периодической поверок.

Стандарт распространяется на вольтметры, представленные в приложении А, а также на другие вольтметры, метрологические характеристики которых аналогичны метрологическим характеристикам данных вольтметров.

Передача единицы переменного напряжения осуществляется в соответствии с рекомендациями [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ 12.3.019 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по рекомендации [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 средства поверки: Эталоны, калибраторы, эталонные приборы, поверочные установки и другие средства измерений, применяемые при поверке в соответствии с установленными правилами.

3.2 эталонный прибор: Прибор, используемый в качестве эталонного при проведении поверки.

3.3 номинальное значение: Значение, принятое в качестве номинального значения параметра.

3.4 нормирующее значение: Значение, к которому приведена погрешность.

П р и м е ч а н и е — В качестве нормирующего значения могут быть использованы номинальное значение параметра, предел диапазона измерений, модуль разности пределов измерений.

3.5 нормальные условия проведения поверки: Условия измерений, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, при которых изменением результата поверки допускается пренебречь.

4 Операции поверки

4.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер подраздела настоящего стандарта	Обязательность проведения операции		
		при выпуске из производства	при ремонте	при эксплуатации и хранении
Внешний осмотр	9.1	Да	Да	Да
Опробование	9.2	Да	Да	Да
Определение метрологических характеристик	9.3	Да	Да	Да
Определение уровня внутренних комбинационных сигналов и уровня собственных шумов (уровень внутренних помех)	9.3.1	Да	Да	Нет
Определение основной погрешности и погрешности в рабочей области частот при измерении напряжения	9.3.2	Да	Да	Да
Определение погрешности установки частоты настройки	9.3.3	Да	Да	Да
Определение ширины полосы пропускания и коэффициента прямоугольности резонансной характеристики	9.3.4	Да	Да	Да

5 Средства поверки

5.1 При проведении поверки должны быть применены средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование средства поверки	Требуемые нормативные и технические характеристики
Установка для поверки (электронных) вольтметров	Диапазон напряжений 100 мкВ — 3 В, диапазон частот 10—50 Гц, коэффициент гармоник 0,1 % — 0,5%, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (0,2 \% — 3 \%)$
	Диапазон напряжений 100 мкВ — 100 В, диапазон частот 20 Гц — 100 кГц, коэффициент гармоник не более 0,06 %, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (0,02 \% — 0,1 \%)$
	Диапазон напряжений 10 мкВ — 300 В, частота 45, 400 и 1000 Гц, коэффициент гармоник не более 0,2, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (0,3 … 0,5) + \frac{0,0003}{U_{\text{ном}}} \%$, где $U_{\text{ном}}$ — номинальное значение напряжения

Окончание таблицы 2

Наименование средства поверки	Требуемые нормативные и технические характеристики
Вольтметр переменного тока	Диапазон напряжений 0,01—100 В, диапазон частот 20 Гц — 1000 МГц, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (0,2\% — 2,8\%)$
	Диапазон напряжений 0,3 мВ — 300 В, диапазон частот 10 Гц — 50 МГц, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (2,5\% — 10\%)$
	Диапазон напряжений 0,01 мВ — 300 В, диапазон частот 5 Гц — 5 МГц, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (1\% — 4\%)$
Делитель напряжения	Диапазон ослабления 0—90 дБ, диапазон частот 0—6,5 (35) МГц, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (0,01—0,3)$ дБ или $\pm (0,12\% — 3,5\%)$
	Диапазон ослабления 0—90 дБ, диапазон частот 0—30 МГц, предел допускаемой основной погрешности $\pm (0,004—1,26)$ дБ или $\pm (0,05\% — 15\%)$
Электронно-счетный частотометр	Диапазон частот 0,1 Гц — 120 МГц. диапазон входных напряжений 100 мВ — 100 В

5.2 Для определения основной погрешности и погрешности в рабочей области частот применяют эталонные средства измерений, позволяющие измерять или воспроизводить на входе вольтметра переменное напряжение с погрешностью, не превышающей одной трети соответствующего предела допускаемой погрешности вольтметра во всем его поверяемом диапазоне напряжений и частот.

Арифметическая сумма погрешностей эталонного вольтметра и эталонного делителя напряжения в каждой поверяемой отметке не должна превышать одной трети погрешности поверяемого вольтметра.

5.3 Нестабильность уровня за время измерений и коэффициент гармоник воспроизводимого на входе вольтметра переменного напряжения не должны превышать 0,1 соответствующего предела допускаемой погрешности вольтметра во всем его поверяемом диапазоне напряжений и частот.

5.4 Для определения полосы пропускания и погрешности установки частоты применяют эталонные средства измерений, позволяющие воспроизводить или измерять частоту переменного напряжения с погрешностью, не превышающей 0,1 соответствующего предела допускаемой погрешности установки частоты вольтметра во всем его поверяемом диапазоне частот.

5.5 Средства поверки выбирают в зависимости от диапазона частот, напряжения и пределов допускаемой погрешности поверяемого вольтметра.

5.6 Вспомогательные средства измерений

5.6.1 Регулируемый источник переменного напряжения (измерительный генератор), обеспечивающий поверку вольтметра во всем диапазоне напряжений и частот (например, типов ГЗ-109, ГЗ-118, Г-154).

5.6.2 Фильтры с диапазоном частот 20 Гц — 35 МГц (например, типа ФРФ-1 с диапазоном частот 1—50000 кГц и коэффициентом подавления гармоник более 5; типа ФНЧ-25-1 с диапазоном частот 0,05—25 МГц и коэффициентом подавления гармоник более 1000).

5.6.3 Коаксиальные измерительные электрические соединители (далее — коаксиальные соединители) из комплектов, применяемые при поверке средств измерений.

5.6.4 Условия поверки контролируют, используя следующие средства измерений:

- измеритель неполинейных искажений в цепи питания. Диапазон измерений напряжения 154—286 В, пределы допускаемой приведенной погрешности $\pm 0,5\%$; диапазон измерений частоты 45—55 Гц, пределы абсолютной погрешности $\pm 0,1$ Гц; диапазон измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения 0,1 % — 25 %, пределы относительной погрешности $\pm 10,0\%$;

- термометр. Диапазон измерений температуры от 15 °C до 40 °C, пределы допускаемой погрешности $\pm 0,5$ °C;

- психрометрический гигрометр. Диапазон измерений относительной влажности воздуха 20 % — 90 %, пределы допускаемой погрешности $\pm 5\%$,

- барометр. Диапазон измерений давления 80—106 кПа, пределы допускаемой погрешности $\pm 1,0$ кПа.

5.7 Допускается применение других средств измерений, удовлетворяющих по метрологическим характеристикам требованиям настоящего стандарта.

5.8 Все средства измерений, используемые при поверке, должны быть исправны и иметь свидетельства о поверке или отметки о поверке в формулярах (паспортах).

6 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в соответствии с правилами [3] в качестве поверителей средств измерений электрических величин, имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

7 Требования безопасности

7.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники безопасности.

7.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности ГОСТ 12.3.019, правил [4] и [5], а также меры безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации средств измерений показателей качества электрической энергии и в эксплуатационной документации на средства поверки.

7.3 Перед проведением операций поверки средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления следует проводить ранее других соединений, а отсоединение — после всех отсоединений.

8 Условия проведения поверки и подготовка к ней

8.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды (20 ± 5) °С;
- атмосферное давление ($100,0 \pm 4$) кПа; (750 ± 30) мм рт. ст.;
- относительная влажность воздуха (65 ± 15) %;
- напряжение питания сети переменного тока частотой 50 Гц ($220 \pm 4,4$) В;
- отсутствие вибраций и сильных электромагнитных полей, о чем должно свидетельствовать отсутствие колебаний нуль-индикатора (далее — индикатор) поверяемого вольтметра.

8.2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- поверяемый вольтметр и средства поверки должны быть установлены так, чтобы были исключены их нагревание от внешних источников тепла, а также толчки и удары;
- поверяемый вольтметр и средства поверки перед включением в сеть должны быть надежно заземлены;
- поверяемый вольтметр и средства поверки должны быть включены в сеть и выдержаны в течение времени установления рабочего режима, указанного в технической документации (далее — ТД);
- работу с поверяемым средством измерений и средствами поверки следует проводить в соответствии с требованиями ТД на них.

8.3 Средства поверки подготавливают к работе в соответствии с ТД на них.

9 Проведение поверки

9.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должны быть установлены:

- соответствие комплектности поверяемых вольтметров технической документации (кроме запасных частей и запасных принадлежностей);
- отсутствие механических повреждений или неисправностей регулировочных и соединительных элементов, влияющих на их нормальную работу.

9.2 Опробование

- 9.2.1 При опробовании вольтметра должны быть выполнены операции, указанные в ТД на него.
- 9.2.2 После включения вольтметра в сеть питания и прогрева в течение времени, указанного в ТД, проверяют возможность его градуировки (калибровки).
- 9.2.3 При подаче на вход вольтметра переменного напряжения (от установки для поверки вольтметров или измерительного генератора) проверяют возможность измерения напряжения и возможность настройки частоты по соответствующим отсчетным устройствам на всех поддиапазонах вольтметра.

9.3 Определение метрологических характеристик

9.3.1 Определение уровня внутренних комбинационных сигналов и уровня собственных шумов (уровня внутренних помех)

- 9.3.1.1 Уровень внутренних помех определяют, если он нормирован в ТД на вольтметр.
- 9.3.1.2 Перед измерением уровня внутренних помех проводят градуировку (калибровку) вольтметра по методике, указанной в ТД на него.
- 9.3.1.3 Уровень внутренних помех определяют по показаниям отсчетного устройства напряжения поверяемого вольтметра без подачи сигнала на его накоротко замкнутый вход или при подключенной к входу нагрузке из комплекта вольтметра, значение которой указано в ТД на вольтметр.

9.3.1.4 Уровень внутренних помех измеряют на поддиапазонах (пределах) измерений напряжения, соответствующих нормированному значению уровня внутренних помех поверяемого вольтметра, при полосах пропускания и частотах, указанных в ТД на поверяемый вольтметр.

9.3.1.5 Уровень внутренних помех не должен превышать значений, указанных в ТД на поверяемый вольтметр.

9.3.2 Определение основной погрешности и погрешности в рабочей области частот при измерении напряжения

- 9.3.2.1 Погрешность вольтметра определяют методом прямых измерений напряжения, воспроизведенного установкой для поверки вольтметров, по схеме, приведенной на рисунке 1, или методом непосредственного сличения показаний поверяемого (ПВ) и эталонного (ЭВ) вольтметров с применением эталонного делителя напряжения (ЭД) или без него по схемам, приведенным на рисунках 2, 3.

Метод прямых измерений обеспечивает более высокую производительность измерений.

9.3.2.2 Структурные схемы соединения приборов, приведенные на рисунках 2, 3, выбирают в зависимости от соотношения диапазонов измерений напряжения ПВ и ЭВ.

Значение активного выходного сопротивления ЭД $R_{\text{вых}}$, Ом, не должно превышать значения, определяемого по формуле

$$R_{\text{вых}} \leq Z_B \frac{\delta}{1000}, \quad (1)$$

где δ — предел допускаемой относительной погрешности ПВ, %;


Z_B — полное входное сопротивление ПВ, определяемое по формуле

$$Z_B = \frac{R}{\sqrt{R^2(2\pi f C)^2 + 1}}, \quad (2)$$

где f — значение частоты измеряемого напряжения, на которой определяют погрешность ПВ, Гц;


C — входная емкость ПВ, Ф;

R — активное входное сопротивление ПВ, Ом.




1 — установка для поверки вольтметров; 2 — коаксиальный соединитель;
3 — поверяемый вольтметр

Рисунок 1

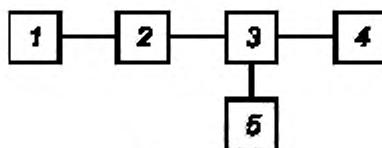

1 — измерительный генератор; 2 — фильтр; 3 — коаксиальный соединитель;
4 — поверяемый вольтметр; 5 — эталонный вольтметр

Рисунок 2

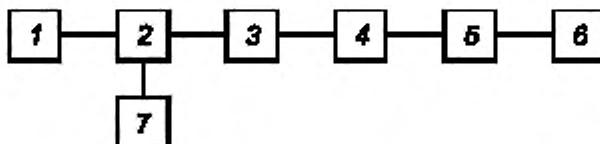

1 — измерительный генератор; 2 — фильтр; 3, 5 — коаксиальные соединители, 4 — эталонный делитель напряжения;
6 — поверяемый вольтметр; 7 — эталонный вольтметр

Рисунок 3

9.3.2.3 Погрешность вольтметра определяют при полосе пропускания, указанной в ТД на вольтметр.

9.3.2.4 Перед проведением каждого измерения проверяют электрическую установку указателя шкалы на нулевую или условную отметку и правильность градуировки, если эти операции предусмотрены в ТД на вольтметр.

9.3.2.5 Основную погрешность определяют на частоте градуировки, указанной в ТД на вольтметр; при отсутствии нормирования основной погрешности на частоте градуировки ее определяют при предельных значениях частот (наименьшей и наибольшей) первой рабочей (нормальной) области диапазона частот вольтметра.

Основную погрешность определяют в конечных числовых отметках шкал всех поддиапазонов измерений напряжения.

При первичной поверке основную погрешность определяют дополнительно в каждой числовом отметке шкал основных поддиапазонов измерений напряжения при тех же частотах. При периодической поверке основную погрешность определяют в двух числовых отметках (начальной, для которой нормирована погрешность, и средней) шкал основных поддиапазонов измерений напряжения на частоте градуировки или на одной из предельных частот первой рабочей (нормальной) области диапазона частот вольтметра.

Если в ТД на вольтметры нет специального указания, за основные принимают поддиапазоны измерений с наименьшим пределом допускаемой основной погрешности, включая поддиапазон измерений, на котором проводят градуировку вольтметра.

9.3.2.6 Погрешность в других рабочих (расширенных) областях диапазона частот вольтметра определяют в конечных числовых отметках шкал всех поддиапазонов измерений напряжения в каждой области при предельных частотах, при которых не была определена погрешность в смежной области частот с меньшим пределом допускаемой погрешности.

Допускаемые изменения показаний в рабочих областях частот относительно показаний на частоте градуировки, если они нормированы в ТД на вольтметр, определяют в процентах по результатам измерений по 9.3.2.5 и 9.3.2.6.

П р и м е ч а н и я

1 Допускается определять погрешность вольтметра на отдельных поддиапазонах измерений напряжения и частотах рабочего диапазона расчетом по результатам определения основной погрешности на всех поддиапазонах измерений напряжения на частоте градуировки (или на одной из частот нормальной области) и погрешности на одном поддиапазоне измерений напряжения во всем рабочем диапазоне частот по методике, приведенной в ТД на вольтметр.

2 При ведомственной периодической поверке вольтметра допускается определять его погрешность только в применяемых на данном предприятии (учреждении) ограниченных диапазонах уровней напряжения и частот с обязательным указанием на лицевой или боковой панели прибора этих диапазонов.

9.3.2.7 Значение абсолютной погрешности Δ в единицах измеряемого напряжения рассчитывают:

- по схеме, приведенной на рисунке 2, и по формуле

$$\Delta = U - U_s; \quad (3)$$

- по схеме, приведенной на рисунке 3, и по формуле

$$\Delta = U - M_k U_s, \quad (4)$$

где U — показание поверяемого вольтметра;

U_s — показание эталонного вольтметра;

M_k — масштабный коэффициент передачи эталонного делителя напряжения, равный $\frac{1}{K_d}$ (где K_d — коэффициент деления).

9.3.2.8 В зависимости от способа нормирования погрешности вольтметра рассчитывают:

- относительную номинальную погрешность $\delta_{\text{ном}}$, %, по формуле

$$\delta_{\text{ном}} = \frac{\Delta}{U_s} \cdot 100; \quad (5)$$

- приведенную погрешность $\delta_{\text{пр}}$, %, по формуле

$$\delta_{\text{пр}} = \frac{\Delta}{U_k} \cdot 100, \quad (6)$$

где U_k — значение конечного поддиапазона измерений, на котором определена погрешность вольтметра.

При использовании поверочных установок приведенную погрешность γ рассчитывают по формуле

$$\gamma = \delta_{\text{ном}} \frac{U_s}{U_k}, \quad (7)$$


а относительную погрешность $\delta_{\text{ном}}$, дБ, по формуле

$$\delta_{\text{ном}} = 20 \lg (1 + \delta_{\text{ном}}/100). \quad (8)$$

9.3.2.9 Значение погрешности вольтметра при любом методе ее определения не должно превышать допускаемых значений, указанных в ТД на вольтметр.


9.3.3 Определение погрешности установки частоты настройки

9.3.3.1 Погрешность установки частоты настройки определяют методом сличения показаний отсчетных устройств частоты поверяемого вольтметра и измерительного генератора или эталонного частотомера. Структурные схемы соединения приборов приведены на рисунках 4 и 5.



1 — измерительный генератор; 2 — коаксиальный соединитель,
3 — поверяемый вольтметр

Рисунок 4



1 — измерительный генератор, 2 — коаксиальный соединитель,
3 — поверяемый вольтметр, 4 — эталонный частотомер

Рисунок 5

9.3.3.2 Погрешность установки частоты настройки определяют в трех (двух крайних и средней) отметках шкал каждого поддиапазона установки частоты настройки вольтметра при полосе пропускания, указанной в ТД на вольтметр.

На вход вольтметра подают напряжение от генератора, регулируя его частоту и уровень, добиваются максимального показания по отсчетному устройству шкалы напряжения вольтметра (вблизи конечной числовой отметки шкалы).

Действительное значение частоты определяют по показаниям отсчетного устройства генератора или образцового частотомера.

9.3.3.3 Погрешность установки частоты настройки в зависимости от указанного в ТД на вольтметр способа ее нормирования, рассчитывают:

- абсолютную погрешность Δ_f по формуле

$$\Delta_f = f - f_0, \quad (9)$$

- относительную номинальную погрешность $\delta_{\text{ном}}$, %, по формуле

$$\delta_{\text{ном}} = \frac{\Delta_f}{f} \cdot 100, \quad (10)$$

где f — значение частоты, установленное на отсчетном устройстве поверяемого вольтметра, Гц;


f_0 — значение частоты, полученное при измерении эталонным средством измерений, Гц.

9.3.3.4 Значение погрешности установки частоты настройки вольтметра не должно превышать предела допускаемых значений, указанных в ТД на вольтметр.

9.3.4 Определение ширины полосы пропускания и коэффициента прямоугольности резонансной характеристики

9.3.4.1 Ширину полосы пропускания определяют в начале, середине и конце рабочего диапазона (или поддиапазона) частот (с учетом определяемой ширины полосы пропускания на крайних частотах рабочего диапазона) на основном поддиапазоне измерений напряжения по схеме, приведенной на рисунке 6. Эту операцию проводят для всех нормированных в ТД на вольтметр полос пропускания.

При мечание — Для гетеродинных вольтметров ширину полосы пропускания определяют только при частотах вблизи начала каждого поддиапазона частот в соответствии с требованиями ТД на вольтметр.

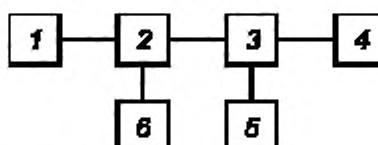

1 — измерительный генератор; 2, 3 — коаксиальный соединитель; 4 — поверяемый вольтметр;
5 — эталонный вольтметр; 6 — эталонный частотометр

Рисунок 6

9.3.4.2 На вход вольтметра подают переменное напряжение и, регулируя частоту и уровень напряжения генератора, устанавливают максимальное показание, равное значению U_k , на отсчетном устройстве шкалы напряжения поверяемого вольтметра.

При постоянном уровне выходного напряжения генератора, контролируемого эталонным вольтметром, изменяя частоту генератора в сторону уменьшения и увеличения, добиваются показаний, равных значению $0.7U_k$ (минус 3 дБ относительного значения U_k); эталонным частотометром измеряют частоты, соответствующие приведенному выше показанию вольтметра; значение ширины полосы пропускания определяют как разность измеренных значений частот.

Значение ширины полосы пропускания вольтметра не должно превышать значений, указанных в ТД на вольтметр.

9.3.4.3 Коэффициент прямоугольности резонансной характеристики вольтметра определяют при первичной поверке, если этот параметр указан в ТД на вольтметр.

При этом дополнительно по 9.3.4.2 определяют ширину полосы пропускания на уровне минус 40 дБ по методике, указанной в ТД на поверяемый вольтметр. Коэффициент прямоугольности резонансной характеристики (далее — коэффициент прямоугольности) рассчитывают как отношение ширины полосы пропускания на уровне минус 40 дБ к ширине полосы пропускания на уровне минус 3 дБ. Значение коэффициента прямоугольности не должно превышать значения, приведенного в ТД на поверяемый вольтметр.

9.3.5 Если при поверке вольтметра значение любой из метрологических характеристик будет превышать допускаемое значение, его определяют не менее трех раз, чтобы исключить грубую погрешность измерения (промах).

10 Оформление результатов поверки

10.1 Положительные результаты первичной поверки вольтметров оформляют отметкой в паспорте с нанесением оттиска поверительного клейма, удостоверенного подписью поверителя.

10.2 Положительные результаты периодической поверки вольтметров оформляют выдачей свидетельства установленной формы.

10.3 Вольтметры, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску в обращение и применению не допускают, на них выдают извещение о непригодности с указанием причин.

Приложение А
(обязательное)Основные метрологические характеристики селективных вольтметров,
подлежащих поверке по настоящему стандарту

Наименование нормируемого параметра	Допускаемые значения параметров для приборов					
	B6-1	B6-2	B6-4	B6-6	B6-9	B6-10
Диапазон частот, кГц	150—35000	0,02—200	0,02—30	0,02—200	0,02—100	100—30000
Пределы допускаемой погрешности установки частоты, %	± (2,5—12,5)	± 10	± 6	± 6	—	± (5—10)
Диапазон измеряемых напряжений	2 мкВ — 10 мВ до 1 В (с делителем)	1 мкВ — 300 В	3 мкВ — 300 мВ (селективный режим); 30 мкВ — 3 В (широкополосный режим)	3 мкВ — 300 В	1 мкВ — 1 В (селективный режим); 30 мкВ — 10 В (широкополосный режим)	1 мкВ — 10 мВ до 1 В (с делителем)
Пределы допускаемых приведенных погрешностей при измерении напряжений, %	± (12—15); ± 25 (3 мкВ)	± (10—15)	± 6	± (6—10) ± 15 (3 мкВ)	± (6—10) ± 15 (3 мкВ) (селективный режим) ± 6 (широкополосный режим)	± (10—15)
Уровень внутренних помех, мкВ	≤ 0,5 (1 кГц) ≤ 1,5 (10 кГц)	≤ 8	≤ 0,7 (селективный режим) ≤ 6 (широкополосный режим)	0,35—2	≤ 0,7 (селективный режим)	≤ 0,7 (1 кГц) ≤ 2 (9 кГц)
Ширина полосы пропускания (на уровне — 3 дБ)	1: 10 кГц	Не более ± 15 % частоты настройки	8 % — 15 % частоты настройки	Не более ± 15 % частоты настройки	(5 ± 3) % частоты настройки	1: 9 кГц

Библиография

- [1] МИ 1935—88 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот $1 \cdot 10^{-2}$ — $3 \cdot 10^9$ Гц
- [2] Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29—2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
- [3] Правила по метрологии ПР 50.2.012—94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измерений
- [4] Правила Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Минэнерго РФ, приказ № 6 от 13 января 2003 г.
- [5] Межотраслевые правила Межотраслевые правила по охране труда. Минтруда РФ, постановление № 3 от 5 января 2001. Минэнерго РФ, приказ № 163 от 27 декабря 2000 г.

Ключевые слова: вольтметры, средства измерений, поверка, методы поверки

Редактор *Е.В. Лукьянова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 11.03.2019 Подписано в печать 21.03.2019. Формат 60×84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,25.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

**Поправка к ГОСТ Р 8.683—2009 Государственная система обеспечения единства измерений.
Вольтметры электронные селективные. Методика поверки (Издание, март 2019 г.)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 1. Дата введения	— 2011—01—01	— 2011—07—01

(ИУС № 5 2021 г.)