


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»
(ФГУП «УНИИМ»)

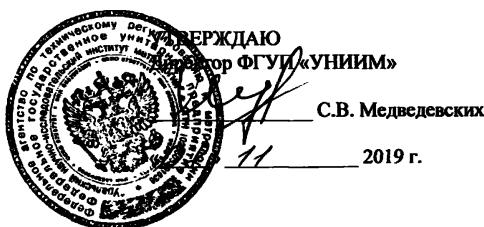

Государственная система обеспечения единства измерений
**УСТАНОВКИ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА И ЗЕРНОПРОДУКТОВ СЭШ-10ЭМ**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 40-241(243)-2019

г. Екатеринбург
2019

ПРЕДИСЛОВИЕ

**1 РАЗРАБОТАНА Федеральным государственным унитарным предприятием
«Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)**

2 УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ФГУП «УНИИМ» _____ 2019 г.

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФГУП «УНИИМ» под № 40-241(243)-2019.

Содержание

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Операции поверки	4
4 Средства поверки	5
5 Требования безопасности	5
6 Условия поверки и подготовка к ней	5
7 Проведение поверки	6
8 Оформление результатов поверки	9

Государственная система обеспечения единства измерений	УСТАНОВКИ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА И ЗЕРНОПРОДУКТОВ СЭШ-10ЭМ МЕТОДИКА ПОВЕРКИ	40-241(243)-2019
---	---	------------------

Дата введения: 2019 г.**1 Область применения**

Настоящий документ распространяется на установки воздушно-тепловые для измерений влажности зерна и зернопродуктов СЭШ-10ЭМ и устанавливает методику первичной и периодической поверок.

Установки воздушно-тепловые для измерений влажности зерна и зернопродуктов СЭШ-10ЭМ (далее - установки) предназначены для измерений массовой доли влаги (влажности) в зерне, зернопродуктах и семенах масличных культур по стандартизованным методикам на конкретное вещество (продукт).

Интервал между поверками - один год.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике поверки использованы ссылки на следующие нормативные документы (далее НД) и нормативные правовые акты РФ:

ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (с изменениями, утвержденными Приказом Минпромторга от 28 декабря 2018 г. № 5329).

Приказ Росстандарта от 29.12.2018 № 2832 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания воды в твердых и жидким веществах и материалах».

3 Операции поверки

3.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта МП	Обязательность проведения операции при поверке	
		первичной	периодической
Внешний осмотр	7.1	Да	Да
Опробование	7.2	Да	Да
Определение абсолютной погрешности установления и поддержания температуры	7.3	Да	Нет
Определение абсолютной погрешности результатов измерений массовой доли влаги	7.4	Да	Да

3.2 Если при проведении той или иной операции получен отрицательный результат, дальнейшую поверку прекращают, а установку бракуют.

4 Средства поверки

4.1 При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта МП	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.1	Термогигрометр CENTER-313 с диапазоном температур от минус 20 до + 60 °C с пределом допускаемой погрешности $\pm 0,7$ °C; с диапазоном относительной влажности от 10 до 100 % с пределом допускаемой погрешности $\pm 2,5$ %
7.3	Измеритель температуры с щупом, диапазон измерений температур от 100 °C до 200 °C, с погрешностью 1,0 °C
7.4	Рабочий эталон единицы массовой доли влаги в твердых веществах и материалах в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений содержания воды в твёрдых и жидкых веществах и материалах, утвержденной Приказом Росстандарта от 29.12.2018 № 2832. (Установки измерительные эталонные 1-го разряда массовой доли влаги в твердых веществах и материалах типа ЭУВТ-1, УВТО-1М, УВТО-М); Стандартные образцы массовой доли влаги зерна 1-го разряда (ГСО 8989-2008), интервал допускаемых аттестованных значений от 7,0 % до 18,0 %, абсолютная погрешность аттестованного значения $\pm 0,1$ %; Стандартные образцы массовой доли влаги зерна 2-го разряда (ГСО 8990-2008), интервал допускаемых аттестованных значений от 7,0 % до 25,0 %, абсолютная погрешность аттестованного значения: $\pm 0,2$ % в интервале от 7,0 % до 18,0 % вкл.; $\pm 0,3$ % в интервале от 18,0 % до 25,0 % вкл.; Стандартные образцы массовой доли влаги в продуктах переработки зерна (ГСО 9564-2010), диапазон измерений от 7,0 % до 16,0 %, абсолютная погрешность аттестованного значения $\pm 0,2$ %.

4.2 Допускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице 2, но обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

4.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке, эталоны должны быть аттестованы и иметь действующие свидетельства об аттестации, стандартные образцы утвержденного типа (СО) – действующие паспорта.

5 Требования безопасности

5.1 Установки не содержат компонентов опасных для жизни и здоровья пользователя.

5.2 При проведении поверки необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.

6 Условия поверки и подготовка к ней

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены условия:

температура окружающего воздуха, °C 20 ± 5 ;

относительная влажность воздуха, %, не более 80.

6.2 Перед проведением поверки выполняют подготовительные работы в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (далее РЭ) на установку.

6.3 Перед проведением поверки с использованием СО проверяют качество сварных швов и отсутствие механических повреждений упаковки СО.

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре установки устанавливают:

- соответствие комплектности требованиям эксплуатационной документации;
- отсутствие видимых внешних повреждений, отрицательно влияющих на работоспособность;
- исправность кнопок управления.

При выявлении дефектов, препятствующих нормальному использованию, установку бракуют и дальнейшую поверку не проводят.

7.2 Опробование

При опробовании проводят проверку работоспособности и операции, предусмотренные в руководстве по эксплуатации (далее РЭ) на поверяемую установку.

Если информация на дисплее установки отсутствует, проводят необходимые операции в соответствии с РЭ.

Проверяют идентификационные данные программного обеспечения: номер версии программного обеспечения (далее ПО). Идентификация программного обеспечения проводится сравнением номера версии ПО, которые высвечиваются при включении установки, с данными, приведенными в описании типа поверяемого средства измерений.

7.3 Определение абсолютной погрешности установления и поддержания температуры

7.3.1 Определение диапазона измерений рабочих температур и абсолютной погрешности установления и поддержания температуры в рабочей зоне проводят с применением измерителя температуры ТЦ-1200 с щупом ТЦЩ-7 при температурах высушивания в сушильной камере $T=105^{\circ}\text{C}$, $T=130^{\circ}\text{C}$ и $T=150^{\circ}\text{C}$.

7.3.2 Определение диапазона измерений рабочих температур и абсолютной погрешности установления и поддержания температуры в рабочей зоне сушильной камеры проводят в следующей последовательности:

7.3.2.1 Устанавливают температуру нагрева $T_{\text{уси}} = 105^{\circ}\text{C}$ в соответствии с эксплуатационной документацией на установку. В сушильную камеру помещают 10 пустых бюкс.

7.3.2.2 Щуп измерителя температуры через первое вентиляционное отверстие опускают в сушильную камеру таким образом, чтобы конец щупа находился чуть выше уровня бюкс. Фиксируют положение щупа зажимом, чтобы предотвратить его смещение вниз или вверх.

П р и м е ч а н и е - Положение щупа можно зафиксировать, поместив зажим на провод щупа, на необходимое расстояние от конца щупа. При проведении измерений необходимо следить, чтобы зажим соприкасался с вентиляционным отверстием.

Плотно закрывают дверцу сушильной камеры.

7.3.2.3 После достижения в сушильной камере установленной температуры и ее стабилизации включают измеритель температуры на 30 с и фиксируют максимальное и минимальное показания измерителя температуры T , $^{\circ}\text{C}$ за 30 с.

7.3.2.4 Переносят щуп во второе отверстие, фиксируют положение щупа. По истечении 2 мин включают измеритель температуры на 30 с и фиксируют максимальное и минимальное показания измерителя температуры T_i , °C.

7.3.2.5 Переносят щуп в третье отверстие, фиксируют положение щупа. По истечении 2 мин включают измеритель температуры на 30 с и фиксируют максимальное и минимальное показания измерителя температуры T_j , °C.

7.3.2.6 Рассчитывают среднее арифметическое результатов измерений температуры по каждому вентиляционному отверстию (T_{omj} , °C) и среднюю температуру в сушильной камере по всем вентиляционным отверстиям (T_{ck} , °C) по формулам:

$$T_{omj} = \frac{\sum_{i=1}^2 T_i}{2}, \quad (1)$$

$$T_{ck} = \frac{\sum_{j=1}^3 T_{omj}}{3}, \quad (2)$$

где j – номер вентиляционного отверстия ($j=1, 2, 3$);

T_i - результат i -го измерения температуры в вентиляционном отверстии с применением измерителя температуры с щупом ТЦЩ-7, °C.

7.3.2.7 Рассчитывают погрешность установления температуры (ΔT_{yem} , °C) по формуле

$$\Delta T_{yem} = |T_{yem} - T_{ck}|, \quad (3)$$

где T_{yem} – температура, установленная на терморегуляторе установки, °C;

T_{ck} - средняя температура в сушильной камере, полученная с применением измерителя температуры с щупом ТЦЩ-7, °C.

7.3.2.8 Рассчитывают погрешность поддержания температуры в сушильной камере (ΔT_n , °C) по формуле

$$\Delta T_n = \max |T_{omj} - T_{ck}|. \quad (4)$$

Полученные значения погрешностей не должны превышать 2,0 °C.

7.3.2.9 Устанавливают температуру $T_{yem}=130$ °C в сушильной камере и проводят операции по п. 5.4.2.

7.3.3 Устанавливают температуру $T_{yem}=150$ °C в сушильной камере и проводят операции по п. 5.4.2.

7.3.4 Установку считают выдержанной поверку, если полученные значения погрешностей установления и поддержания температуры удовлетворяют условиям:

$$\Delta T_{yem} \leq 2,0 \text{ °C}, \quad (5)$$

$$\Delta T_n \leq 2,0 \text{ °C}. \quad (6)$$

7.4 Определение абсолютной погрешности результатов измерений массовой доли влаги

7.4.1 Определение диапазона измерений массовой доли влаги проводят с применением рабочего эталона единицы массовой доли влаги в твердых веществах и материалах (далее эталона) и

(или) стандартных образцов массовой доли влаги (влажности) утвержденного типа. Для проведения измерений используют не менее двух образцов разных культур и (или) продуктов их переработки в зависимости от области применения установки.

Примечание: Допускается проводить поверку в ограниченном диапазоне измерений и на перечне материалов по заявке Заказчика.

7.4.2 Проводят измерения на установке в соответствии с эксплуатационной документацией на нее. Затем отбирают пробы и проводят измерения на эталоне.

7.4.3 Обработка результатов измерений

Обработку результатов измерений проводят по ГОСТ Р 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения».

За результат измерений массовой доли влаги принимают среднее арифметическое значение \bar{W}_j , рассчитанное по формуле

$$\bar{W}_j = \frac{\sum_{i=1}^n W_{ij}}{n}, \quad (7)$$

где W_{ij} – i -результат измерений на установке в j -точке диапазона измерений, %;

n - число измерений, $n \geq 5$.

Среднее квадратическое отклонение результатов измерений S_j определяют по формуле

$$S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (W_{ij} - \bar{W}_j)^2}{n-1}}. \quad (8)$$

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического $S_{\Sigma j}$ определяют по формуле

$$S_{\Sigma j} = \frac{S_j}{\sqrt{n}}. \quad (9)$$

Абсолютную погрешность, %, результатов измерений рассчитывают по формуле

$$\Delta_j = K \cdot S_{\Sigma j}, \quad (10)$$

где К – коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей погрешности и неисключенной систематической погрешности (НСП).

Суммарное среднее квадратическое отклонение $S_{\Sigma j}$, оценки измеряемой величины вычисляют по формуле

$$S_{\Sigma j} = \sqrt{S_{\Theta j}^2 + S_{\Sigma j}^2}, \quad (11)$$

где $S_{\Theta j}$ – среднее квадратическое отклонение НСП, %, которое оценивают по формуле

$$S_{\Theta j} = \frac{\Theta_j}{\sqrt{3}}, \quad (12)$$

где Θ_j – неисключенная систематическая погрешность измерения в j -точке, %.

Неисключенную систематическую погрешность измерения определяют по формуле

$$\Theta_j = |\bar{W}_j - W_{\text{амп}}|, \quad (13)$$

где $W_{\text{амп}}$ – значение массовой доли влаги, установленное с применением эталона в j -точке или значение, указанное в паспорте на стандартный образец, %.

Коэффициент К для подстановки в формулу (10) определяют по формуле

$$K = \frac{\varepsilon_j + \Theta_j}{S_{\varepsilon_j} + S_{\Theta_j}}, \quad (14)$$

где ε_j – доверительные границы случайной погрешности результатов измерений в j -точке, %, определяемые по формуле

$$\varepsilon_j = t \cdot S_{\varepsilon_j}, \quad (15)$$

где t – коэффициент Стьюдента, равный 2,776 при $P=0,95$ и $(n-1) = 4$.

7.4.4 Установку считают выдержавшей поверку, если во всех точках выполняется неравенство

$$|\Delta_j| \leq |\Delta_0|, \quad (16)$$

где Δ_0 – пределы допускаемой абсолютной погрешности установки, указанные в описании типа на установку, %.

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки установки должны быть занесены в протокол, оформленный в соответствии с системой менеджмента качества организации, проводящей поверку.

8.2 На установку, прошедшую поверку с положительным результатом, выдают свидетельство о поверке установленной формы в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» с изменениями, утвержденными Приказом Минпромторга от 28 декабря 2018 г. № 5329. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

8.3 На установку, не прошедшую поверку, выдают извещение о непригодности к применению.

Старший научный сотрудник,
руководитель гр. 243 лаб. 241
ФГУП «УНИИМ»

Е.Г. Парфенова