

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

**Лабораторный совет Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

**Идентификация патогенных бактерий, выделенных
при контроле пищевых продуктов,
с применением системы BAX® System Q7**

Методические рекомендации

№ 02.036-08

Издание официальное

**Москва
2008**

Идентификация патогенных бактерий, выделенных при контроле пищевых продуктов, с применением системы BAX® System Q7: Методические рекомендации. – М.: Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2008. – 37 с.

Разработаны:

У НИИ питания РАМН (Шевелева С.А., Ефимочкина Н.Р., Булахов А.В.); при участии ГОУ ВПО «Московский государственный университет прикладной биотехнологии» (Титов Е.И., Нефедова Н.Е., Ананьева Н.В.)

Рекомендованы к утверждению Лабораторным советом Роспотребнадзора протокол № 2 от 25.06.08).

Утверждены и введены в действие Председателем лабораторного совета, главным врачом ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора А.И.Верещагиным 8.08.2008 г.

Введены впервые.

Содержание

1. Область применения	4
2. Сущность метода	4
3. Общие положения	6
4. Аппаратура, материалы и реактивы	7
5. Подготовка к анализу	9
5.1. Приготовление растворов и реагентов	9
5.2. Приготовление питательных сред	10
6. Выделение и накопление биомассы бактериальных культур, подвергаемых идентификации	12
7. Подготовка образцов чистых культур к анализу	15
8. Проведение лизиса и выделение ДНК	15
9. Подготовка к проведению ПЦР	16
10. Амплификация и детекция	17
11. Оценка результатов	27
12. Особенности проведения работ в ПЦР-лаборатории, контроль за контаминацией	34
13. Библиографические ссылки	36

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»,

Председатель Лабораторного совета

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Марина Галина А.И.Верещагин

«18» августа 2008 г.

MP № 12-636-03

Идентификация патогенных бактерий, выделенных при контроле пищевых продуктов, с применением системы BAX® System Q7

Методические рекомендации

1. Область применения

1.1. Настоящие методические рекомендации устанавливают метод идентификации бактерий, выделенных из пищевых продуктов и продовольственного сырья, и подозрительных на принадлежность к роду *Salmonella*, роду *Campylobacter* (в т.ч. видам *C.jejuni*, *C.coli*, *C.lari*), роду *Listeria* (в т.ч. виду *Listeria monocytogenes*), серотипу *E.coli* O157:H7, на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

1.2. Методические рекомендации предназначены для применения в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке на право проведения исследований пищевых продуктов и продовольственного сырья.

2. Сущность метода

2.1. Метод основан на обнаружении специфических целевых нуклеотидных последовательностей ДНК, присутствующих в микроорганизмах-мишениях, с помощью комплементарных данным последовательностям зондов, меченых флуо-

рессентным красителем, посредством полимеразной цепной реакции в реалы времени

В качестве зондов используются олигонуклеотиды, содержащие на 5'-ко флуорофор-донор флуоресцентного излучения (репортер), а на 3'-конце - его центор (гаситель). При гибридизации с амплифицируемой последовательности ходе ПЦР зонд разрушается за счет 5'-экзонуклеазной активности Т полимеразы, за счет чего происходит разобщение флуорофора и гасителя. Флуоресцентный сигнал репортера вследствие этого усиливается пропорционально числу накапливаемых ампликонов.

По завершении амплификации, температура реакционной смеси повышается до значения, при котором амплифицированные цепи ДНК денатурируют краситель высвобождается, и интенсивность флуоресценции снижается. Эти изменения флуоресценции в рамках созданного пользователем протокола регистрируются (фиксируются) на графике зависимости от температуры в виде криз (кривая накопления продуктов ПЦР или кривая плавления), которая автоматически интерпретируется программным обеспечением системы прибора. Сравнение интенсивности регистрируемого флуоресцентного сигнала в температурных диапазонах расположения пиков на кривой контрольных препаратов и исследуемого образца бактериальной культуры позволяет в реальном времени качественно определить присутствие в нем матричной ДНК микроорганизмов-мишеней. Окончательные результаты отражаются в виде символов разного цвета на специальной панели.

2.2. В качестве положительных контролей используется стандартные препараты ДНК микроорганизмов-мишеней родов *Salmonella*, *Campylobacter* (в т.ч. видаe *C.jejuni*, *C.coli*, *C.lari*), *Listeria* (в т.ч. вида *Listeria monocytogenes*), *Escherichia coli* серотипа O157:H7.

2.3. Измерение флуоресценции производится используемым прибором д. амплификации автоматически с помощью специфичных к красителям свет фильтров в оптической системе прибора. Регистрация результатов методом ПЦР в реальном времени исключает необходимость открывания пробирки после оконч

ния амплификации, что значительно снижает вероятность возникновения контаминации.

3. Общие положения

3.1. Представленный в Методических рекомендациях метод может применяться:

а) для целей ускоренного подтверждения принадлежности выделенных микробиологическими методами культур к бактериям родов *Salmonella*, *Campylobacter* (в т.ч. видов *C.jejuni*, *C.coli*, *C.lari*), *Listeria* (в т.ч. вида *Listeria monocytogenes*), *Escherichia coli* серотипа O157:H7 в качестве дополнительных к биохимическим и серологическим методам идентификации, в том числе:

- при затруднениях идентификации бактерий рода *Salmonella* - взамен расширенного набора биохимических тестов в случаях отсутствия агглютинации культуры с поливалентной диагностической сальмонеллезной О-агглютинирующими сывороткой (A, B, C, D, E) и со смесью О-сывороток редких групп при положительном результате стандартного набора биохимических тестов; при предположительном результате в случае наличия агглютинации с сыворотками редких групп; при положительных результатах серологического исследования и нетипичных результатах биохимических тестов (отклонения по 2 и более признакам);

- при идентификации *Escherichia coli* серотипа O157:H7 - взамен расширенного набора биохимических тестов одновременно с подтверждением серологической принадлежности к серогруппе O157;

- при идентификации *Listeria monocytogenes* - взамен расширенного набора биохимических тестов одновременно с определением наличия лецитиназной и β-гемолитической активности.

б) для одновременного определения принадлежности микроорганизмов, выделенных из пищевых продуктов и продовольственного сырья, к родам *Salmonella*, *Campylobacter* (в т.ч. видам *C.jejuni*, *C.coli*, *C.lari*), *Listeria* (в т.ч. виду *Listeria monocytogenes*), *Escherichia coli* серотипа O157:H7.

3.2. Метод рекомендуется к применению при осуществлении
качества и безопасности пищевых продуктов и продовольственного
сырья, в том числе
Методы не могут применя-
ся при проведении противоэпидемических мероприятий и эпидемиологических
расследований.

4. Аппаратура, материалы, реактивы

4.1. Для идентификации бактериальных культур, выделенных из пищевых продуктов и продовольственного сырья, методом ПЦР в реальном времени, пользуют следующие инструменты и аппаратуру:

- 1) амплификатор с оптической приставкой (типа циклера/детектора Q7 системы BAX®) или другие приборы аналогичного назначения с равноценными техническими характеристиками, допущенные к применению в Российской Федерации;
- 2) компьютер, совместимый с программным обеспечением амплификатора с оптической приставкой, в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью, кабелями компакт-дисками с информацией по эксплуатации и инструкциями по настройке прибора;
- 3) подогреватель;
- 4) вставки в подогреватели для пробирок;
- 5) термометр;
- 6) таймер;
- 7) блоки охлаждающие для ПЦР-пробирок – 2 шт.;
- 8) охлаждающий штатив для пробирок;
- 9) инструменты для надевания/снятия крышечек с ПЦР-пробирок, поставляемые в комплекте (открыватель пробирок);
- 10) держатель для ПЦР-пробирок;
- 11) держатель для охлаждающего блока;
- 12) термостат типа «ТЕРМО 24-15» под пробирки типа Эппendorф вместимостью 1,5 мл, диапазон температур от 15°C до 120°C – 2 шт.;
- 13) холодильник бытовой электрический ГОСТ 26678;
- 14) облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 ТУ 16-535.

- 15) дозаторы автоматические одноканальные переменного объема:
 - 5-50 мкл с шагом 0,5 мкл, с точностью $3,0\pm0,6\%$;
 - 20-200 мкл с шагом 1,0 мкл, с точностью $3,0\pm0,6\%$;
 - 100-1000 мкл с шагом 5,0 мкл, с точностью $1,5\pm0,5\%$;
- 16) пробирки микр центрифужные типа Эппendorф вместимостью 1,5 мл;
- 17) пробирки для ПЦР со съемными крышками;
- 18) плоские крышки для ПЦР-пробирок;
- 19) штативы «рабочее место» для пробирок микр центрифужных типа Эппendorф вместимостью 1,5 мл;
- 20) наконечники с фильтром (насадки) для дозаторов с переменным объемом дозирования до 50; 100; 200; 1000 мкл в штативе,
- 21) контейнер для сброса наконечников;
- 22) анаэробный инкубатор;
- 23) настольная система для анаэробного инкубирования;
- 24) пакеты газогенераторные для микроаэрофильного инкубирования.

Допускается использование другой аппаратуры и инструментария аналогичного назначения, разрешенных к применению в установленном порядке, с характеристиками, обеспечивающими проведение исследований в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями.

4.2. Для идентификации бактериальных культур, выделенных из пищевых продуктов и продовольственного сырья, методом ПЦР в реальном времени используют следующие материалы и реагенты:

- 1) питательные среды для наращивания биомассы идентифицируемых культур и приготовления бактериальных взвесей и их компоненты:
 - мясопептонный агар,
 - триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом,
 - триптон-соевый бульон с дрожжевым экстрактом,
 - кровяной Колумбийский агар,
 - бульон для бруцелл,
 - агар Клиглерса,

- агар Олькеницкого,
- агар Ресселя,
- кровь баранья дефибринированная стерильная;
- основа колумбийского кровяного агара.

2) комплект реагентов (набор на 96 тестов) для выделения ДНК из биома идентифицируемых культур, содержащий:

- лизирующий буфер,
- фермент протеазу.

3) комплект реагентов (набор на 96 тестов) для проведения амплификации, содержащий:

- таблетированную смесь олигонуклеотидных праймеров и нуклеозидтрифостов, полимеразу в ПЦР-пробирках;
- положительный контроль с клонированным специфическим фрагментом Д соответствующих микроорганизмов-мишеней;

4) оптически прозрачные крышки для ПЦР-пробирок;

5) спирт этиловый ректифицированный ГОСТ Р 51652-00;

6) вода дистиллированная ГОСТ 6709-72;

7) перчатки резиновые или латексные неопудренные.

Упаковки с реагентами должны храниться в холодильнике при температуре $(4\pm2)^{\circ}\text{C}$. Замораживание не допускается. Реагенты должны быть использованы истечения срока их хранения, указанного на отдельных для каждого реагента этикетках. После того, как протеаза добавлена к лизирующему буферу, полученный готовый раствор должен храниться при температуре $(4\pm2)^{\circ}\text{C}$, не более двух суток.

5. Подготовка к анализу

5.1. Приготовление растворов и реагентов

5.1.1. Изотонический (0,85 %-ный водный) раствор хлорида натрия готовят в соответствии с ГОСТ 26669-85.

5.1.2. Растворы и реактивы для окраски микроскопических препаратов по Грам готовят по ГОСТ 10444.1 или в соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя

5.1.2. Стерильный фосфатный буфер ($\text{pH } 7.2 \pm 0,1$) готовят в соответствии с нижеследующей прописью:

Ингредиенты	Количество
KH_2PO_4	0,45 г
Na_2HPO_4	5,34 г
Дистиллированная вода	1000 см ³

Стерилизовать при температуре 121°C в течение 30 мин.

5.2. Приготовление питательных сред

5.2.1. Среды промышленного изготовления, поименованные в п. 4.2., готовят согласно прописям на этикетке или в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

5.2.2. Питательный агар с 1 % глюкозы и питательный бульон с 1 % глюкозы (МПА с 1 % глюкозы, МГБ с 1 % глюкозы) готовят в соответствии с ГОСТ 10444.1-84 «Консервы. Приготовление растворов, красок, индикаторов, питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе».

5.2.3. Триптон-соевый бульон с дрожжевым экстрактом, триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом.

Состав сред (г/л): ферментативный гидролизат казеина - 17,0; пептон соевый - 3,0; натрий хлористый - 5,0; фосфат калия однозамещенный - 2,5; глюкоза - 2,5; дрожжевой экстракт - 6,0; агар микробиологический (для TSYEA) - 15,0.

Компоненты растворяют в 1000 см³ дистиллированной воды, тщательно перемешивают, устанавливают $\text{pH } 7,3 \pm 0,2$ и автоклавируют при 121°C в течение 15 мин. Готовые среды разливают в стерильные колбы или пробирки и хранят в защищенных от света условиях при температуре не выше 8°C.

5.2.4. Бульон для бруцелл (неселективный):

Состав основы среды:

Ингредиенты	Количество, г/л
Гидролизат казеина	10,0
Пептический перевар животной ткани	10,0
Дрожжевой экстракт	2,0
Глюкоза	1,0
Натрия хлорид	5,0
Натрия бисульфит	0,1

Используют готовую основу среды промышленного изготовления указанного состава. Приготовление осуществляют согласно прописи на этикетке. Растворить порошок сухой основы в дистиллированной воде. При необходимости подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при температуре 121°C в течение 15 минут. Разлить по пробиркам из расчета 10 мл на 1 пробирку. pH среды после автоклавирования (при 25°C) 7,0 ± 0,2.

5.2.5. Колумбийский кровяной агар (неселективный).

Состав основы среды:

Ингредиенты	Количество, г/л
Пептон (специальный)	23,0
Крахмал кукурузный	1,0
Натрия хлорид	5,0
Агар-агар	15,0

Используют готовую основу среды промышленного изготовления указанного состава. Приготовление осуществляют согласно прописи на этикетке. Растворить порошкообразную сухую основу в дистиллированной воде. Подогреть, кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при температуре 121°C в течение 15 минут. Остудить до 40-50°C и асептически влисти 70 мл стерильной дефибринированной крови барана, тщательно перемешать, разлить в стерильные чашки Петри слоем 4-5 мл. pH среды после автоклавирован (при 25°C) 7,3 ± 0,2.

5.2.6. Трехсахарный железосодержащий агар.

Допускается использование двух модификаций среды: ТСА и среды №13.

Состав сред:

Ингредиенты	Количество, г/л	
	Среда №13	Среда ТСА
Пептический перевар животной ткани	10,0	20,0
Гидролизат казеина	10,0	-
Дрожжевой экстракт	3,0	3,0
Мясной экстракт	3,0	3,0
Лактоза	10,0	10,0
Сахароза	10,0	10,0
Глюкоза	1,0	1,0
Натрия хлорид	5,0	5,0
Железа сульфат	0,2	-
Железа (III) цитрат	-	0,3

Натрия тиосульфат	0,3	-
Натрия тиосульфат (x 5H ₂ O)	-	0,3
Феноловый красный	0,024	0,024
Агар-агар	12,0	12,0

Используют готовые основы сред промышленного изготовления с указанным составом.

Приготовление осуществляют согласно прописям на этикетках. Растворить порошкообразную сухую основу в дистиллированной воде. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Тщательно перемешать и разлить в пробирки для тестирования. Стерилизовать автоклавированием при температуре 121°C в течение 15 минут. Остудить среду в наклонном положении при комнатной температуре для формирования скоса и столбика высотой 2,5 см. pH среды после автоклавирования (при 25°C) 7,4 ± 0,2.

6. Выделение и накопление биомассы бактериальных культур, подвергаемых идентификации

6.1. *Первичный посев для выявления* бактерий рода *Salmonella* в пищевых продуктах проводят согласно утвержденным в установленном порядке методам исследования пищевых продуктов [1-9]. Для определения принадлежности полученных характерных колоний к бактериям рода *Salmonella* отбирают отдельные колонии, выращенные на агаризованных селективно-диагностических средах, которые отвечают следующим требованиям: на висмут-сульфит агаре колонии черные с характерным металлическим блеском, а также зеленоватые с темно-зеленым ободком и с пигментацией среды под колониями; на среде Плоскирева – колонии бесцветные, прозрачные, более плотные, чем на среде Эндо; на среде Эндо колонии круглые бесцветные или слегка розоватые, прозрачные; на среде Левина колонии прозрачные, слабо-розовые или розовато-фиолетовые. При микроскопировании мазков бактерии рода *Salmonella* представляют собой мелкие, прямые бесспоровые палочки с закругленными концами, грамотрицательные.

Для получения чистых культур отбирают не менее 3-х типичных или подозрительных на принадлежность к роду *Salmonella* изолированных колоний, производят посев штрихом на поверхность плотных питательных сред МГА, или

триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом в отдельных чашках Петри, и пробирки с жидкими средами (триптон-соевый бульон с дрожжевым экстракт) инкубируют в течение 24 часов при 37 ± 1 °C.

6.2. *Первичный посев для выявления* бактерий рода *Listeria*, в том числе *Listeria monocytogenes*, в пищевых продуктах проводят согласно утвержденным в установленном порядке методам исследования [10, 11].

Для определения принадлежности полученных характерных колоний *Listeria monocytogenes* отбирают отдельные колонии, выращенные на агаризованных селективно-диагностических средах, которые отвечают следующим требованиям: на ПАЛКАМ-агаре через 24 часа инкубирования листерии формируют мелкие серовато-зеленые или оливково-зеленые колонии с черным ореолом, диаметром 1-2 мм, иногда с черным центром. Через 48 часов колонии имеют диаметр 1,0-2,0 см, приобретают зеленую окраску с углубленными центрами, окруженными чешуйчатым ореолом. На селективном Оксфорд-агаре листерии, выращенные в течение 48 ч, образуют мелкие (1 мм), сероватые, с черным ореолом колонии, через 48 ч формируют более темные, около 2 мм в диаметре колонии с черным ореолом и углублением в центре. При микроскопировании мазков бактерии рода *Listeria* и *Listeria monocytogenes* представляют собой грамположительные неспорообразующие палочки с закругленными концами, иногда почти кокки, одиночные и коротких цепочках, реже в длинных нитях.

Для получения чистых культур отбирают не менее 3-х характерных для бактерий колоний и производят посев шприцом на поверхность плотных питательных сред МПА, или триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом в отдельных чашках Петри или в пробирки с жидкими средами (триптон-соевый бульон с дрожжевым экстрактом) и инкубируют в течение 24 часов при 37 ± 1 °C.

6.3. *Первичный посев для выявления* бактерий рода *Campylobacter* в пищевых продуктах проводят согласно утвержденным в установленном порядке методам исследования [12]. Для определения принадлежности полученных характерных колоний к бактериям рода *Campylobacter* отбирают отдельные колонии, выращенные на агаризованных селективно-диагностических средах, которые

чают следующим требованиям. при росте в микроаэрофильных условиях на поверхности агара Престон, селективного угольного агара, кампилобак-агара образуют мелкие округлые колонии или колонии средних размеров, неправильной формы, как бы растекающиеся по ходу штриха, серые или полупрозрачные с сероватым оттенком, гладкие, влажные, блестящие. При микроскопировании мазков бактерий рода *Campylobacter* - грамотрицательные мелкие, тонкие палочки с одним или более завитками; имеют вид запятой, буквы S, либо галочки при соединении двух клеток. В стареющих культурах (через 48-72 часов инкубации на твердой среде) могут обнаруживаться кокковидные клетки.

Для получения чистых культур отбирают не менее 3-х типичных или подозрительных на принадлежность к роду *Campylobacter* изолированных колоний, производят посев на поверхность кровяного Колумбийского агара или в бульон для бруцелл и инкубируют при 42 ± 1 °С в течение 24-48 часов в микроаэрофильной атмосфере.

6.4. *Первичный посев для выявления* бактерий *E.coli*, в том числе серотипа O157:H7 в пищевых продуктах проводят согласно [3, 13-15]. Для определения принадлежности характерных колоний, выращенных на агаризованных селективно-диагностических средах, к бактериям *E.coli* O157:H7 отбирают отдельные колонии, которые отвечают следующим требованиям: при росте на поверхности Сорбитол-агара, *E.coli* O157:H7-агара – колонии средней величины, выпуклые, круглые, влажные, прозрачные, бесцветные (не ферментирующие сорбит). Могут быть бледно-розовыми со светлым ореолом, мутноватыми. На среде Эндо – колонии средней величины, выпуклые, круглые, влажные, темно-красные, лактозоположительные. При микроскопировании мазков бактерий *E.coli*, в том числе серотипа O157:H7 представляют собой грамотрицательные различной величины бесспоровые палочки.

Для получения чистых культур отбирают не менее 3-х сорбитол-отрицательных колоний, типичных или подозрительных на принадлежность к серотипу O157:H7 *E.coli*, изолированных колоний (или лактозоположительных колоний со среды Эндо) и пересевают на поверхность агаров Клиглера, Олькенин-

кого, Ресселя в пробирках или в триптон-соевый бульон с дрожжевым экстракт
Посевы инкубируют в термостате при 37°C 18-24 часа.

7. Подготовка образцов чистых культур к анализу

Чистые культуры, полученные по п.п. 6.1.-6.4. на плотных питательных с дах, смывают с поверхности агара стерильным физиологическим раствором и . переносят взвесь в стандартную пробирку. Концентрация клеток в суспензии должна быть не менее $5 \cdot 10^6$ клеток/мл, при расчете с использованием оптического стандарта мутности на 5 или 10 единиц.

Приготовленные указанным образом взвеси микроорганизмов или бульевые культуры, полученные по п.п.6.1.-6.4. и содержащие не менее $5 \cdot 10^6$ клеток/мл, подвергают дальнейшим манипуляциям для выделения ДНК. Подготовленные образцы используют для анализа в тот же день.

8. Проведение лизиса и выделение ДНК

Выделение ДНК из образцов исследуемых бактериальных культур проводят с использованием комплекта реагентов, входящих в тест-наборы систем BAX® Q7 для обнаружения патогенов путем ПЦР в реальном времени. Процедура включает следующие этапы:

8.1. Приготовление лизирующего реагента: добавляют 150 мкл протеазы в флаcon с 12 мл лизирующего буфера, наносят на флаcon маркировку с датой приготовления (лизирующий реагент хранится в плотно закрытом флаcone не более двух недель при температуре 2-8°C). Допускается готовить меньший объем лизирующего реагента из расчета 12,5 мкл протеазы на 1 мл лизирующего буфера зависимости от потребности.

8.2. Внесение лизирующего реагента в каждую из пробирок всей группы: заранее промаркированные пробирки для одной идентифицируемой группы микроорганизмов (в том числе для отрицательного и положительного контролей) добавляют по 200 мкл лизирующего реагента.

8.3. Смешивание реагента и суспензий исследуемых культур: вносят по мкл образцов в каждую из подготовленных пробирок всей группы, при этом используют чистые наконечники для каждого образца, включая отрицательный кон-

троль. В качестве отрицательного контроля используют жидкие питательные среды для наращивания биомассы культуры, подвергаемой идентификации, или физиологический раствор.

8.4. Нагревание смеси: помещают штатив с группой пробирок в предварительно нагретый термостат и выдерживают пробирки при следующих режимах:

- 20 мин при 37 ± 2 °C, затем 10 мин при 95 ± 3 °C – для бактерий родов *Campylobacter*, *Salmonella* и серотипа *E.coli* O157:H7;
- 60 мин при 55 ± 2 °C, затем 10 мин при 95 ± 3 °C – для бактерий рода *Listeria* и *Listeria monocytogenes*.

8.5. Охлаждение лизата: вынимают штативы с пробирками из термостата, устанавливают их в охлаждающий блок и выдерживают в течение 5 мин до достижения температуры 2–8°C. Продолжительность всей операции по охлаждению не должна превышать 30 минут, включая подготовку охлаждающего блока (извлечение блока из холодильника и установку в него пробирок).

9. Подготовка к проведению ПЦР

ПЦР-идентификация исследуемых бактериальных культур проводится с использованием таблетированных реагентов, входящих в комплект тест-набора системы BAX® Q7. Процедура подготовки включает следующие этапы:

9.1. Перед началом работы устанавливают охлажденную до 2–8°C вставку для ПЦР-пробирок в охлаждающий блок. Помещают панель для ПЦР-пробирок поверх вставки. Размещают необходимое количество стерильных ПЦР-пробирок с таблетированными смесями ПЦР-реагентов, предназначенных для идентификации соответствующего вида микроорганизмов, в держателе из расчета по одной пробирке на каждый образец.

9.2. Растворение ПЦР-таблеток в лизате: с помощью инструмента для надевания/снятия крышек приоткрывают крышки на пробирках, удаляют их и вносят лизаты культур и контроли в количестве 50 мкл при идентификации бактерий рода *Salmonella*, рода *Listeria*, *Listeria monocytogenes*, *E.coli* O157:H7 или 30 мкл при идентификации бактерий рода *Campylobacter*.

9.3. Тщательно закрывают пробирки новыми оптически прозрачными крышками, не допуская неплотностей: плохо закрытые крышки могут привести к нарушению реакции или получению неправильных результатов. Содержащие пробирки осторожно перемешивают встряхиванием охлаждающего блока для творения ПЦР-габлеток в лизате.

10. Амплификация и детекция

Амплификацию в системе BAX® Q7 проводят по программе, объединяющей стадии отжига и элонгации в один этап

Реакцию проводят в реакционной смеси объемом 50 мкл, включающейся реакционный буфер, адаптированный к используемому типу полимера; смесь нуклеозидтрифосфатов; флуоресцентно-меченные зонды-праймеры; полимеразу.

Амплификацию проводят по программе:

- 1) 1 цикл - 10 мин – 95°C;
- 2) 50 циклов: 20 с – 95°C, 1 мин – 65°C.

Постановка ПЦР в реальном времени сопровождается созданием в используемом приборе для амплификации специального протокола. Используемое устройство системы BAX® Q7 позволяет создавать и выполнять различные программы термоциклирования с одновременным сбором и анализом данных флуоресценции от оптического блока (для разных культур).

10.1. Создание протокола (файла) исследования

10.1.1) Запускают приложение к системе BAX® иконкой на рабочем столе персонального компьютера. На экране появится окно с изображением пустой зорной панели, разделенной на две части: сетка с 96 пустыми ячейками и поле ввода данных (рис.1).

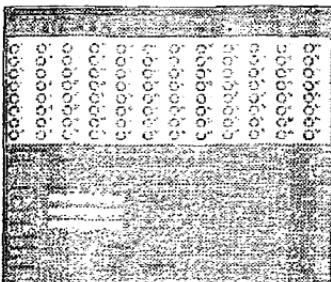


Рис.1. Обзорная панель

10.1.2) Для создания файла, содержащего всю информацию об идентифицируемых образцах, выбирают ФАЙЛ (FILE) > МАСТЕР ЗАПУСКА (RACK WIZARD) в строке меню. Для следования запросам мастера ПЦР, нажимают ДАЛЕЕ (NEXT) или переходят к вводу информации вручную, нажимая ОТМЕНА (CANCEL).

10.1.2.1. Создание файла с помощью мастера ПЦР

1) 1 ступень - выбирают необходимый тип файла: новый («New») или основанный на предыдущем запуске («Based on a previous rack»). Нажимают ДАЛЕЕ (NEXT) для продолжения.

2) 2 ступень - вводят ИМЯ ФАЙЛА («File Name»), МЕТКУ («Label»), ДАННЫЕ ОБ ОПЕРАТОРЕ («Operator ID») и ОПИСАНИЕ («Description») (имя файла по дате анализа вводится автоматически, при необходимости его можно изменить). Нажимают ДАЛЕЕ (NEXT) для продолжения.

3) 3 ступень - выбирают вариант переопределения уже имеющейся информации:

- НЕ МЕНЯТЬ ТЕКУЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ («DON'T CHANGE ANY INFORMATION»)
- ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ ВЫБРАННЫЕ ЯЧЕЙКИ («REDEFINE SELECTED WELLS»)
- ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ ВСЕ 96 ЯЧЕЕК («REDEFINE ALL 96 WELLS»)

Ячейки можно выбрать, кликнув по строке, колонке или отдельной ячейке.

4) Под надписью «ИНФОРМАЦИЯ О ЯЧЕЙКАХ» («WE INFORMATION») выбирают МИШЕНЬ («TARGET») из выпадающего меню. Другие поля служат для ввода НОМЕРА ПАРТИИ (СЕРИИ) («KIT L NUMBER»), СВЕДЕНИЙ ОБ ОБРАЗЦЕ («SAMPLE ID») и ОПИСАНИЯ («DESCRIPTION»), которые указываются при необходимости. После окончания ввода необходимых данных нажимают APPLY. Когда информация обо всех результатах будет введена, нажимают ДАЛЕЕ (NEXT) для продолжения.

5) Если создан новый файл панели, в итоговом окне информация будет представлена подробно. Если импортирован предыдущий файл панели, информация будет представлена в сокращенном виде (рис.2).

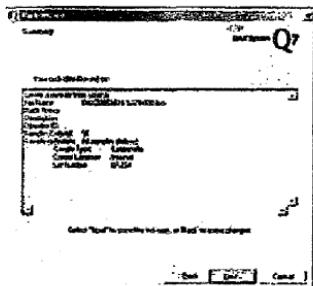


Рис.2. Вид итогового окна

6) После просмотра информации в итоговом окне нажимают ДАЛЕЕ (NEXT) для продолжения, при этом завершающее окно сообщит, что ввод информации о панели закончен. Нажимают «Завершение» (FINISH) для создания файла панели. После того как файл панели создан, содержащуюся в нем информацию можно менять, редактируя определения отдельных ячеек.

10.1.2.2. Создание файла панели вручную

1) На пустой обзорной панели, выбирают команду FILE > SAVE AS строке меню для создания нового файла панели с расширением «.bax».

2) Вводят информацию о панели в нижнюю часть окна:

- Вводят метку для панели («Label») (необязательно). Для перехода на следующее поле нажимают клавишу TAB.
- Вводят сведения об операторе («Operator ID») (необязательно).

- Вводят описание панели («Description») (необязательно).

3) Нажимают APPLY.

После того, как файл панели будет создан, можно редактировать содержащуюся в нем информацию. Однако сам файл не будет изменен, пока не выбрана команда FILE >SAVE в строке меню.

4) Включают обзор ячейки, кликнув по этой ячейке в верхней части окна.

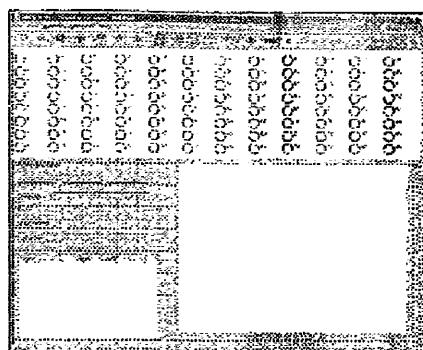


Рис. 3. Обзор данных ячейки

Обзор ячейки можно включить командой VIEW > EDIT WELL INFO в строке меню или кликнув по соответствующему значку на панели инструментов. Можно вернуться к обзору панели командой VIEW > EDIT RACK INFO в строке меню или кликнув по соответствующему значку на панели инструментов.

5) Вводят информацию об образце:

- Если автоматическая нумерация ячеек не используется, кликнув по первой ячейке, вводят сведения об образце («Sample ID»). Нажимают клавишу ENTER для перемещения в следующую ячейку и вводят сведения об образце.
- Выбирают все ячейки с одним и тем же целевым организмом.
Допускается вводить данные о группе ячеек, кликнув по строке или столбцу ячеек. Любые данные, которые будут введены в обзор ячейки, относятся ко всем выделенным ячейкам.
- Выбирают требуемую мишень – целевой организм («Target») из выпадающего меню.

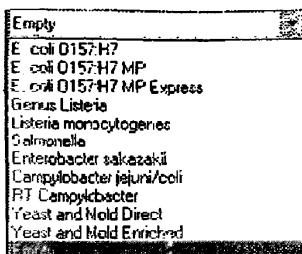


Рис.4 Выбор группы микроорганизмов – мишени

Способ управления ячейками («Control») будет введен автоматически.

Определение бактерий рода *Campylobacter* (*C.jejuni*, *C.coli* and *C.lan*) проводится одновременно с другими мишенями. Если сделать такой выбор, светится соответствующее сообщение об ошибке.



Рис.5. Сообщение об ошибке

- Вводят номер серии набора («Kit Lot Number»).
- В поле описание («Description») может быть введена какая-либо дополнительная информация (при необходимости).

Клавишей TAB можно перейти к следующей ячейке, если на любом из гов нажать клавишу ENTER, можно перейти в следующее поле обзора ячейки.

6) Нажать APPLY для продолжения. В верхней части окна отображения нели синими кружками обозначаются занятые образцами ячейки. Выбирают F > SAVE («Файл» < «Сохранить») в строке меню для сохранения созданного файла.

10.2. Подготовка прибора к работе

10.2.1. Для нагрева прибора до требуемой температуры необходимо пр водить его включение заранее до запуска непосредственно процесса амплиф ции, а именно перед началом процедуры лизиса образцов. Это позволяет про щи запуск анализа немедленно после загрузки охлажденных образцов, как то: в них растворяются ПЦР-таблетки




Рис. 6. Включение прибора

10.2.2. В разделе OPERATION строки меню, выбирают команду RUN FULL PROCESS, активизирующую мастера запуска ПЦР и детекции («PCR and Detection Wizard»), что позволяет начать процесс идентификации.




Рис. 7. Включение процесса амплификации

Примечание: Запустить процесс анализа можно, кликнув на соответствующем значке панели инструментов



Если файл с обзором панели не был сохранен, соответствующее окно укажет на это и предложит сохранить его (с расширением «.bax») до начала процесса. Допускается вводить команду детектировать только часть из амплифицированных образцов, выбрав команду OPERATION >DETECTION ONLY в строке меню или кликнув на соответствующем значке панели инструментов



10.2.3. Появится новое окно, сообщающее о том, что производится предварительный нагрев прибора и предупреждение о том, чтобы Вы не загружали в него образцы.



Рис. 8. Предупреждение о процессе нагрева прибора

Когда требуемая температура будет достигнута, мастер предложит нуть NEXT для продолжения.

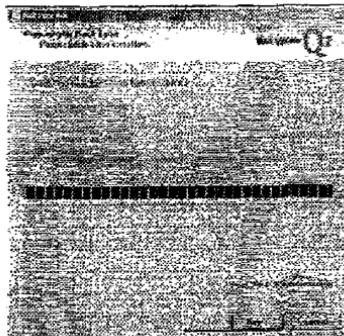


Рис.9. Завершение процесса нагрева

10.3. Загрузка образцов и запуск анализа

10.3.1. Когда необходимая температура будет достигнута, на экране в тится окно «Готовность к загрузке» («Ready for Rack Load»), предлагающее зить образцы, для чего:

10.3.2. Открывают ящик нажатием на ямку с правой стороны.




Рис. 10. Открытие блока амплификатора

10.3.3. Извлекают вставку с ПЦР-пробирками из охлаждающего блока и устанавливают в соответствии с файлом панели в блок амплификатора системы BAX® Q7 при этом работу с охлаждающим блоком необходимо закончить не позже, чем за 30 мин после его извлечения из холодильника. Образцы должны оставаться холодными до момента загрузки в прибор. Пробирки с оставшимся лизатом сохраняют при 2-8 °C до получения результатов анализа, после чего утилизируют автоклавированием.




Рис.11. Установка ПЦР-пробирок в блок амплификатора

10.3.4. Закрывают ящик мягким нажатием на ямку с правой стороны.



Рис.12. Закрытие блока амплификатора

10.3.5. Нажимают NEXT для начала процесса идентификации микроорганизмов.

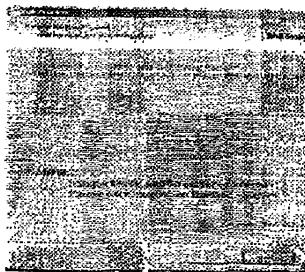


Рис.13. Начало процесса амплификации

Предупреждение: Нагревательный блок ящика ГОРЯЧИЙ. Не прикасайтесь к его горячей поверхности.

10.3.6. В ходе амплификации на экране высвечивается окно «Состоиние процесса ПЦР» («PCR Cycling Status»), отображающее состояние процесса.

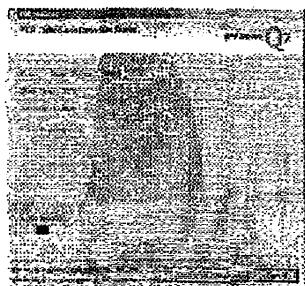


Рис. 14. Отображение состояния процесса амплификации

10.3.7. В процессе детекции на экране отражается окно «Состояние детекции» («Detection Status»). Когда этот этап закончится (When this phase is finished) прибор автоматически отключит наревание блока. Если используется возможность автоматического экспорта данных, файл с ними будет немедленно сохранен в указанной папке.

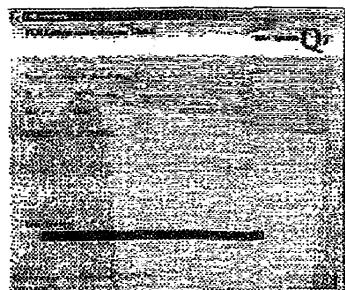


Рис. 15. Завершение процесса идентификации

Примечание: Это сообщение не отображается, когда запущена ПЦР в режиме реального времени (определение бактерий рода *Campylobacter*), т.к. детекция в этом случае производится одновременно с амплификацией.

10.3.8. По окончании процесса детекции на экране вы светится окно «Выгрузка», предлагающая извлечь из прибора образцы. Для этого открывают ящик нажатием на ямку с правой стороны прибора и аккуратно удаляют держатель с ПЦР-пробирками. Помещают образцы в пакет и хранят в холодильнике, пока не будет закончено рассмотрение результатов, затем пробирки утилизируют в соответствии с МУ 1.3.1888-04 «Организация работы при исследованиях методом ПЦР материала, инфицированного патогенными биологическими агентами III-IV групп патогенности».

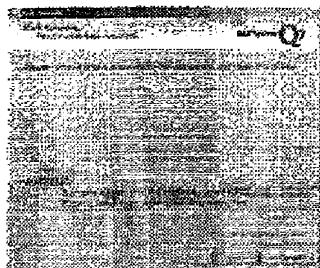


Рис. 16. Сообщение о возможности открыть амплификатор и извлечь образцы

10.3.9. На экране вы светится окно «Нормальное окончание процесса» («Process Completed Normally»). Нажимают «FINISH» для просмотра результатов, полученных для исследуемых образцов.

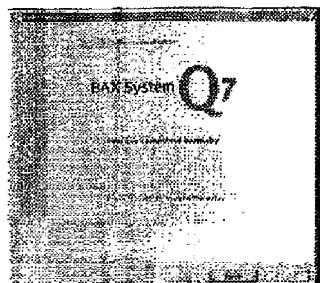


Рис. 17. Переход в режим просмотра результатов

Программа всего процесса, включая амплификацию и детекцию, требует около трех с половиной часов. Для исследования методом ГПР в режиме реального времени (определение бактерий рода *Campylobacter*), когда детекция сопряжена с амплификацией, длительность процесса составляет не более 90 мин.

11. Оценка результатов

11.1. Результаты идентификации патогенных микроорганизмов отражаются на экране компьютера в сохраненном файле в виде панели, содержащей ячейки окрашенные разными цветами с определенным символом, значения которых интерпретируются в соответствии с таблицей.

Оценка результатов анализа

Значки	Цвет	Результат
	Зеленый (-)	Отрицательный для организма-мишени
	Красный (+)	Положительный для организма мишени
	Желтый (?)	Неопределенный результат
	Желтый (?), перечеркнутый красным	Сообщение об ошибке

11.2. Результаты анализа по каждой исследуемой пробе проверяют также путем выбора и просмотра данных в соответствующих отдельных ячейках (из группах ячеек). Полученные результаты можно видеть на сером поле окна представления результатов или в списке.

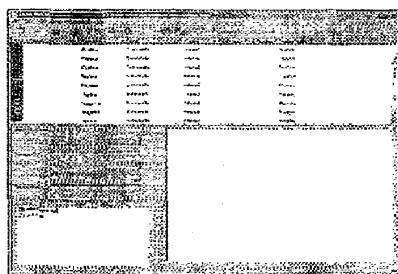
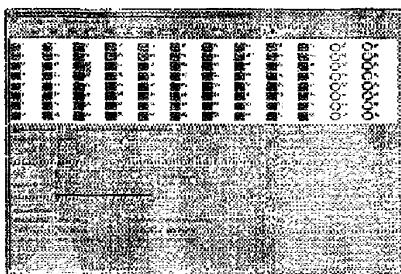


Рис. 18. Просмотр результатов анализа

На листе с результатами в нижней части окна содержатся данные о целевых организмах и положительном контроле.

11.3. Дополнительно оценку результатов анализа проводят с учетом характера кривых плавления, которые отражаются на графике в правой части окна, и характеризуют зависимость интенсивности флуоресценции от температуры. Графики кривых плавления содержат целевые пики и контрольные пики.

Целевые пики – пики на кривой плавления в соответствующих температурных рамках при положительной реакции. Пики не должны выходить за пределы установленных рамок, но при сильно положительных реакциях пик может немного смещаться к пределу с более низкой температурой, при слабо положительных реакциях – к пределу с более высокой температурой.

Контрольные пики – пики, находящиеся в рамках от 78 до 80°C и различающиеся по высоте в зависимости от количества мишени. При очень большом количестве клеток мишени контрольные пики могут быть очень маленькими или отсутствовать.

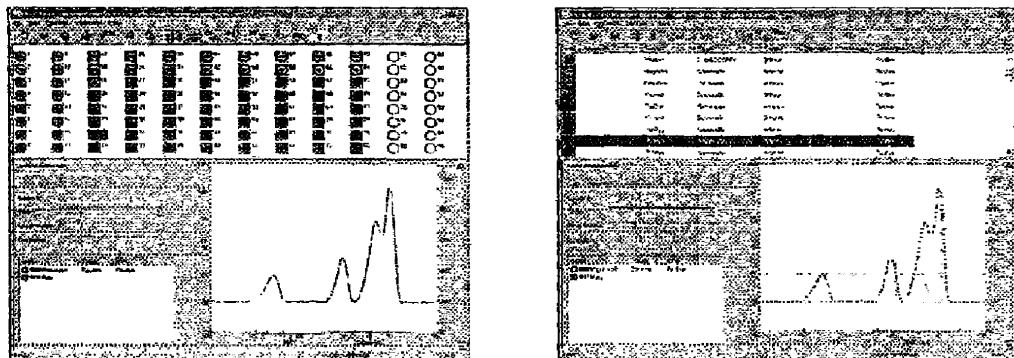


Рис. 19. Примеры форм вывода данных о результатах анализа на монитор

11.4. Оценка результатов при идентификации бактерий рода *Salmonella*

Кривая плавления для положительной реакции на бактерии рода *Salmonella* характеризуется тремя целевыми пиками на 85, 88 и 90 °C и наличием разницы между первым и третьим пиками не более 5 °C. При этом температурный диапазон составляет от 84 до 92 °C. Температурный диапазон контрольного пика составляет 75-83 °C.

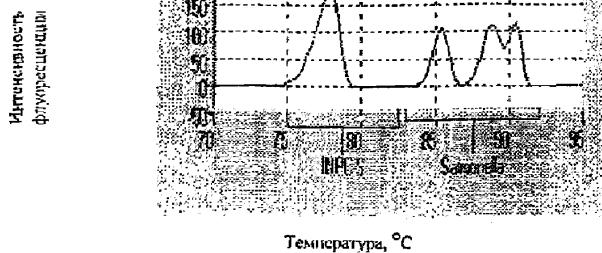


Рис. 20. Типичный график кривых плавления при получении положительных результатов – при обнаружении бактерий рода *Salmonella*

Кривая плавления для отрицательной реакции на бактерии рода *Salmonella* характеризуется отсутствием целевых пиков и высоким контрольным пиком

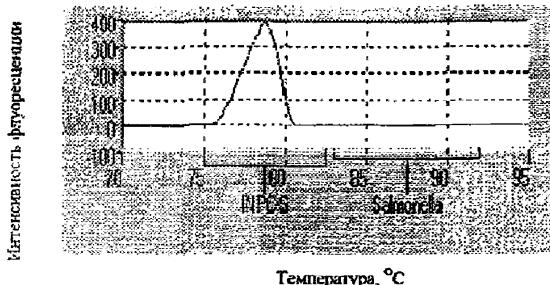


Рис.21. Типичный график кривых при отсутствии бактерий рода *Salmonella*: следующей пробе

*11.5. Оценка результатов при идентификации *E. coli* O157:H7*

Кривая плавления для положительной реакции на *E. coli* O157:H7 характеризуется двумя целевыми пиками на 85 и 88,5 °C и наличием разницы между первым и вторым целевыми пиками в 3,5 °C. Температурный диапазон при этом составляет от 84 до 90°C. Обычно, первый пик ниже и шире второго, преобладающего пика. Температурный диапазон контрольного пика составляет 77-82 °C

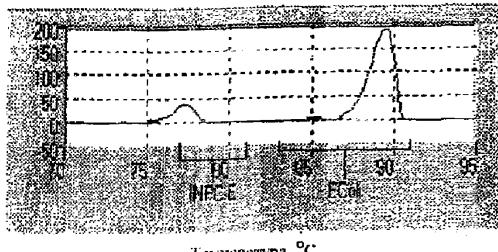


Рис.22. Типичный график кривых плавления при получении положительного результата – при обнаружении *E. coli* O157:H7

Кривая плавления для отрицательной реакции на *E. coli* O157:H7 характеризуется отсутствием целевых пиков и наличием крупного контрольного пика.

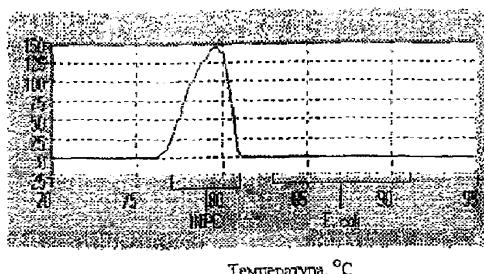


Рис.23. Типичный график кривых при отсутствии бактерий *E. coli* O157:H7 в исследуемой пробе

*11.6. Оценка результатов при идентификации *Listeria monocytogenes**

Кривая плавления для положительной реакции на *L. monocytogenes* характеризуется одним целевым высоким пиком на 85°C. Температурный диапазон составляет от 83,5 до 86°C. Температурный диапазон контрольного пика составляет 77-81°C. Часто контрольный пик для *L. monocytogenes* выглядит как двойной.

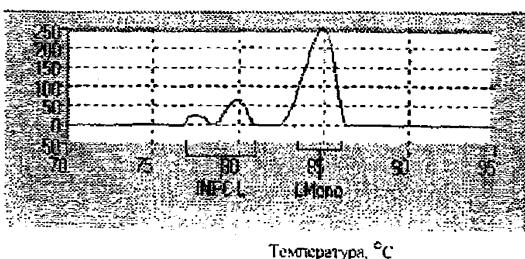


Рис.24. Типичный график кривых плавления при получении положительного результата – при обнаружении *L. monocytogenes*

Кривая плавления для отрицательной реакции на *L.monocytogenes* характеризуется отсутствием целевого пика с крупным контрольным пиком.

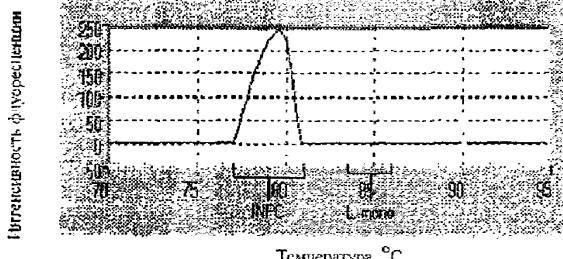


Рис.25. Типичный график кривых плавления при отсутствии бактерий *L. monocytogenes* в исследуемой пробе

11.7. Оценка результатов при идентификации бактерий рода *Listeria*

Кривая плавления для положительной реакции на бактерии рода *Listeria* характеризуется одним целевым пиком на 85,5°C. Температурный диапазон составляет от 83,5 до 87°C. Температурный диапазон контрольного пика составляет 81 °C.

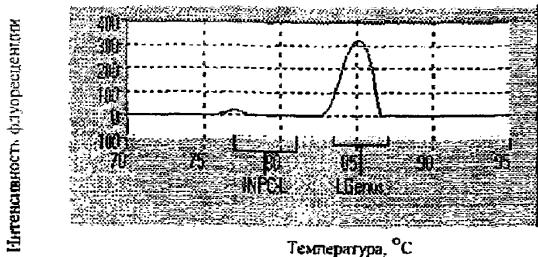


Рис.26. Типичный график кривых плавления при получении положительного результата – при обнаружении бактерий рода *Listeria*

Кривая плавления для отрицательной реакции на род *Listeria* характеризуется отсутствием целевых пиков и наличием крупного контрольного пика.

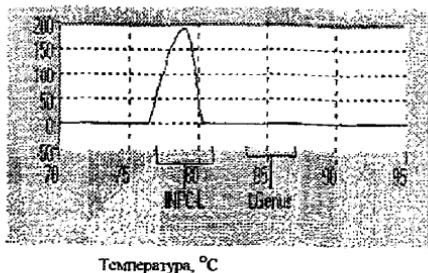


Рис.27. Типичный график кривых при отсутствии бактерий рода *Listeria* в исследуемой пробе

11.8. Оценка результатов при идентификации *Campylobacter jejuni/coli/lari*

Результаты идентификация *Campylobacter jejuni/coli/lari* дополняются количественным определением содержания клеток организма-мишени. Результаты идентификации представлены в верхней части окна в виде разноцветных значков. В нижней части окна представления результатов справа представлены графики, отображающие накопление продуктов амплификации для каждой мишени.

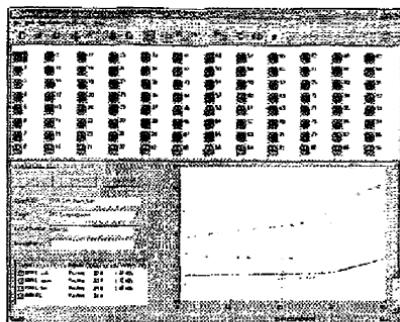


Рис.28. Пример формы вывода данных о результатах анализа на монитор

В нижней части окна представления результатов слева обозначены цветом данные для каждого целевого организма (C.coli, C.jejuni, C.lari):

- Target – проанализированные мишени, перечисленные в правой графе
- Result – положительный или отрицательный качественный результат
- Ct – номер цикла, в котором получен флуоресцентный сигнал, превышающий пороговый уровень

- CFU/ml – количественные данные о концентрации целевого организма в исходном образце (взятом для лизиса).

Если концентрация клеток организма-мишени не достаточна для количественного определения, результат будет представлен как "< 1.0E+04 for concentrations below the range" в случае, когда содержание клеток в биомассе ниже порогового уровня, или ">1.0E+09 for concentrations above the range", в случае, когда содержание клеток в биомассе превышает пороговый уровень.

11.9. Оценка невалидных результатов

В случаях, когда процесс лизиса и/или амплификации были проведен ошибками, могут возникнуть невалидные результаты, обозначенные значками или ②. Возникновение невалидных результатов может быть вызвано следующими причинами:

1. Размещение группы пробирок с образцами в ряду держателя, не соответствующее указанному в текущем файле панели. Для устранения данной проблемы заново маркируют ячейки в этом файле в соответствии с действительным расположением образцов в держателе, и выбирают команду OPERATION REANALYZE WELLS в строке меню. Данные о ячейках будут переопределены, как указано.

2. Нестабильное электропитание прибора или центрального процессора необходимо убедиться в правильности подключения прибора к электросети, занять ПЦР-пробирку и повторить анализ. Можно также установить шумоподавитель или сетевой фильтр между источником бесперебойного питания и прибором.

3. Нарушение второго этапа процедуры лизиса (95°C) или отсутствие пробирки в пробирке. Необходимо проверить температуру нагрева термостата, которая должна составлять $95\pm2^{\circ}\text{C}$, вставив термометр в один из двух термоблоków нагревателя.

4. Ошибка в работе прибора, для преодоления которой необходимо провести проверку работы оптической системы и при необходимости обратиться в службу технической поддержки.

12. Особенности проведения работ в ПЦР-лаборатории, контроль за контаминацией

Процесс амплификации приводит к накоплению миллионов копий фрагмента ДНК, специфичного для целевого организма. При открытии ПЦР-пробирок эти копии с аэрозолем и жидкостью распространяются по лаборатории. Система BAX[®] System Q7 с автоматизированной детекцией решает эту проблему, позволяя работать только с закрытыми пробирками. Для снижения риска распространения ампликонов и предотвращения контаминации необходимо соблюдать ниже перечисленные правила работы в соответствии с [16]:

- Не открывать ПЦР-пробирки после амплификации.
- Перед входом в рабочую зону снимать уже использованные перчатки. Заранее готовить новые перчатки, перед тем как покинуть рабочую зону.
- Сбрасывать наконечники с пипеток в пластиковый пакет и выносить его после каждого использования из рабочей зоны.
- Промывать рабочую зону после каждого использования дезинфицирующим средством («Дезолон» и др.).
- Для биологической защиты рабочей зоны использовать ультрафиолетовые облучатели до и после работы.
- Автоклавировать пипетки еженедельно согласно рекомендациям производителя (121 °C в течение 30 мин).
- Обрабатывать охлаждающие блоки в следующей последовательности: обработать дезинфицирующим средством («Дезолон» и др.), ополоснуть водой и протереть сухой салфеткой перед размещением в холодильнике.

Работы с системой BAX[®] Q7 включает использование вместе с исследуемыми образцами «чистой» пробы, которая служит отрицательным контролем анализа. Положительный результат для «чистой» пробы означает контаминацию.

Если контаминация произошла, вся рабочая зона должна быть тщательно вымыта. Для этого необходимо надеть перчатки и следовать перечисленным указаниям:

- Протереть наружные поверхности раствором дезинфицирующего средства тавить жидкость на поверхности примерно на 10 мин, затем вытереть насух норазовыми салфетками. После этого протереть поверхности 70%-ным этил спиртом. Облучить поверхности ультрафиолетом в течение ночи.
- Утилизировать все расходные материалы (наконечники для пипеток, реагентов и т.д.), которые были извлечены из упаковок и частично израсходованы, путем автоклавирования в соответствии с МУ 1.3.1888-04 «Организация при исследованиях методом ПЦР материала, инфицированного патоген биологическими агентами III-IV групп патогенности».
- Очистить наружные поверхности всех используемых приборов и инструментов (термоциклер, пипетки и т.д.) с применением дезинфицирующего средства спирта.
- Проавтоклавировать пипетки и все использованные инструменты и приспособления, стойкие к автоклавированию, в соответствии с рекомендациями производителей (121 °С в течение 30 мин).

13. Библиографические ссылки

1. Методические указания «Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды», Москва, ВО «Агронромиздат», 1990, 59 с.
2. ГОСТ 30519-97 (ГОСТ Р 50480-93) «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*».
3. МУК 4.2.577-96 «Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов».
4. ГОСТ 7702.2.3-93 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления сальмонелл».
5. ГОСТ Р 50455-92 «Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбитражный метод)».
6. ГОСТ 21237-75 «Мясо. Методы бактериологического анализа».
7. ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа».
8. ГОСТ 30712-2001 «Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа. Межгосударственный стандарт».
9. Методические указания МУК 4.2.762-99 «Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом».
10. МУК 4.2.1122-02 «Организация контроля и методы выявления бактерий рода *Listeria monocytogenes* в пищевых продуктах».
- 11 ГОСТ Р 51921-2002 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий *Listeria monocytogenes*».
12. МУК 4.2.2321-08 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы определения бактерий рода *Campylobacter* в пищевых продуктах».
- 13 МУК 4.2.992-00 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы выделения и идентификации энтерогеморрагической кишечной палочки *E.coli O157:H7*».

- 14 ГОСТ 30726-2001 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий рода *Escherichia coli*».
15. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами» 1984
- 16 Организация работы лабораторий, проводящих исследования с патогенными биологическими агентами III—IV групп патогенности методом полимеразной цепной реакции. МУ 1.3.1888—04.