

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

**ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА (ВНИИМ)**

**М Е Т О Д И К А
ПОВЕРКИ ОБРАЗЦОВЫХ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ НИЗКИХ АБСОЛЮТНЫХ
ДАВЛЕНИЙ
МИ III-76**

Москва — 1977

**РАЗРАБОТАНА Всесоюзным орденом Трудового Красного Знамени
научно-исследовательским институтом метрологии им. Д. И. Мен-
делеева (ВНИИМ)**

Директор Тарбасов Ю. В.

Руководитель темы Рыжков В. А.

Исполнитель Ильин В. Н.

**ПОДГОТОВЛЕНА К УТВЕРЖДЕНИЮ Лабораторией законодатель-
ной метрологии ВНИИМ**

Руководитель лаборатории Селиванов М. Н.

Исполнитель Соколова Е. А.

**УТВЕРЖДЕНА Научно-техническим советом ВНИИМ 29 марта
1976 г. (протокол № 6)**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ОБРАЗЦОВЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НИЗКОГО АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ**

МИ 111—76

Настоящая методика распространяется на образцовые средства измерений абсолютного давления в диапазоне 10^{-3} — 10^3 Па ($\sim 10^{-5}$ — 10 мм рт. ст.) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице.

Наименование операции	Номера пунктов методики
Внешний осмотр	4.1
Проверка герметичности	4.2
Определение постоянной компрессионного манометра	4.3
Определение погрешности шкалы отсчетного устройства компрессионного манометра	4.4
Определение чувствительности мембранны-емкостного манометра	4.5
Определение коэффициента преобразования манометрического преобразователя мембранны-емкостного манометра	4.6
Проверка ухода нуля мембранны-емкостного манометра	4.7
Определение объемов измерительных резервуаров установки с калиброванными объемами	4.8
Определение погрешности образцового средства измерений	4.9

При **мечани**е. Поверка вольтметра от 0 до 1000 В, класса 0,2, встроенного в мембранны-емкостный манометр, проводится по Инструкции 184—62 «Пс поверке амперметров, вольтметров, ваттметров, варметров». Поверка манометра, встроенного в установку с калиброванными объемами, проводится по ГОСТ 8.161—73.

©Издательство стандартов, 1977

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. Для поверки образцовых средств измерений низкого абсолютного давления должны применяться следующие средства:

Государственный специальный эталон единицы давления для области низких абсолютных давлений по ГОСТ 8.107—74;

набор компрессионных манометров 1-го Разряда по ГОСТ 8.107—74;

образцовый вольтметр постоянного тока от 0 до 1000 В, класса 0,2;

образцовые шкалы 2-го разряда по ГОСТ 8.020—75;


образцовые гири 2-го разряда по ГОСТ 14636—69;

термометр с пределами измерений от 15 до 25°C по ГОСТ 2045—43;

откачной вакуумный пост с калиброванными резервуарами (рисунок), позволяющий получать давление $\sim 10^{-4}$ Па ($\sim 10^{-6}$ мм рт. ст.);

образцовый вакуумметр, класса 0,16 по ГОСТ 6521—72;

течесискатель с чувствительностью не менее 10^{-7} л мкм/с.

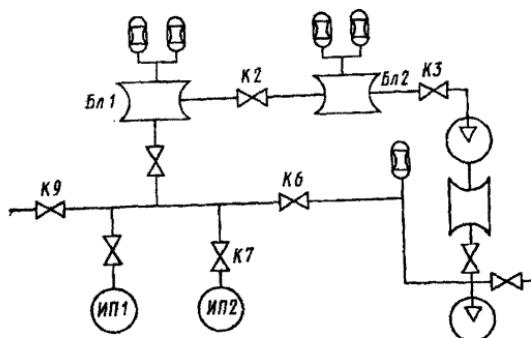

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

атмосферное давление 750 ± 30 мм рт. ст.;

относительная влажность воздуха при температуре 20°C $65 \pm 15\%$;

напряжение сети $220 \pm 4,4$ В;

частота $50 \pm 0,5$ Гц;

содержание гармоник, не более 5%;

температура воздуха $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ (при скорости изменения ее не более $0,3^{\circ}\text{C}$ в час).

Температуру воздуха следует измерять на расстоянии не более 0,5 м от поверяемого и образцового приборов на высоте не более 0,5 м над ними.

До начала поверки поверяемый и образцовый приборы должны находиться на рабочем месте 6 ч при температуре окружающего воздуха, указанной выше.

3.2. За 6 ч до начала поверки компрессионных манометров в резервуары для ртути заливают ртуть марки Р-1.

3.3. За 30 мин до начала поверки компрессионных манометров производят 3—4 подъема и опускания ртути.

3.4. Для охлаждения высоковакуумных насосов необходимо обеспечить подачу воды.

3.5. Поверку производят по азоту в статическом режиме.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемых приборов следующим требованиям:

корпус прибора и литые детали не должны иметь дефектов, ухудшающих внешний вид прибора;

не должно быть прямого доступа к токоподводящим линиям; отсчетное устройство должно иметь заводской номер; соединительные кабели не должны иметь повреждений.

На маркировочной табличке прибора должны быть нанесены: товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, заводское обозначение прибора, его номер и год выпуска; перемещение всех подвижных частей должно быть плавным, без рывков и заеданий;

нулевые отметки на шкалах должны совпадать с соответствующими индексами;

шкалы с подсветкой должны иметь осветительные лампочки.

4.2. Проверка герметичности

Проверку герметичности поверяемого прибора производят гелиевым течеискателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации течеискателя.

4.3. Определение постоянной компрессионного манометра

Постоянную образцового манометра 1-го разряда, равную отношению площади поперечного сечения канала измерительного капилляра к начальному объему сжатия, определяют непосредственным сличием с эталонным компрессионным манометром.

Поверку образцового компрессионного манометра 2-го разряда производят непосредственным сличием с манометром 1-го разряда. Перед определением постоянной необходимо убедиться в правильности геометрической формы канала капилляра на всей его длине путем последовательного подъема ртути в измерительном капилляре при одной отсечке газа.

Значение переменной hH должно удовлетворять условию

$$\frac{(hH)_{\max} - (hH)_{\min}}{(hH)_{\min}} < 0,005, \quad (1)$$

где h — высота сжатого газа в измерительном капилляре, м ($h_{\min} \geq 0,007$);

H — разность уровней менисков ртути в измерительном и сравнительном капиллярах, м ($H_{\min} \geq 0,007$).

Постоянную манометра определяют не менее чем для трех равномерно распределенных значений давления диапазона измерений m при числе измерений в каждой серии n_j не менее 20.

Постоянную k_i поверяемого манометра рассчитывают по формуле

$$k_i = \left(\frac{p}{hH + \frac{hp}{\rho_t g}} \right)_i, \quad (2)$$

где p — давление по образцовому манометру, Па;

ρ_t — плотность ртути при температуре измерения, кг/м³;

g — ускорение свободного падения, м/с².

Среднее значение \bar{k} равно

$$\bar{k} = \frac{1}{m} \sum_1^m \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} k_i. \quad (3)$$

Среднее квадратическое отклонение $S_{\text{нов}}$ определяют по формуле

$$S_{\text{нов}} = \sqrt{\frac{\sum_1^m \sum_1^{n_j} (k_i - \bar{k})^2}{mn(mn-1)}}. \quad (4)$$

Погрешность определения постоянной манометра δ определяют по формуле

$$\delta = \delta_{\text{обр}} + 2,5 S_{\text{нов}}, \quad (5)$$

где $\delta_{\text{обр}}$ — предел допускаемой относительной погрешности образцового манометра.

4.4. Определение погрешности шкалы отсчетного устройства компрессионного манометра

Определение погрешности шкалы отсчетного устройства производят сличием со штриховыми мерами 2-го разряда.

Предел допускаемой погрешности шкалы отсчетного устройства не должен превышать 0,05 мм.

4.5. Определение чувствительности мембранны-емкостного манометра

Чувствительность манометра определяют при давлении в обеих камерах не более $\sim 6 \cdot 10^{-4}$ Па ($\sim 5 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.) методом подачи напряжения, равного 10 В, между компенсационным электродом и мембраной.

Отклонение стрелки нуль-индикатора блока питания должно быть не менее 10% шкалы.

4.6. Определение коэффициента преобразования манометрического преобразователя мембранны-емкостного манометра

4.6.1. Коэффициент преобразования манометрического преобразователя определяют сличением поверяемого и эталонного манометров при名义ном давлении $1 \div 2 \cdot 10^{-1}$ мм рт. ст. при числе измерений не менее 20.

Коэффициент преобразования \bar{C} определяют по формуле

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{U_i^2}{p_i}, \quad (6)$$

где U_i — напряжение компенсации при i -м измерении, В;

p_i — давление, определяемое по эталонному манометру, Па;
 n — число измерений.

4.6.2. Линейность градуировочной характеристики преобразователя во всем рабочем диапазоне определяют следующим образом. Вакуумную систему (см. рисунок) откачивают до давления $\sim 6 \cdot 10^{-4}$ Па ($\sim 5 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.), закрывают клапаны $K2$, $K3$, $K6$, $K7$ и натекателем $K9$ создают в резервуаре $Бл1$ давление p_1 , близкое к верхнему пределу измерений. Отсчет производят по поверяемым приборам $ИП1$, $ИП2$. Известно, что $p_{1t} = k_t U_{1t}^2$, (7)

$$\text{где } k_t = \frac{1}{C_t}. \quad (8)$$

Открывают клапан $K2$, измеряют давление $p_{2t} = k_t U_{2t}^2$. (9)
По закону Бойля—Мариотта

$$p_1 V_1 = p_2 (V_1 + V_2), \quad (10)$$

где V_1 и V_2 — объемы резервуаров $Бл1$ и $Бл2$, соотношение объемов

$$\frac{V_2}{V_1} \approx 5.$$

Преобразуя формулу (8) и подставив p_1 и p_2 , получают

$$\frac{p_{1t}}{p_{2t}} = \frac{k_t U_{1t}^2}{k_t U_{2t}^2} = \frac{V_1 + V_2}{V_1}. \quad (11)$$

Понижая несколько раз начальное давление на полпорядка, получают ряд значений

$$\frac{p_{11}}{p_{21}} = \frac{p_{12}}{p_{22}} = \frac{p_{13}}{p_{23}} = \dots = \frac{k_1 U_{11}^2}{k_1 U_{21}^2} = \frac{k_2 U_{12}^2}{k_2 U_{22}^2} = \frac{U_{13}^2}{U_{23}^2} = \dots = \frac{V_1 + V_2}{V_1}.$$

Условие выполняется при постоянстве коэффициента k во всем рабочем диапазоне. Если отклонение отношения показаний манометра $\left(\frac{U_1}{U_2}\right)_t$ от его среднего значения

$$\left(\frac{\bar{U}_1}{\bar{U}_2}\right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{U_i}{U_2}\right)_t^2$$

более 5%, то манометрический преобразователь бракуют.

4.7. Проверка ухода нуля мембранные-емкостного манометра

Проверку ухода нуля производят при давлении в обеих камерах не выше $\sim 6 \cdot 10^{-4}$ Па ($\sim 5 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.).

Уход нуля манометра за 1 ч не должен превышать 30% шкалы нуль-индикатора.

4.8. Определение объемов измерительных резервуаров установки с калиброванными объемами

4.8.1. В установку с калиброванными объемами входят большие V_b и малые V_m измерительные резервуары.

Большой измерительный резервуар V_b герметично подсоединен к дополнительному резервуару с известным объемом V_0 , снабженным образцовым манометром класса 0,16 с диапазоном измерения 0—760 мм рт. ст. Резервуары с известным объемом заполняют атмосферным воздухом, а поверяемый — откачивают до давления $p \leq 10^{-1}$ Па ($\sim 10^{-3}$ мм рт. ст.), давление контролируют по термопарному вакуумметру. Соединяют резервуары и измеряют давление p_1 по образцовому манометру.

Объем большого измерительного резервуара V_b рассчитывают по формуле

$$V_b = V_0 \frac{p_{\text{атм}} - p_1}{p_1}. \quad (12)$$

Примечание. Объем V_0 соизмерим с объемом поверяемого манометра. Погрешность определения V_0 должна быть не более 0,2% (см. инструкцию 31-64 «По поверке мер вместимости стеклянных технических 1-го и 2-го классов»).

4.8.2. Измерение объема малых измерительных резервуаров производят следующим образом.

В калиброванных резервуарах создают давление, равное атмосферному ($p_{\text{атм}}$). Соединяют с этими резервуарами предвари-

тельно откачанный малый измерительный резервуар, заполняют калиброванные резервуары жидкостью с низкой упругостью паров до тех пор, пока давление в системе не установится и станет равным первоначально измеренному ($p_{\text{атм}}$), и вычисляют измеряемый объем по формуле

$$V_m = V_{k01} + V_{k02}, \quad (13)$$

где V_{k01} и V_{k02} — отсчет по шкалам калиброванных резервуаров.

Погрешность определения объемов должна быть не более 0,2%.

Описание операций, производимых при определении объемов малых резервуаров, приведено в приложении 1.

4.9. Определение погрешности образцового средства измерений

4.9.1. Погрешность компрессионного манометра обусловлена: систематической погрешностью, вызванной разностью депрессии ртути в капиллярах манометра. Разность депрессий ртути в капиллярах манометра определяют путем многократных сравнений уровней ртути в капиллярах с уровнем ртути в параллельной капиллярам широкой трубке при давлениях меньших на два порядка нижнего предела измерения манометра. Значение поправки ($\bar{\Delta}_1$), обусловленной разностью депрессий ртути, должно быть внесено в уравнение измерения давления, приведенное в приложении 2;

систематической погрешностью ($\bar{\Delta}_2$), вызванной отличием формы запаянного конца измерительного капилляра от формы мениска ртути; поправку определяют путем многократных измерений уровней ртути в капиллярах манометра при одной отсечке ртути и подъеме ее ступенями в исследуемом манометре; значение поправки должно быть также внесено в уравнение измерения (приложение 2); погрешностью, вызванной случайным разбросом показаний манометра. Случайную погрешность образцового компрессионного манометра 1-го разряда определяют сличением с однотипным эталонным манометром при одновременной «отсечке» газа, подвергаемого сжатию. Образцовые манометры 2-го разряда сличают с манометрами 1-го разряда.

Среднее квадратическое отклонение $S_{\text{пов}}$ определяют по формуле

$$S_{\text{пов}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (p_{i \text{ пов}} - p_{i \text{ обр}})^2}{n(n-1)}}, \quad (14)$$

$p_{i \text{ пов}}$ и $p_{i \text{ обр}}$ — i -е измерение по поверяемому и образцовому манометрам.

Допускаемую относительную погрешность поверяемого манометра определяют по формуле (4).

Предел допускаемой относительной погрешности $\delta_{\text{доп}}$ не должен быть более 6% для манометров 1-го разряда и 15% — для манометров 2-го разряда.

4.9.2. Случайную погрешность образцового мембранны-емкостного компенсационного манометра определяют сличением его с эталонным мембранны-емкостным и эталонным компрессионным манометром в диапазоне давлений 65—13 Па ($\sim 5 \cdot 10^{-1}$ — $1 \cdot 10^{-1}$ мм рт. ст.) при $n \geq 20$.

При этом компрессионный манометр должен быть снабжен устройством, устраняющим откачивающее действие паров ртути, и разделительными охлаждаемыми ловушками.

Допускаемая относительная погрешность образцового мембранны-емкостного компенсационного манометра вычисляют по формулам (5) и (14). Предел допускаемой относительной погрешности $\delta_{\text{доп}}$ образцового мембранны-емкостного манометра не должен быть более 6%.

4.9.3. Определение погрешности установки с калиброванными объемами.

Погрешность установки с калиброванными объемами определяют сравнением расчетного значения давления, получаемого на поверяемой установке, с показаниями эталонного мембранны-емкостного манометра

$$p_{1 \text{ пов}} = \alpha \gamma \left[1 - (\alpha + \beta + \gamma) + \frac{\epsilon_0}{\alpha \gamma} \right] p_1, \quad (15)$$

$$\text{где } \alpha = \frac{V_{M1}}{V_{61}}; \beta = \frac{V_{M2}}{V_{61}}; \gamma = \frac{V_{M2}}{V_{62} + V_{\text{эт}}}; \epsilon_0 = -\frac{p_1}{p_0};$$

$V_{M1}, V_{61}, V_{M2}, V_{62}$ — объемы измерительных резервуаров установки с калиброванными объемами (см. п. 4.8 настоящей методики);

$V_{\text{эт}}$ — объем камеры эталонного манометра, указанный в свидетельстве на него;

p_0 — остаточное давление, измеренное образцовым ионизационным манометром в объеме $(V_{62} + V_{\text{эт}})$;

p_1 — исходное давление, измеренное образцовым манометром ОМ в объеме V_{M1} .

Эталонный мембранны-емкостный манометр герметично соединяют с последним звеном поверяемой установки (резервуаром, в котором происходит последняя ступень расширения газа).

Среднее квадратическое отклонение $S_{\text{пов}}$ определяют по формуле

$$S_{\text{пов}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (p_{1 \text{ пов}} - p_{1 \text{ эт}})^2}{n(n-1)}}. \quad (16)$$

Допускаемую относительную погрешность поверяемой установки δ определяют по формуле

$$\delta = \delta_{\text{ст}} + 2,5 S_{\text{пов.}} \quad (17)$$

Предел допускаемой относительной погрешности $\delta_{\text{доп}}$ на нижнем пределе измерения установки с калиброванными объемами не должен быть более 3%.

Приведенная погрешность на верхнем пределе измерения определяется классом образцового манометра, по которому устанавливается исходное давление.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Положительные результаты поверки оформляются путем выдачи свидетельства о государственной поверке по форме, установленной Госстандартом СССР.


Запись на обратной стороне свидетельства приведена в приложении 3.

5.2. На образцовые средства измерений низкого абсолютного давления, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, выдается извещение о непригодности с указанием причин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ МАЛЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

Поверяемый резервуар V_m (см. рисунок) герметично подсоединяют к системе калиброванных резервуаров $V_{k,01}$ и $V_{k,02}$. Откачивают резервуар V_u .

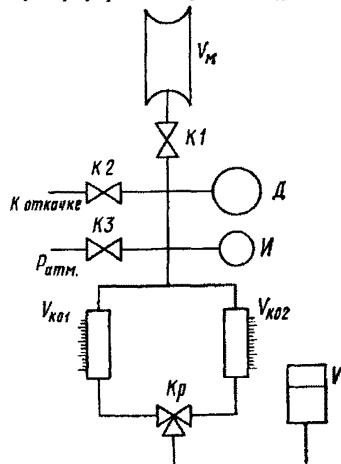

через клапаны $K1$ и $K2$ до давления $p_0 < 10^{-1}$ Па ($\sim 10^{-3}$ мм рт. ст.). Давление контролируют манометром I . Если резервуар V_m можно откачать с помощью откачных средств поверяемой установки, клапан $K2$ не используется. Закрывают клапаны $K1$ и $K2$ и с помощью клапана $K3$ в системе калиброванных резервуаров создают давление, равное атмосферному (p_{atm}), и измеряют его манометром D типа ОМ. Закрывают клапан $K3$, открывают клапан $K1$ и кран Kp и из резервуара V заполняют жидкостью калиброванные резервуары V_{k01} и V_{k02} до тех пор, пока давление в системе не установится равным первоначальному по показанию манометра D .

Объемы малых резервуаров определяют по формуле (13) настоящей методики.

Примечание. Для наполнения резервуаров применяют жидкость с низкой упругостью паров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

Уравнение измерения давления

$$p_i = \frac{k(h_c - h_u - \bar{\Delta}_1)(h_0 - h_u - \bar{\Delta}_2)}{1 - k(h_0 - h_u - \bar{\Delta}_1)},$$

$$\text{где } \bar{\Delta}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\delta_{ui} - \delta_{ci}),$$

$(\delta_{ui} - \delta_{ci})$ — разность депрессий ртути в измерительном и сравнительном капиллярах при i -м измерении;

$$\bar{\Delta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{V_{0i} - V_{ni}}{f} \right),$$

где V_{0i} — объем, дополняющий купол конца измерительного капилляра до цилиндра;

V_{ni} — объем, дополняющий мениск ртути до цилиндра;

f — площадь сечения измерительного капилляра;

k — постоянная манометра;

h_0 — высота внутреннего канала запаянного конца измерительного капилляра;

h_u — высота ртути в измерительном капилляре;

h_c — высота ртути в сравнительном капилляре.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕР ЗАПИСИ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ

Результаты государственной поверки образцового компрессионного манометра:

постоянная манометра $k = \dots$ 1/мм рт. ст.

начальный объем сжатия $V = \dots$ см³

$$P_i \frac{k(h_0 - h_u - \bar{\Delta}_2)(h_0 - h_u - \bar{\Delta}_2)}{1 - k(h_0 - h_u - \bar{\Delta}_1)} \text{ (мм рт. ст.)},$$

$\overline{\Delta}_1 = \dots$ мм рт. ст.;

$\overline{\Delta}_2 = \dots$ мм рт. ст.;

h_0 — высота внутреннего канала запаянного конца измерительного капилляра, мм;

h_c — высота ртути в измерительном капилляре, мм;

$h_{\text{к}}$ — высота ртути в сравнительном капилляре, мм.

Результаты государственной поверки образцовой установки с калиброванными объемами:

Объемы измерительных резервуаров

$V_{m1} = \dots$

$V_{61} = \dots$

$V_{m2} = \dots$

$V_{62} = \dots$

$$p = a\gamma \left[1 - (\alpha + \beta + \gamma) + \frac{e_0}{a\gamma} \right] p_1$$

$$\alpha = \frac{V_{m1}}{V_{61}}; \quad \beta = \frac{V_{m2}}{V_{61}}; \quad \gamma = \frac{V_{m2}}{V_{62}}; \quad e_0 = \frac{p_1}{p_0};$$

остаточное давление в объеме V_{62} $p_0 = \dots$ (Па, мм рт. ст.);

давление в объеме V_{m1} $p_1 = \dots$ (Па, мм рт. ст.).

Допускаемая относительная погрешность измерения давления $\sigma = \dots \%$.

Результаты государственной поверки образцового мембранио-емкостного манометра:

коэффициент преобразования манометра

$$\bar{C} = \dots (\text{В}^2/\text{Па}; \text{В}^2/\text{мм рт. ст.}).$$

Допускаемая относительная погрешность измерения давления, $\delta = \dots \%$

Подпись _____

Дата _____

МЕТОДИКА

проверки образцовых средств измерений низких абсолютных давлений

MI 111-76

Редактор *Л. В. Ярова*
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*
Корректор *С. С. Шишков*

Т-11308 Сдано в наб 26 01 77 Подп в печ 19 05 77 0 75 п л 0 73 уч изд л
Тир 3000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов Москва, Д 557, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6 Зак 164