
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАНДАРТИЗАЦИИ

РМГ 111—
2011

Государственная система обеспечения
единства измерений

ПРАВИЛА ПЛОМБИРОВАНИЯ И КЛЕЙМЕНИЯ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СОСТАВЕ СИСТЕМ
ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА НЕФТИ

Основные положения

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о рекомендациях

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»)

2 ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТЫ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 2 сентября 2011 г. № 47)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикистандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1055-ст рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 111—2011 введены в действие в качестве рекомендаций по метрологии Российской Федерации с 1 января 2013 г.

5 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Руководящие документы, рекомендации и правила», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих рекомендаций соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

В Российской Федерации настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Сокращения	1
3 Общие положения	1
4 Порядок нанесения поверительных клейм	2
5 Порядок нанесения калибровочных клейм	3
6 Порядок нанесения контрольных клейм	3
Приложение А (обязательное) Перечень средств измерений СИКН и ТПУ, подлежащих клеймению	5
Приложение Б (обязательное) Места нанесения оттисков клейм на средства измерений СИКН и ТПУ	15
Приложение В (справочное) Примеры реализации в СОИ уровней доступа пользователей к выполнению защищенных функций	61
Библиография	63

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

ПРАВИЛА ПЛОМБИРОВАНИЯ И КЛЕЙМЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СОСТАВЕ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА НЕФТИ

Основные положения

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Rules of identification of measuring instruments and equipment of oil quantity and parameters measuring systems.

Basic principles

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящие рекомендации распространяются на средства измерений, входящие в состав систем измерений количества и показателей качества нефти и поверочных установок, а так же их оборудование и устанавливают порядок и места нанесения оттисков поверительных, калибровочных и контрольных клейм, порядок доступа к местам пломбирования и паролирования, хранения паролей.

2 Сокращения

В настоящих рекомендациях приняты следующие сокращения:

АРМ — автоматизированное рабочее место;

БИК — блок измерения показателей качества нефти;

БИЛ — блок измерительных линий;

ВА — вторичная аппаратура;

ИВК — измерительно-вычислительный комплекс;

КП — компакт-прувер;

МИД — магнитно-индукционный датчик;

МПР — массовый преобразователь расхода;

ОЛПР — объемно-лопастной преобразователь расхода;

ПУ — поверочная установка;

ПСП — приемо-сдаточный пункт;

СИ — средство измерений;

СИКН — система измерений количества и показателей качества нефти;

СОИ — система обработки информации;

ТПР — турбинный преобразователь расхода;

ТПУ — трубопоршневая поверочная установка;

УЗПР — ультразвуковой преобразователь расхода.

3 Общие положения

3.1 Настоящие рекомендации предназначены для применения:

- организациями, осуществляющими учетные операции с применением СИКН и ПУ;
- организациями, осуществляющими техническое и метрологическое обслуживание СИКН и ПУ;

- владельцами СИКН и ПУ;
- проектными и исследовательскими организациями, занимающимися разработкой проектов СИКН;
- метрологическими службами юридических лиц, осуществляющими метрологический надзор за СИ;
- государственными метрологическими службами, осуществляющими государственный метрологический контроль и надзор.

3.2 Рекомендация распространяется на средства измерений, входящие в состав СИКН и ПУ, эксплуатируемые различными предприятиями и организациями добычи, транспорта и переработки нефти, независимо от форм собственности. Рекомендация может быть использована предприятиями других отраслей промышленности в случае эксплуатации рассматриваемых данной рекомендацией СИ и оборудования.

3.3 Для новых СИ, которые будут использованы в составе СИКН и ПУ, а также для СИ, находящихся в эксплуатации и входящих в состав СИКН и ПУ, но не вошедших в настоящие рекомендации, способ и места нанесения клейм рекомендуется указывать во вновь разрабатываемых или перерабатываемых методиках поверки СИ или в эксплуатационной документации в разделе «Оформление результатов поверки».

3.4 Контроль целостности оттисков клейм и пломб обеспечивают дежурные операторы принимающей и сдающей нефть организаций, о чем делают соответствующие записи в эксплуатационном журнале при приеме — сдаче смены.

3.5 При обнаружении повреждений оттисков клейм или пломб ответственные представители принимающей и сдающей нефть организаций составляют двусторонний акт о вышеуказанном происшествии и ставят в известность диспетчерские службы принимающей и сдающей нефть организаций, сервисной организации, проводящей техническое обслуживание СИКН.

4 Порядок нанесения поверительных клейм

4.1 Порядок нанесения оттиска поверительного клейма определен требованиями правил [1]. Оттиск поверительного клейма согласно правилам [1] представляет собой знак, нанесенный на СИ, дополнительные устройства и (или) техническую документацию, и удостоверяющий, что поверка СИ проведена с удовлетворительными результатами, а также для защиты, при необходимости, СИ от любого несанкционированного доступа, включая регулировочные (юстировочные) устройства.

4.2 Для гашения оттиска существующего поверительного клейма используют специальные поверительные клейма с рисунком крестообразной формы (гасители).

П р и м е ч а н и е — Если СИ по результатам поверки признано не пригодным к применению, оттиск поверительного клейма гасят, свидетельство о поверке аннулируют и выписывают извещение о непригодности или вносят соответствующую запись в техническую документацию.

4.3 Поверке подлежат следующие СИ, входящие в состав СИКН и подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору:

- ТПР, УЗПР, ОЛПР, МПР на измерительных линиях;
- поточные преобразователи плотности и преобразователи вязкости;
- поточные влагомеры нефти;
- датчики давления, преобразователи давления;
- датчики температуры, преобразователи измерительные к термопреобразователям сопротивления, термопреобразователи сопротивления;
- манометры, термометры;
- газосигнализаторы, газоанализаторы;
- суммирующие приборы, корректоры вязкости;
- устройства измерения параметров жидкости и газа, ИВК, СОИ, измерительные контроллеры, вычислители расхода и др.

4.4 Поверке подлежат ТПУ и СИ, входящие в их состав:

- датчики давления, преобразователи давления, манометры;
- датчики температуры, преобразователи измерительные к термопреобразователям сопротивления, термопреобразователи сопротивления, термометры;

- калиброванные участки ПУ;
- детекторы ПУ;
- вторичная аппаратура ПУ.

4.5 СИ, перечисленные в 4.3 и 4.4, подлежат поверке органами Государственной метрологической службы или аккредитованными на право поверки СИ метрологическими службами юридических лиц.

4.6 После окончания поверки СИ поверитель наносит оттиск поверительного клейма, соответствующего требованиям [1] на свидетельство о поверке и на СИ на пломбы, установленные на контрольных проволоках или на пломбировочных мастиках, или голограммической наклейкой в местах, указанных в методике поверки конкретных СИ. Для некоторых ИВК места нанесения оттиска поверительного клейма указаны на рисунках Б.22—Б.23.1, Б.25—Б.27 приложения Б и в приложении А.

4.7 Для СОИ, ИВК, контроллеров, вычислителей и т. д., снабженных средствами защиты от несанкционированного доступа к изменению информации (ввод мгновенных значений, проведение поверки, редактирование файлов) в виде паролей и (или) ключа, ключ и (или) пароль с уровнем доступа «поверитель» помещают в конверт или пенал, защищенный от вскрытия оттиском поверительного клейма. Конверт или пенал хранят на СИКН в составе эксплуатационной документации.

Также пароли (ключи) хранят по принадлежности: сдающая сторона, принимающая сторона и сервисная организация.

Уровни защиты от несанкционированного доступа к изменению информации в различных СОИ и вторичной аппаратуре приведены в приложении В.

5 Порядок нанесения калибровочных клейм

5.1 Результаты калибровки СИ удостоверяют нанесением оттиска калибровочного клейма в соответствии с правилами [2] в местах, указанных в методиках калибровки (поверки) конкретных СИ, а также в соответствии с приложением А.

5.2 Калибровочное клеймо в соответствии с правилами [3] — техническое устройство, пред назначенное для нанесения оттиска клейма на СИ, дополнительные устройства или техническую документацию в целях:

- удостоверения, что СИ имеют метрологические характеристики согласно действующим методикам калибровки;
- исключения при необходимости доступа к регулировочным устройствам СИ;
- опечатывания не пригодных к применению СИ;
- аннулирования существующего клейма (аннулирующие клейма).

5.3 Для СИКН калибровке подлежат СИ, результаты измерений которых не влияют на погрешность измерений массы нефти, на охрану окружающей среды и обеспечение безопасности труда. Например:

- расходомеры, установленные в БИК, их ВА, если расходомер применяется в комплекте с ВА;
- перепадомеры и манометры, измеряющие перепад давления на фильтрах.

5.4 Средства измерений, перечисленные в 4.3, подвергают калибровке метрологическими службами юридических лиц, аккредитованными на право проведения калибровки СИ.

5.5 Для гашения оттиска существующего калибровочного клейма используют специальные калибровочные клейма с рисунком крестообразной формы.

6 Порядок нанесения контрольных клейм

6.1 Контрольные клейма — знаки, наносимые на СИ, запорные элементы шкафов КИПиА, оборудование (запорную аппаратуру и другие устройства) представителем сервисной организации, обслуживающей СИ, представителями сдающей и принимающей нефть организаций для обнаружения любого несанкционированного доступа, открытия, проникновения.

6.2 Оттиски контрольных клейм наносят на:

- пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия винтов, завернутых в крышку клеммной коробки СИ, как на рисунках Б.5, Б.7, Б.10, приложение Б;
- пломбировочную мастику или наклейку на винт, стопорящий отвинчивание крышки клеммной коробки от корпуса, как на рисунках Б.3, Б.17, Б.18, Б.29, приложение Б;

- пломбировочную мастику или наклейку на винт, завернутый в крышку клеммной коробки СИ, как на рисунке Б.2.2, приложение Б;

- пломбу, установленную на контровочной проволоке, крестообразно охватывающей крышку клеммной коробки и корпус СИ, как показано на рисунке Б.2.1, приложение Б;

- пломбу, установленную на контровочной проволоке, пропущенной через специальные отверстия, предусмотренные для клеймения, например в крышке клеммной коробки и корпусе, как на рисунках Б.4, Б.15, Б.16, Б.19, приложение Б;

- пломбу, установленную на контровочной проволоке, охватывающей крышку клеммной коробки и корпус СИ, как показано на рисунках Б.1, Б.20, Б.21, приложение Б;

- пломбировочную мастику на винте крепления или в чашечке винта крепления панели вторичной аппаратуры или ИВК, как показано на рисунках Б.22.1, Б.22.2, Б.25, Б.26, приложение Б;

- пломбировочную мастику, нанесенную на винт крышки, закрывающей винты регулировки «нуля» или «диапазона» СИ.

П р и м е ч а н и е — В других случаях оттиск контрольного клейма наносят на пломбу, пломбировочную мастику или наклейку в местах, предусмотренных фирмой — изготовителем СИ для предотвращения несанкционированного доступа.

6.3 О нанесении и снятии контрольных клейм вносят запись в «Журнале установки и снятия пломб», имеющимся на СИКН. Оттиски контрольных клейм должны быть приложены к «Журналу установки и снятия пломб».

Приложение А
(обязательное)

Перечень средств измерений СИКН и ТПУ, подлежащих клеймению

Таблица А.1 — Перечень СИ с указанием мест нанесения оттисков клейм

Наименование средства измерений	Место нанесения оттиска клейма	
	проверительного или калибровочного	контрольного
А.1 Преобразователи расхода		
А.1.1 ТПР в БИЛ типа MVTM с двумя МИД («Smith Meter Inc.» FMC Energy Systems, США, Германия) — см. рисунок Б.1 приложения Б	На двух пломбах, установленных на контролловых проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах согласно рекомендациям [4]	На пломбу, установленную на контролловой проволоке, охватывающей крышку МИД, кабельный ввод и штуцер (рисунок Б.1 приложения Б) или пропущенной через отверстия в завернутых винтах крышки МИД и т. п. На наклейку, нанесенную на стыке крышки МИД и корпуса
А.1.2 ТПР в БИЛ типа МИГ, НОРД-М (БОЗНА, г. Бугульма) — см. рисунки Б.2.1 — Б.2.2 приложения Б	На двух пломбах, установленных на контролловых проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах согласно рекомендациям [4]	На пломбу, установленную на контролловой проволоке, крестообразно охватывающей крышку клеммной коробки и трубу измерительной линии (рисунок Б.2 приложения Б), или на мастику, нанесенную на шляпку соединительного винта с пломбировочной чашкой на корпусе клеммной коробки (рисунок Б.2.2 приложения Б)
А.1.3 «ТУРБОКВАНТ» («MMG AM Nova K.ft», Венгрия)	На пломбу, установленную на контролловой проволоке, пропущенной через отверстия завернутых винтов крышки, закрывающей цифровой переключатель установки коэффициента	На пломбировочную мастику, закрывающую задние винты крепления
А.1.4 «РОТОКВАНТ» («Bopp Reuther», Германия), HELIFLL TZ-N («Faure Herman», Франция), Daniel («Emerson», США) и др.	На двух пломбах, установленных на контролловых проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах согласно рекомендациям [4]	На наклейку, нанесенную на стыке крышки МИД (предусилителя, клеммной коробки) и корпуса, или на пломбировочную мастику, нанесенную на один из винтов крепления крышки или на пломбу, установленную на контролловой проволоке, пропущенной через отверстия винтов крышки МИД и охватывающей трубу ИЛ
А.1.5 ТПР в БИК	—	То же
А.1.6 УЗПР мод. UFM 500 («КРОНЕ-Автоматика», г. Самара) в БИК — см. рисунок Б.3 приложения Б	На двух пломбах, установленных на контролловых проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах	На пломбировочную мастику, нанесенную на винт, фиксирующий отвинчивание крышки преобразователя (рисунок Б.3 приложения Б)

⑤ Продолжение таблицы А.1

Наименование средства измерений	Место нанесения оттиска клейма	
	поверительного или калибровочного	контрольного
А.1.7 МПР ROTAMASS мод. RCCT3 («Yokogawa Electric CIS», Япония) в БИЛ — см. рисунок Б.4 приложения Б	На двух пломбах, установленных на контролочных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах	На пломбу, установленную на контролочной проволоке, проходящей через пазы электронного блока (рисунок Б.4 приложения Б)
А.1.8 УЗПР мод. ALTOSONIC-5 («Krohne Altometer», Нидерланды) с первичным и вторичным преобразователями в БИЛ	На двух пломбах, установленных на контролочных проволоках, пропущенных через отверстия винтов на крышках первичного и вторичного преобразователей, согласно рекомендациям [5]	—
А.1.9 МПР MICRO MOTION в БИЛ («Emerson Process Management, Fisher-Rosemount», США, Голландия) — см. рисунки Б.5 — Б.10 приложения Б	На двух пломбах, установленных на контролочных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах	На пломбу, установленную на контролочной проволоке, пропущенной через отверстия завернутых винтов крышки соединительной коробки (рисунки Б.5, Б.7, Б.10 приложения Б), на пломбу, установленную на контролочной проволоке, охватывающей корпус процессора и штуцер (рисунки Б.6, Б.8, Б.9 приложения Б)
А.1.10 Преобразователь измерительный RFT счетчика-расходомера массового Micro Motion («Emerson Process Management. Fisher-Rosemount», США, Голландия) — см. рисунки Б.11 — Б.12 приложения Б	На пломбу, установленную на контролочной проволоке, охватывающей корпус преобразователя через пазы в торцевых крышках (рис. Б.11 приложения Б), на пломбу, установленную на котировочной проволоке, крестообразно охватывающей корпус преобразователя (рисунок Б.12 приложения Б)	—
А.1.11 МПР CORIMASS мод. MFM («Krohne», Германия) в БИЛ	На пломбе или наклейке на запечатанном конверте с паролем защиты коммерческого учета согласно «Инструкции по установке и эксплуатации КОРИ-МАСС». На двух пломбах, установленных на контролочных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах	—
А.1.12 МПР PROMAS мод. 63F («Endress-Hauser Flowtec AG») в БИЛ	На двух пломбах, установленных на контролочных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах	На пломбировочную мастику, нанесенную на винт-фиксатор крышки преобразователя
А.1.13 ОЛПР SMITH мод. M 16 («Smith-Meter Inc.», США) в БИЛ	На двух пломбах, установленных на контролочных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах	На пломбах, установленных на контролочных проволоках, пропущенных через отверстия завернутых винтов крепления: а) преобразователя импульсов мод. PEXP к корпусу объемного счетчика; б) корпуса индикаторного счетчика к преобразователю импульсов мод. PEXP

Продолжение таблицы А.1

Наименование средства измерений	Место нанесения оттиска клейма	
	поверительного или калибровочного	контрольного
А.1.14 Расходомер-счетчик ультразвуковой УРСВ «Взлет ПР» в БИЛ	На двух пломбах, установленных на копировочных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах	На пломбу, нанесенную на один из крепежных винтов корпуса вторичного преобразователя
А.1.15 Индикатор расхода CRA/MRT-97 («Daniel», США) в БИК см. рисунок Б.13 приложения Б	—	На пломбу, установленную на копировочной проволоке, охватывающей весь корпус преобразователя через пазы на лицевой стороне прибора (рисунок Б.13 приложения Б)
А.1.16 Ротаметр Н 250 («Krohne», Германия) в БИК	—	На пломбу, установленную на болте, соединяющем крышку с задней стенкой прибора
А.2 Преобразователи давления, разности давлений и манометры		
А.2.1 Преобразователь давления «Cerabar M» («Endress+Hauser GmbH+Co», Германия) см. рисунок Б.14 приложения Б	—	На пломбу, установленную на контровочной проволоке, охватывающей крышку преобразователя, кабельный ввод и штуцер (рисунок Б.14 приложения Б)
А.2.2 Преобразователь давления «Cerabar S» («Endress+Hauser GmbH +Co.KG», Германия) см. рисунок Б.15 приложения Б	—	На пломбу, установленную на контровочной проволоке, проходящей через пазы преобразователя (электронного блока) (рисунок Б.15 приложения Б)
А.2.3 Преобразователи избыточного давления («Fisher-Rosemount», США, Голландия) см. рисунок Б.19 приложения Б, «МЕТРАН-100...» (ГП «Метран», г. Челябинск) см. рисунок Б.16 приложения Б	—	На пломбу, установленную на контровочной проволоке, проходящей через пазы корпуса (электронного блока) (рисунки Б.16, Б.19 приложения Б)
А.2.4 Преобразователи избыточного давления САПФИР (ЗАО «Манометр», г. Москва), ТЖИУ 406 (ПО «Старт», г. Заречный), («JUMO», Германия), («Endress+Hauser», Германия); датчик избыточного давления FHGG4W1 («ITT Barton Instruments», Канада); преобразователи разности давлений САПФИР — 22М (ЗАО «Манометр», г. Москва); датчики разности давлений типа IDP, IPS, 1FL («Foxboro Company», США)	—	На пломбу, установленную на контровочной проволоке, крестообразно охватывающей крышку клеммной коробки или проходящей через пазы клеммной коробки, или, пропущенной через отверстия в крышке клеммной коробки и корпусе. На пломбировочную мастику, нанесенную на крышку блока регулировочных кнопок или винтов (UP/ZERO, DOUN/SPAN)

∞ Продолжение таблицы А.1

Наименование средства измерений	Место нанесения оттиска клейма	
	поверительного или калибровочного	контрольного
А.2.5 Датчики давления «МЕТРАН-55-Вн...», «МЕТРАН-55-Д...», «МЕТРАН-55-Ex-Д...» (ГП «Метран», г. Челябинск) см. рисунки Б.17 — Б.18 приложения Б	—	На пломбировочную мастику, нанесенную на винт-фиксатор крышки преобразователя (рисунки Б.17, Б.18 приложения Б)
А.2.6 Манометры показывающие российского или зарубежного производства	На стекло или на мастику, нанесенную на шляпку соединительного винта с пломбировочной чашкой на задней стенке манометра или на наклейку на стыке корпуса и крышки, или на пломбу, установленную на контролевой проволоке, пропущенной через отверстие стопорного винта крышки и специального отверстия на выступе крышки	—
А.3 Преобразователи температуры, термометры		
А.3.1 Термопреобразователи сопротивления Ft 100 («JUMO» Германия), («Rosemount», Нидерланды); («Weksler Instruments», США); преобразователь термометра сопротивления мод. 5351-3 («Yokogawa Electric Works», Япония); преобразователи температуры «МЕТРАН» (ГП «Метран», г. Челябинск); преобразователи температуры ТСПУ (ТСМУ) («Эталон», г. Омск)	—	На пломбу, установленную на контролевой проволоке, крестообразно охватывающей крышку клеммной коробки и корпус, или на пломбировочную мастику, нанесенную на один из крепежных винтов крышки клеммной коробки, или на винт, фиксирующий крышку клеммной коробки, или на пломбу, установленную на контролевую проволоку, проходящую через пазы крышек преобразователя
А.3.2 Преобразователи температуры RTT20 («The Foxboro Company», США), 244, 644, 3144 («Fisher-Rosemount», США) см. рисунки Б.20 — Б.21 приложения Б	—	На пломбу, установленную на контролевой проволоке, охватывающей через пазы крышку клеммной коробки и корпус (рисунки Б.20 — Б.21 приложения Б). Для преобразователей температуры мод. 644 на пломбировочную мастику, нанесенную на винт фиксирующий крышку клеммной коробки
А.4 Системы обработки информации, вычислители расхода, измерительно-вычислительные комплексы, контроллеры		
А.4.1 ИВК Schlumberger мод. 7945 («Schlumberger Electronics Ltd», Великобритания)	На пломбу, установленную на контролевой проволоке, пропущенной через отверстия винтов крепления верхней и нижней крышек	—

Продолжение таблицы А.1

Наименование средства измерений	Место нанесения оттиска клейма	
	поверительного или калибровочного	контрольного
А.4.2 Вычислитель расхода GeoFio, GeoProv («Smith Meter Inc.», США, Германия), устройство измерения параметров жидкости мод. 7950, 7951, 7955 («Solartron Mobrey Ltd», Великобритания) см. рисунки Б.22.1, Б.22.2, Б.23.1, Б.23.2 приложения Б	На пломбу, установленную на копировочной проволоке, пропущенной через отверстия завернутых винтов крышки, закрывающей корпус замка (рисунки Б.22.1, Б.23.1 приложения Б); на наклейку, нанесенную на гнездо ключа (рисунки Б.22.2, Б.23.2), и на мастику, нанесенную на шляпку соединительного винта с пломбировочной чашкой на передней панели прибора (рисунки Б.22.1, Б.22.2 приложения Б). Для вычислителей расхода мод. 7915 и 7925 голограммическая наклейка или оттиск клейма поверителя, нанесенный на лицевую панель вычислителя	—
А.4.3 СОИ «КОР-МАС» («MMG AM», Венгрия)	На пломбы, установленные на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия завернутых винтов крышек, закрывающих платы установки коэффициентов, и на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия двух завернутых винтов крышки блока счетчика	—
А.4.4 Вычислитель расхода мод. 2522, TURBO 2522 («Daniel Measurement Control», США)	На пломбах, установленных на контрольной проволоке, пропущенной через отверстие за лицевой панелью, на напечатанном конверте с паролем ограниченного доступа. Уровни доступа приведены в приложении В	—
А.4.5 ИВК мод. ROC-600 FLOBOSS («Emerson/Fisher/Daniel», США/Великобритания)	На пломбу, нанесенную на запечатанный конверт с паролем «Поверитель», и на пломбировочную мастику, нанесенную на один из винтов крепления задней панели прибора. Уровни доступа приведены в приложении В	—
А.4.6 Блок электронный НОРД-Э3М, НОРД-Э9М (БОЗНА, г. Бугульма)	На пломбу, нанесенную на винт с чашкой на задней панели прибора	—
А.4.7 Сумматор импульсов LCCC-40 («Smith Meter Inc.» FMC Energy Systems, США, Германия) см. рисунок Б.24 приложения Б	На пломбировочную мастику, нанесенную на винт с чашкой на задней панели прибора (рисунок Б.24 приложения Б)	—
А.4.8 ИВК мод. OMNI-3000/6000 («Omni Flow Computers Inc.», США) см. рисунки Б.25 — Б.26 приложения Б	На пломбировочную мастику, нанесенную на винт с чашкой на задней панели прибора (рисунки Б.25 — Б.26 приложения Б). Уровни доступа приведены в приложении В	—
А.4.9 ИВК мод. ИМЦ-03 (ОАО «ИМС», г. Москва) см. рисунок Б.27 приложения Б	На пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстие в корпусе ручки двери шкафа, или на наклейку, нанесенную на гнездо ключа (рисунок Б.27 приложения Б), и на пломбировочную мастику, нанесенную на запечатанный конверт с паролем «Поверитель». Уровни доступа приведены в приложении В	—

→ Продолжение таблицы А.1

Наименование средства измерений	Место нанесения оттиска клейма	
	поверительного или калибровочного	контрольного
А.4.10 Преобразователь электронный «VEGA-03» (БОЗНА, г. Бугульма)	На пломбировочные мастики, нанесенные на два крепежных винта задней панели прибора	—
А.4.11 ИВК мод. OCTOPUS (ООО «ИМС», г. Тверь)	На пломбировочные мастики, нанесенные на винт с чашечкой на боковой панели прибора и на запечатанный конверт с паролем «Поверитель». Уровни доступа приведены в приложении В	—
А.4.12 ИВК «SYBERTROL» («FMC Smith Meter Inc.», США, Германия)	На пломбировочные мастики, нанесенные на винт крышки, закрывающей переднюю панель, и на запечатанный конверт с паролем «Поверитель». Уровни доступа приведены в приложении В	—
А.4.13 ИВК «МЕТРОКОН» и «МЕТРОКОН-М» (ОАО «Нефтеавтоматика», г. Уфа)	На пломбировочную машину, нанесенную на запечатанный конверт с паролем «Поверитель», и на наклейки на стыках верхней и боковых панелей. Уровни доступа приведены в приложении В	—
А.4.14 Прибор поверки эталонный «ПУЛЬСАР-01Э» (ООО «ПТП ЭРА-1», г. Омск) см. рисунок Б.28 приложения Б	На пломбировочную машину, нанесенную на винт с чашкой на задней панели прибора (рисунок Б.28 приложения Б). Уровни доступа приведены в приложении В	—
А.4.15 Вторичные приборы ТПР типа ETK, B&R (Германия), СМИТ (США), TQ-021, «Midi-Flow», «Ультраквант» (Венгрия), «Oval» (Япония)	На пломбировочную машину, нанесенную на один из крепежных винтов на передней панели прибора	—
А.4.16 Суммирующие приборы типа БСМ (Россия), СМИТ серии CMOS и СТС (США), JS4-04 Repeel-Funcs, Midi-Sum (Венгрия), Sodeco (Швейцария)	На пломбировочную машину, нанесенную на один из крепежных винтов на передней панели прибора	—
А.4.17 Шкафы СОИ «НИЧИМЕН» («Nichime-rit», Япония)	—	Шкаф ЭВМ — на пломбировочную машину или наклейку, соединяющую боковую стенку и дверцу шкафа. Приборный шкаф (шкаф ВА) — на пломбу, установленную на контролочной проволоке, пропущенной через отверстия в ручках шкафа
А.4.18 АРМ оператора «CROPOS», «ФАКТОР», «ОЛЕУМ» (ОАО «Нефтеавтоматика», г. Уфа)	На пломбировочную машину, нанесенную на запечатанный конверт с паролем «Поверитель». Уровни доступа приведены в приложении В	На пломбировочную машину, нанесенную на запечатанный конверт с паролем «Инженер»
А.4.19 Системный блок АРМ-оператора	—	На пломбировочную машину, нанесенную на винт с чашкой на задней стенке блока

Продолжение таблицы А. 1

Наименование средства измерений	Место нанесения оттиска клейма	
	поверительного или калибровочного	контрольного
А.4.20 ИВК мод. ИВК-Н, ИВК-Т (ИПФ «Турбулент», г. Омск) см. рисунок Б.29 приложения Б	На пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия в сборке модулей, и на пломбировочную мастику, нанесенную на винт с чашкой крепления крышки (рисунок Б.29 приложения Б)	—
А.5 Преобразователи плотности и вязкости		
А.5.1 Преобразователь плотности жидкости измерительный мод. 7830, 7835 («Solartron Mobrey Limited», Великобритания) см. рисунок Б.30 приложения Б	—	На пломбировочную мастику, нанесенную на винт с чашкой на крышке электронной части преобразователя, или на пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной по диагонали крышки через отверстия в винтах (рисунок Б.30 приложения Б); на двух пломбах, установленных на контрольных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах
А.5.2 Денсиметр (преобразователь плотности) SARASOTA мод. FD 960 («Ontx Measurement Ltd. Великобритания) см. рисунок Б.31 приложения Б	—	На одной пломбе, установленной на контрольной проволоке, пропущенной через пазы крышки клеммной коробки и корпуса усилителя (рисунок Б.31 приложения Б); на двух пломбах, установленных на контрольных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах
А.5.3 Преобразователь плотности жидкости NT 1762 («Schlumberger Electronics Ltd», Великобритания)	—	На пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия двух завернутых винтов крышки преобразователя; на двух пломбах, установленных на контрольных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах
А.5.4 Преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные (мод. 7827, 7829) («Solartron Mobrey Limited, Великобритания) см. рисунок Б.32 приложения Б	—	На пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстие в корпусе усилителя, и на пломбу, установленную на контрольной проволоке, охватывающей через пазы крышку преобразователя (рисунок Б.32 приложения Б); на двух пломбах, установленных на контрольных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на фланце диаметрально противоположно
А.5.5 Вискозиметр мод. OMS с детектором и преобразователем («JSW», Япония)	ВА — на пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия в корпусе	На пломбирующую мастику, нанесенную на один из винтов крепления блока преобразователя

12 Продолжение таблицы А.1

Наименование средства измерений	Место нанесения оттиска клейма	
	поверительного или калибровочного	контрольного
А.6 Влагомеры		
А.6.1 Влагомер поточный трех вариантов исполнений («Phase Dynamics, Inc.», США) см. рисунки Б.33 — Б.34.3 приложения Б	—	На пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия двух завернутых болтов крышки электронного блока; на пломбу, установленную на контрольной проволоке, охватывающей через пазы крышку преобразователя, и на двух пломбах, установленных на контрольных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на фланце диаметрально противоположно
А.6.2 Преобразователь измерительный сверхвысокочастотный влагомера нефти поточного УДВН-1пм (ООО НПП «ГОСИБ», г. Фрязино, Московская обл.) см. рисунок Б.35 приложения Б		На пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия шпильки крепления датчика к фланцам (рисунок Б.35 приложения Б)
А.6.3 Влагомер сырой нефти ВСН (НПП «Нефтесервисприбор», г. Саратов) см. рисунок Б.36 приложения Б	—	На пломбу, установленную на контрольной проволоке, охватывающей крышку преобразователя и штуцер; на двух пломбах, установленных на контрольных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, расположенных на диаметрально противоположных фланцах
А.7 Трубопоршневые поверочные установки, компакт-пруверы, мерники, весы		
А.7.1 ГПУ односторонние и двунаправленные	Поверительные клейма на пломбы, установленные: на контрольных проволоках, пропущенных через отверстия шпилек, соединяющих фланцы калиброванного участка измерительной петли; и на контрольных проволоках, пропущенных через отверстия завернутых винтов клеммной коробки детекторов согласно рекомендациям [6]	—
А.7.2 Компакт-пруверы		—
А.7.3 Мерник образцовый МИР («Energoinvest», СФРЮ) см. рисунок Б.37 приложения Б	Поверительные клейма на пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия в основании термокармана и скобы, закрепленной на корпусе мерника, и на пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия в винте и гайке для крепления градуировочной планки со шкалой (рисунок Б.37 приложения Б)	—

Продолжение таблицы А.1

Наименование средства измерений	Место нанесения оттиска клейма	
	поверительного или калибровочного	контрольного
А.7.4 Преобразователи давления, перечисленные в А.2.1 — А.2.5 приложения А настоящих рекомендаций	—	На пломбу, установленную на контрольной проволоке, крестообразно охватывающей крышку клеммной коробки или проходящей через пазы клеммной коробки, или пропущенной через отверстия в крышке клеммной коробки и корпусе; на пломбировочную мастику, нанесенную на крышку блока регулировочных кнопок или винтов (UP/ZERO, DOUN/SPAN)
А.7.5 Преобразователи температуры, перечисленные в А.3.1 — А.3.2 приложения А настоящих рекомендаций	—	На пломбу, установленную на контрольной проволоке, крестообразно охватывающей крышку клеммной коробки и корпус, или на пломбировочную мастику, нанесенную на один из крепежных винтов крышки клеммной коробки, или на винт, фиксирующий отворачивание крышки клеммной коробки, или на пломбу, установленную на контрольную проволоку, проходящую через пазы крышек преобразователя
А.7.6 Вторичная аппаратура ТПУ («Energoinvest», СФРЮ) см. рисунок Б.38 приложения Б	На пломбу, установленную на контрольную проволоку, пропущенную через головки двух винтов передней панели прибора, или на пломбировочную мастику, нанесенную на винт с чашкой на передней панели прибора (рисунок Б.38 приложения Б)	—
А.7.7 Устройство весоизмерительное мод. 0958 («METTLER TOLEDO», Швейцария)	На пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия винтов крепления крышки	—
А.8 Сигнализаторы загазованности, газоанализаторы, блоки питания и сигнализации, индикаторы фазового состояния, клеммные коробки измерительного (контрольного) кабеля		
А.8.1 Сигнализатор СТМ-ЗО-50, СТМ-10 («СПО Аналитприбор», Россия)	На пломбировочную мастику, нанесенную на боковую или лицевую панель прибора, оттиск клейма поверителя на лицевой панели ВА	На пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной через отверстия завернутых винтов крышки выносного блока датчика, и на пломбировочную мастику в месте крепления корпуса вторичного прибора
А.8.2 Датчики-сигнализаторы термохимические ДАТ, датчики-газоанализаторы электрохимические ДАХ, блок питания и сигнализации БПС 21	На пломбировочную мастику, нанесенную на боковую или лицевую панель прибора, оттиск клейма поверителя на лицевой панели ВА	—
А.8.3 Индикатор фазового состояния потока ИФС-1В-700 (ОАО «Электрон», г. Тюмень) см. рисунок Б.40 приложения Б	—	Согласно рисунку завода-изготовителя в техническом описании и инструкции по эксплуатации

14 Окончание таблицы А.1

Наименование средства измерений	Место нанесения оттиска клейма	
	поверительного или калибровочного	контрольного
А.8.4 Клеммные коробки измерительно-го кабеля	—	На пломбу, установленную на контролевой проволоке, пропущенной через отверстия двух винтов, ввернутых в крышку клеммной коробки
А.9 Пробоотборники		
А.9.1 Пробоотборник Clif Mock («NuFlo Technologies, Inc.», США) см. рисунок Б.41 приложения Б	—	На пломбу, установленную на контролевой проволоке, охватывающей привод CD-30A (в углублениях), болт, коробку и трубопровод (рисунок Б.41 приложения Б)
А.9.2 Пробоотборник для ручного отбора нефти «СТАНДАРТ» — Р (БОЗНА, г. Бугульма) см. рисунок Б.42 приложения Б	—	На пломбу, которая установлена на контролевой проволоке, пропущенной через отверстие шпильки, расположенной на фланцах, и отверстие рычага при закрытом положении (рисунок Б.42 приложения Б)
А.9.3 Пробоотборник для автоматического отбора нефти «СТАНДАРТ» — А (БОЗНА, г. Бугульма)	—	На пломбировочную мастику, нанесенную на винт с чашкой на корпусе дозатора
А.9.4 Автоматический пробоотборник «Проба-1М» (БОЗНА, г. Бугульма)	—	На баллоне согласно паспорту 1-92 ПС, совмещенному с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации; на пробоотборнике — на пломбу, установленную на контролевой проволоке, охватывающей через углубления корпус и пропущенной через предусмотренное отверстие
А.10 Задвижки, краны шаровые		
А.10.1 Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем (ОАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры, Россия, г. Алексин-8) см. рисунок Б.43 приложения Б	—	На пломбу, установленную на контролевой проволоке, пропущенной через корпус задвижки и спицу штурвала, таким образом, что предотвращает его несанкционированное вращение (рисунок Б.43 приложения Б)
Задвижки, не указанных в А.10, других фирм-производителей	—	Пломбирование задвижки должно обеспечивать невозможность несанкционированного изменения положения штурвала, а также его демонтаж и проворачивание шпинделя без штурвала
А.10.2 Кран шаровый с ручным приводом	—	Схема пломбирования рычага крана шарового должна обеспечивать невозможность несанкционированного изменения положения рычага (пломбировка закрытого положения)
А.10.3 Кран шаровый с электроприводом	—	Схема пломбирования должна обеспечивать невозможность несанкционированного изменения положения штурвала и стопорных механизмов (при возможном варианте)

Приложение Б
(обязательное)

Места нанесения оттисков клейм на средства измерений СИКН и ТПУ

Таблица Б.1 — Перечень средств измерений СИКН и ТПУ

Номер рисунка	Наименование, тип СИ
Б.1	Преобразователь расхода жидкости турбинный MVTM с двумя магнитно-индукционными датчиками фирмы «Smith Meter Inc.» FMC Energy Systems, США, Германия
Б.2.1	Преобразователь расхода турбинный счетчика турбинного «МИГ», «НОРД-М» БОЗНА, г. Бугульма. Вариант 1 пломбирования
Б.2.2	Преобразователь расхода турбинный счетчика турбинного «МИГ», «НОРД-М» БОЗНА, г. Бугульма. Вариант 2 пломбирования
Б.3	Счетчик ультразвуковой серии UFM с вторичным преобразователем UFC 500F производства «КРОНЕ-Автоматика», г. Самара
Б.4	Преобразователь расхода массовый ROTAMASS цельноблочного исполнения, RCCT3 производства Yokogawa Electric CIS, Япония
Б.5	Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель CMF 025 (050, 100) серии Elite, выполненный с соединительной коробкой, фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount», США, Голландия
Б.6	Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель CMF 025 (050, 100) серии Elite, выполненный с базовым процессором, фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount». США, Голландия
Б.7	Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель CMF 200 (300) серии Elite, выполненный с соединительной коробкой, фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount», США, Голландия
Б.8	Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель CMF 200 (300) серии Elite, выполненный с базовым процессором, фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount», США, Голландия
Б.9	Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель T 025 (050, 100, 150), выполненный с базовым процессором, фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount», США, Голландия
Б.10	Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель T 025 (050, 100, 150), выполненный с соединительной коробкой, фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount», США, Голландия
Б.11	Преобразователь измерительный RFT счетчика-расходомера массового Micro Motion фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount», США, Голландия
Б.12	Преобразователь измерительный RFT с трансмиттером счетчика-расходомера массового Micro Motion фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount», США, Голландия
Б.13	Прибор вторичный счетчиков жидкости турбинных MRT 97 фирмы «Daniel», США
Б.14	Преобразователь давления измерительный Cerabar M фирмы «Endress+Hauser GmbH+Co», Германия
Б.15	Преобразователь давления измерительный Cerabar S с изолирующей диафрагмой и фланцем фирмы «Endress+Hauser GmbH+Co. KG», Германия
Б.16	Датчик давления МЕТРАН-100-... группы предприятий МЕТРАН, г. Челябинск
Б.17	Датчик давления МЕТРАН-55-Вн-... группы предприятий МЕТРАН, г. Челябинск
Б.18	Датчик давления МЕТРАН-55-Д, группы предприятий МЕТРАН, г. Челябинск
Б.19	Датчик давления 1151 фирмы «Fisher-Rosemount MFG GmbH & Co.OHG», Германия
Б.20	Преобразователь измерительный 3144 к датчикам температуры фирмы «Fisher-Rosemount», США

Окончание таблицы Б.1

Номер рисунка	Наименование, тип СИ
Б.21	Преобразователь температуры измерительный RTT20 фирмы «The Foxboro Company», США
Б.22.1	Вычислитель расхода GeoFlo и GeoProv фирмы «Smith Meter Inc», США, Германия. Вариант 1 пломбирования
Б.22.2	Вычислитель расхода GeoFlo и GeoProv фирмы «Smith Meter Inc», США, Германия. Вариант 1 пломбирования
Б.23.1	Устройство измерения параметров жидкости и газа (моделей 7950, 7951, 7955) фирмы «SML», Великобритания. Вариант 1 пломбирования
Б.23.2	Устройство измерения параметров жидкости и газа (моделей 7950, 7951, 7955) фирмы «SML», Великобритания. Вариант 2 пломбирования
Б.24	Сумматор импульсов LCCC-40 фирмы «Smith Meter Inc.» FMC Energy Systems», США, Германия
Б.25	Измерительно-вычислительный контроллер OMNI-6000 фирмы «OMNI FLOW COMPUTERS, INC.», США
Б.26	Измерительно-вычислительный контроллер OMNI-3000 фирмы «OMNI FLOW COMPUTERS, INC.», США
Б.27	Измерительно-вычислительный комплекс модели «ИМЦ-03» ОАО «ИМС», г. Москва
Б.28	Прибор поверки эталонный «ПУЛЬСАР-01Э» ООО «ПТП ЭРА-1», г. Омск
Б.29	Измерительно-вычислительный комплекс ИВК-П ИПФ «Турбулент», г. Омск
Б.30	Преобразователь плотности жидкости измерительный модели 7835 фирмы «Solartron Mobrey Limited», Великобритания
Б.31	Денсиметр SARASOTA модели FD 960 фирмы «Onix Measurement Ltd.», Великобритания
Б.32	Преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные (модели 7827, 7829) фирмы «Solartron Mobrey Limited», Великобритания
Б.33	Блок электронный влагомера поточного фирмы «Phase Dynamics, Inc.», США
Б.34.1	Влагомер поточный фирмы «Phase Dynamics, Inc.», США. Вариант 1 исполнения
Б.34.2	Влагомер поточный фирмы «Phase Dynamics, Inc.», США. Вариант 2 исполнения
Б.34.3	Влагомер поточный фирмы «Phase Dynamics, Inc.», США. Вариант 3 исполнения
Б.35	Преобразователь измерительный сверхвысокочастотный влагомера нефти поточного УДВН-1пм ООО НПП «ГОДСИБ», г. Фрязино Московской обл.
Б.36	Влагомер сырой нефти ВСН НПП «Нефтесервисприбор», г. Саратов
Б.37	Мерник образцовый МИР «Energoinvest», СФРЮ
Б.38	Вторичная аппаратура ТПУ «Energoinvest», СФРЮ
Б.39	Вторичная аппаратура ТПУ «MMG AM», Венгрия
Б.40	Индикатор фазового состояния потока ИФС-1В-700 ОАО «Электрон», г. Тюмень
Б.41	Изокинетический пробоотборник Clif Mock «NuFlo Technologies, Inc.», США
Б.42	Пробоотборник для ручного отбора нефти «СТАНДАРТ» — Р БОЗНА, г. Бугульма
Б.43	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем ОАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры», Россия, г. Алексин-8

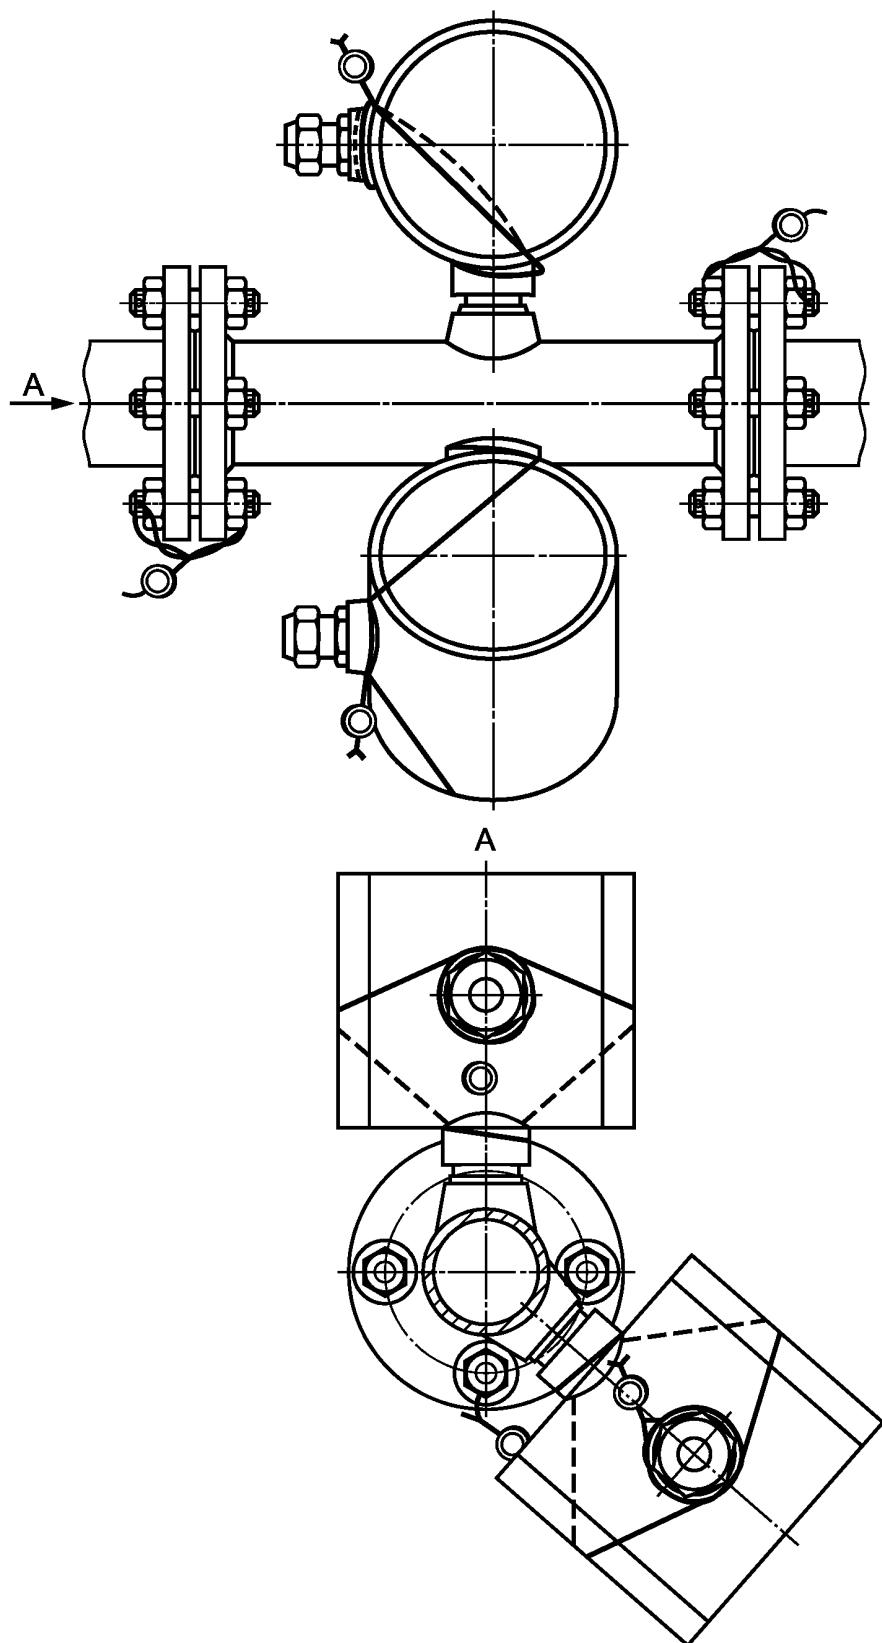


Рисунок Б.1 — Преобразователь расхода жидкости турбинный МВТМ с двумя магнитно-индукционными датчиками фирмы «Smith Meter Inc.» FMC Energy Systems



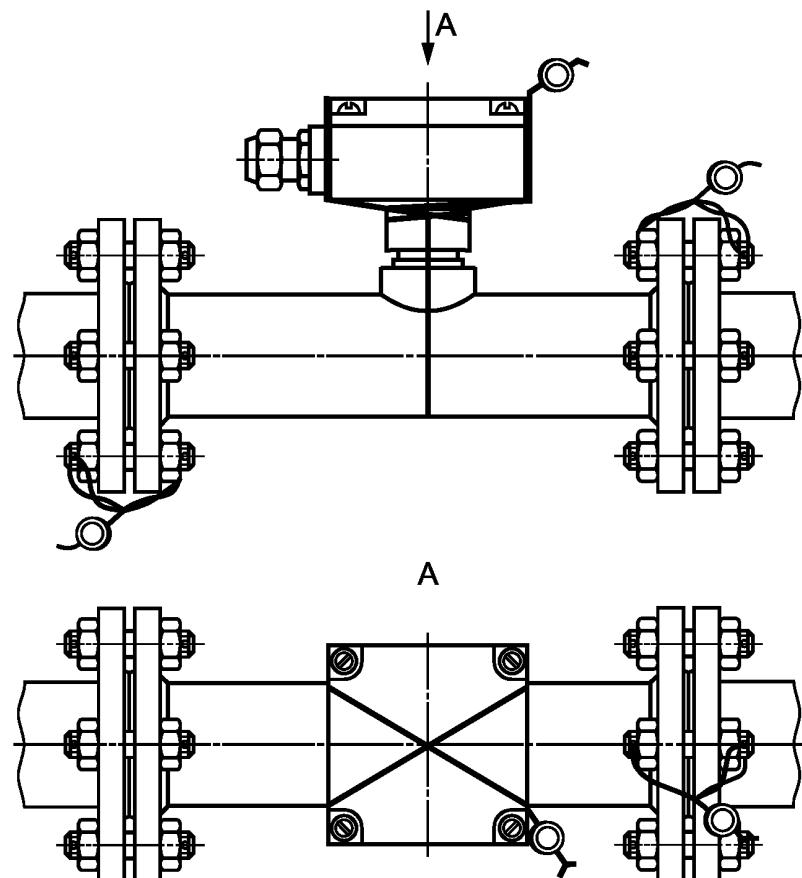


Рисунок Б.2.1 — Преобразователь расхода турбинный счетчика турбинного «МИГ», «НОРД-М» БОЗНА,
вариант 1 пломбирования

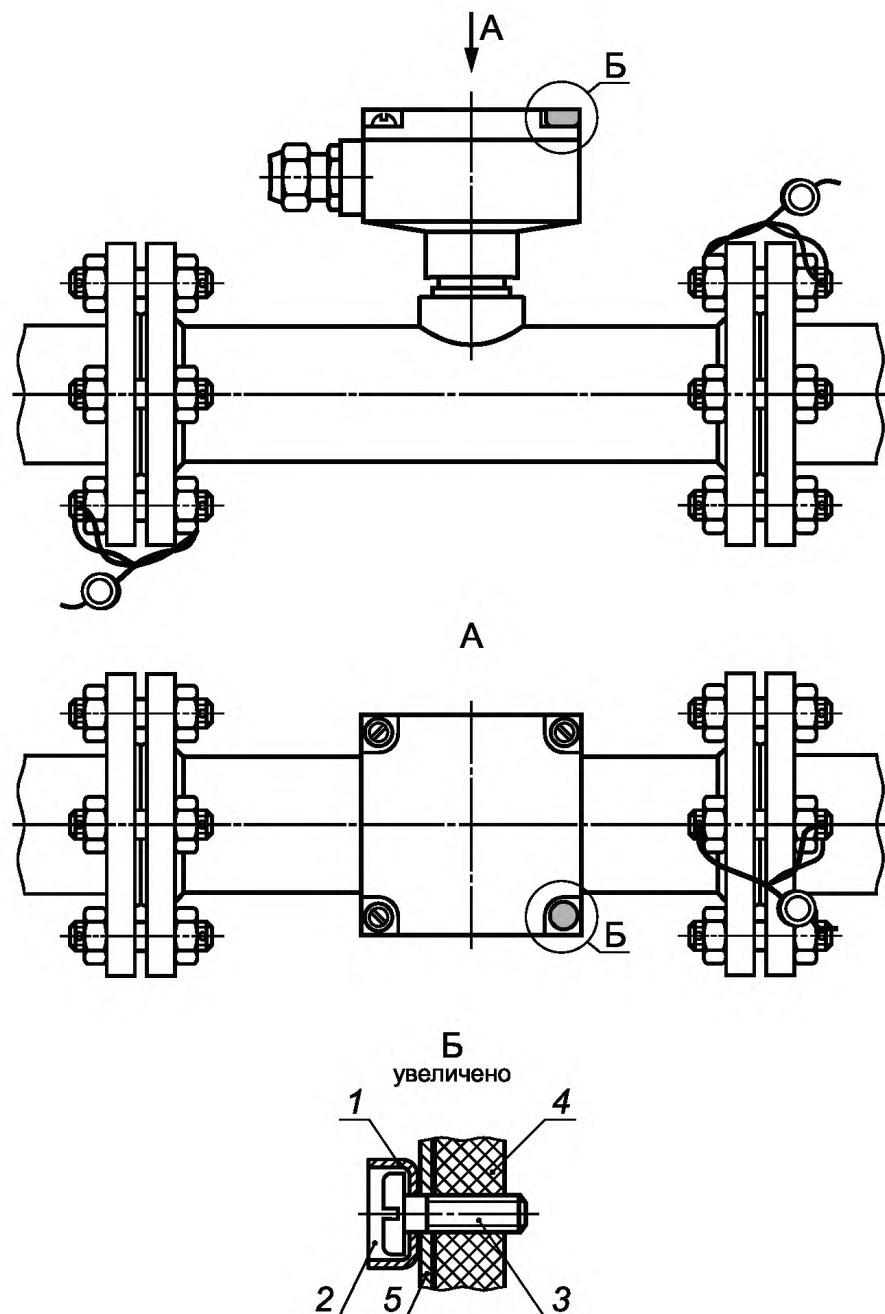

1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — корпус;
5 — крышка клеммной коробки

Рисунок Б.2.2 — Преобразователь расхода турбинный счетчика турбинного «МИГ», «НОРД-М» БОЗНА,
вариант 2 пломбирования

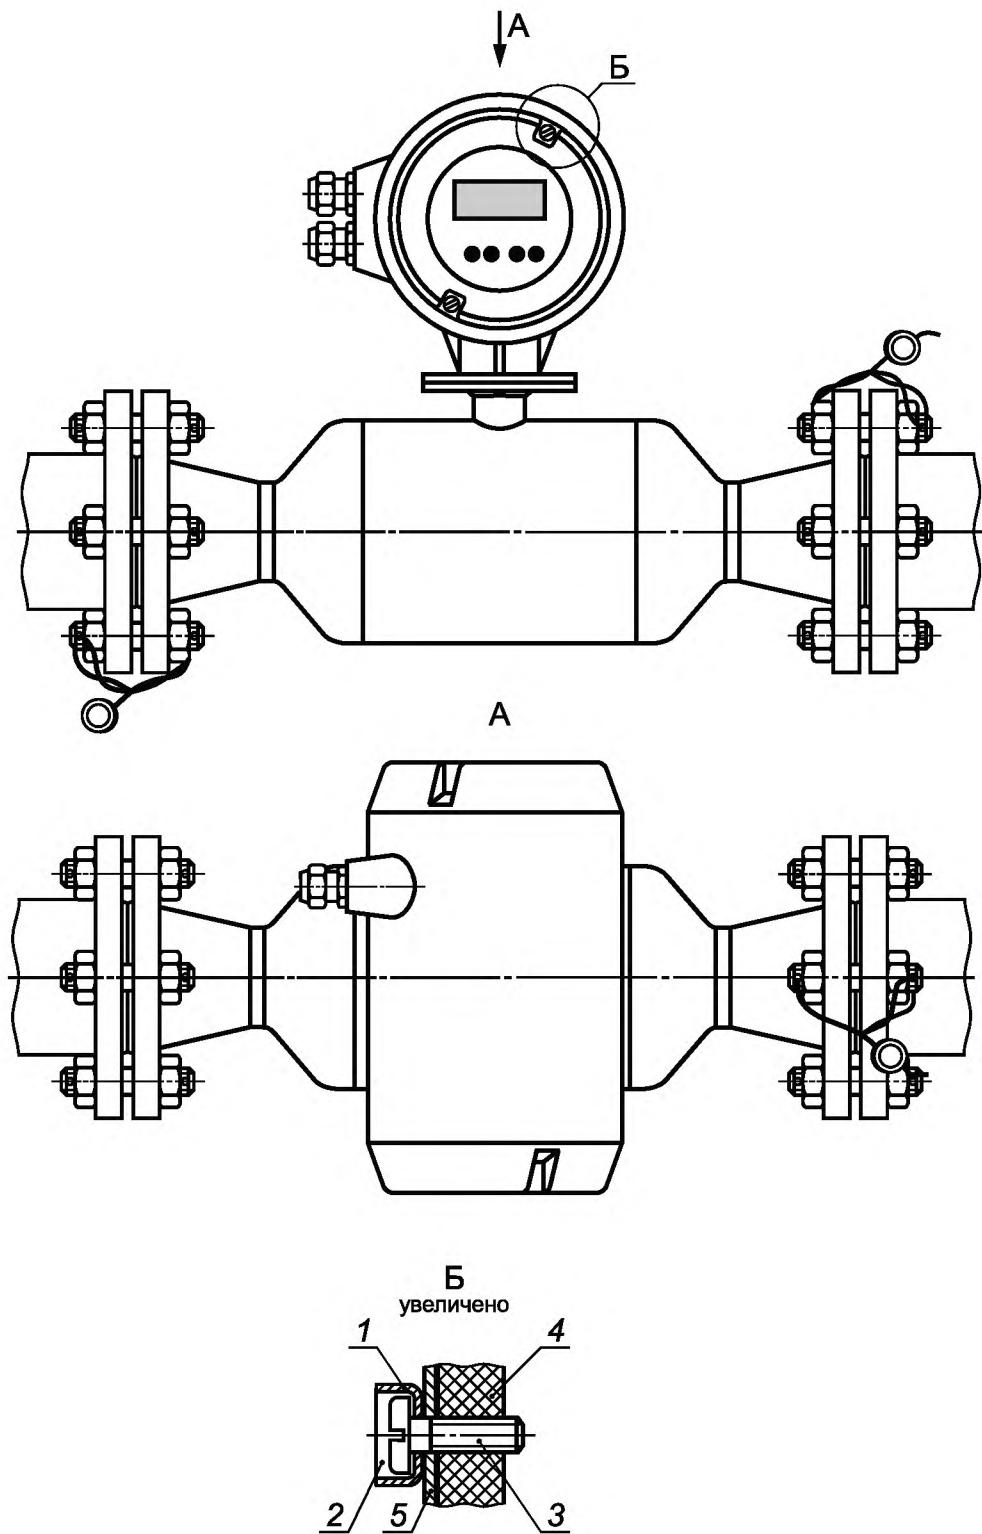

1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — корпус прибора; 5 — крышка датчика

Рисунок Б.3 — Счетчик ультразвуковой серии UFM с вторичным преобразователем UFC 500F производства «KPOFFi-Автоматика»



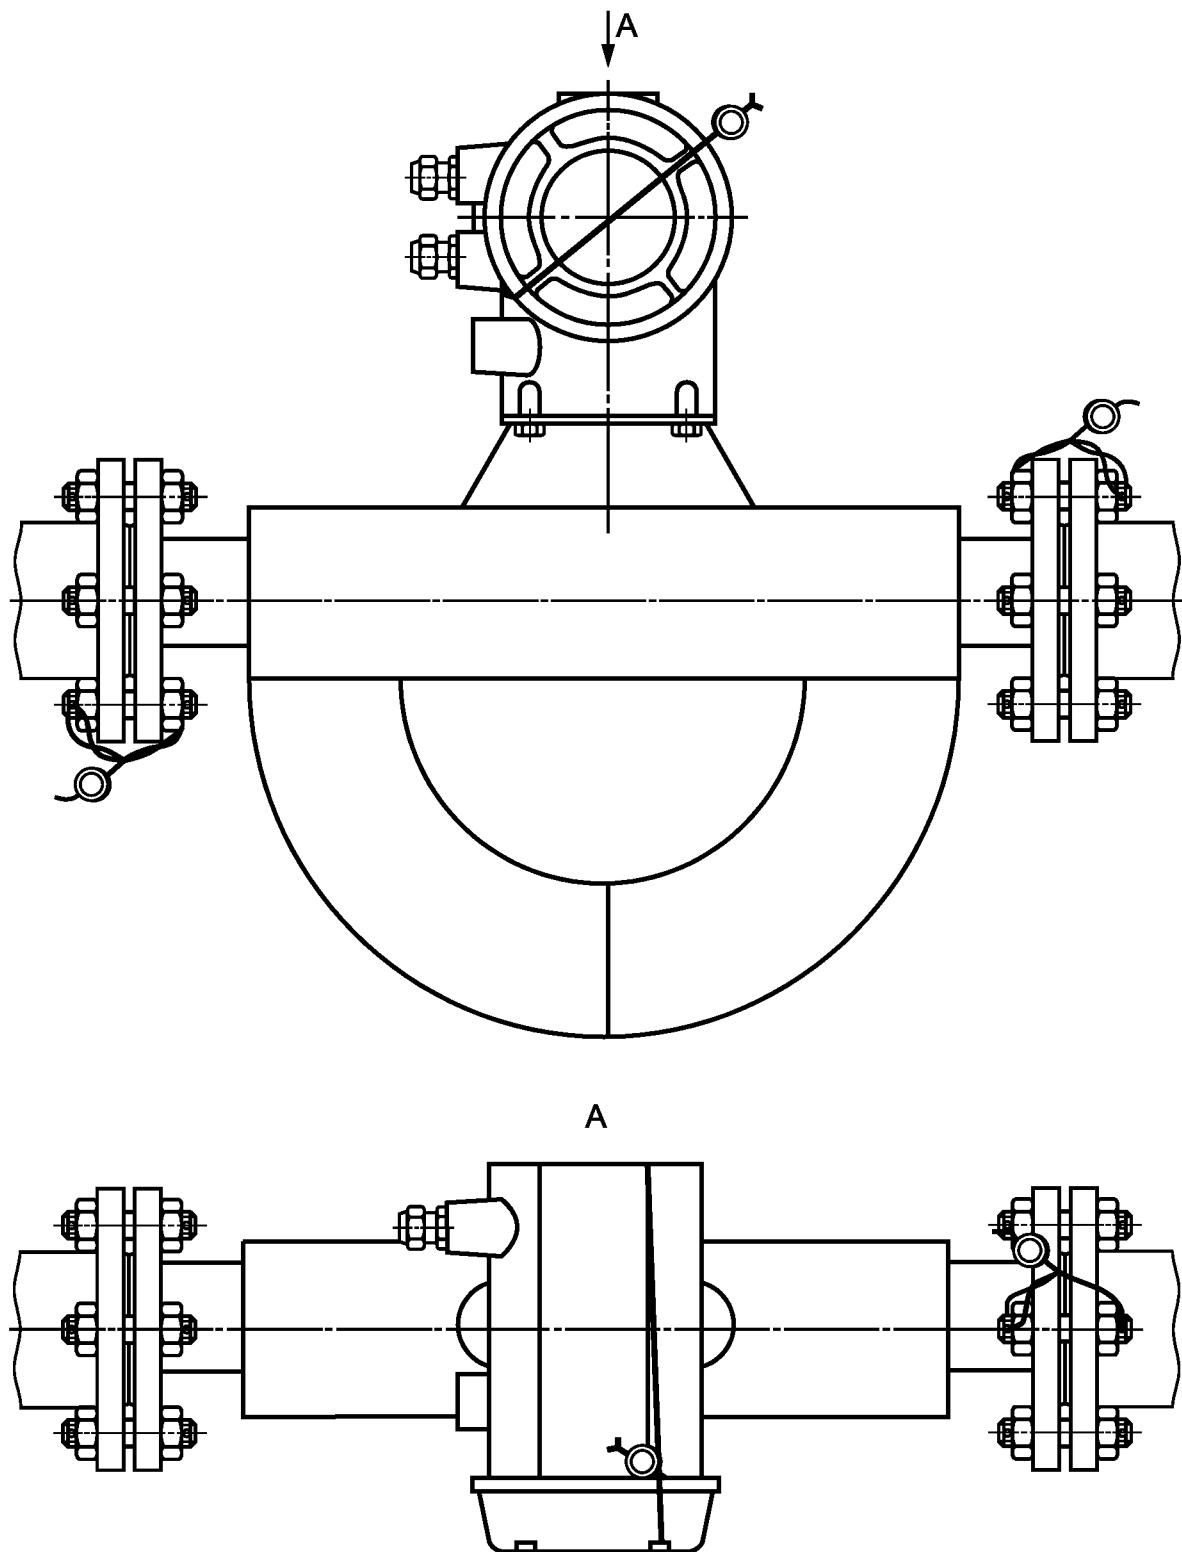


Рисунок Б.4 — Преобразователь расхода массовый ROTAMASS цельноблочного исполнения RCCT3
фирмы «Yokogawa Electric CTS»

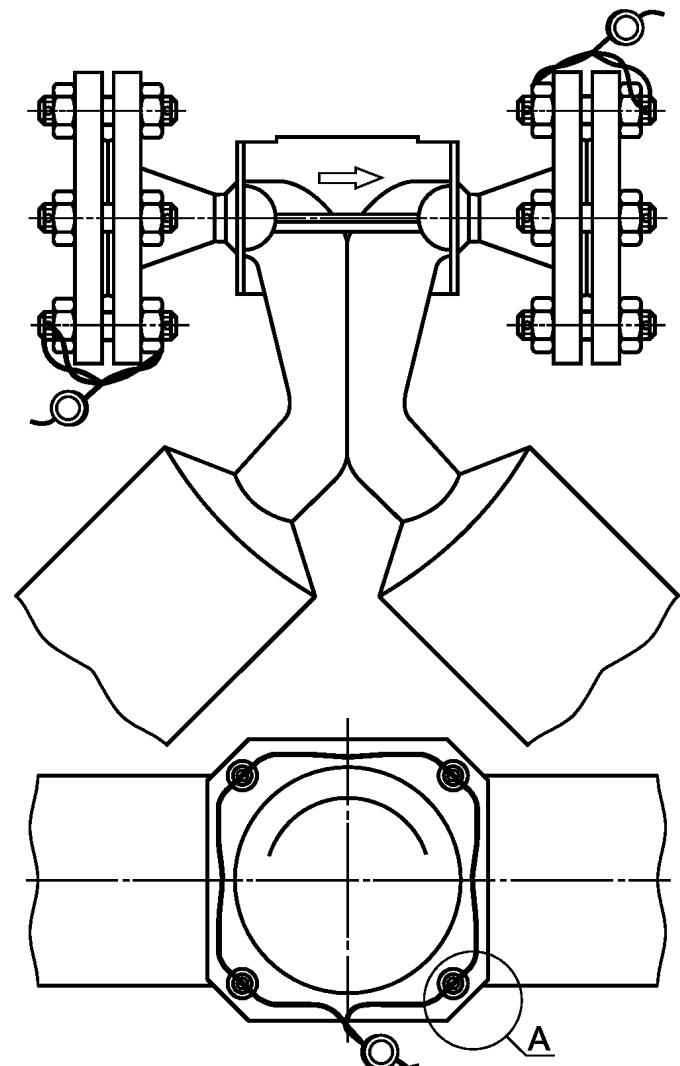

A
увеличенено



1 — крышка соединительной коробки; 2 — корпус соединительной коробки;
3 — крепежный винт под контрновочную проволоку

Рисунок Б.5 — Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель CMF 025 (050,100) серии Elite, выполненный с соединительной коробкой, фирмы «Emerson Process Management, Fisher—Rosemount»


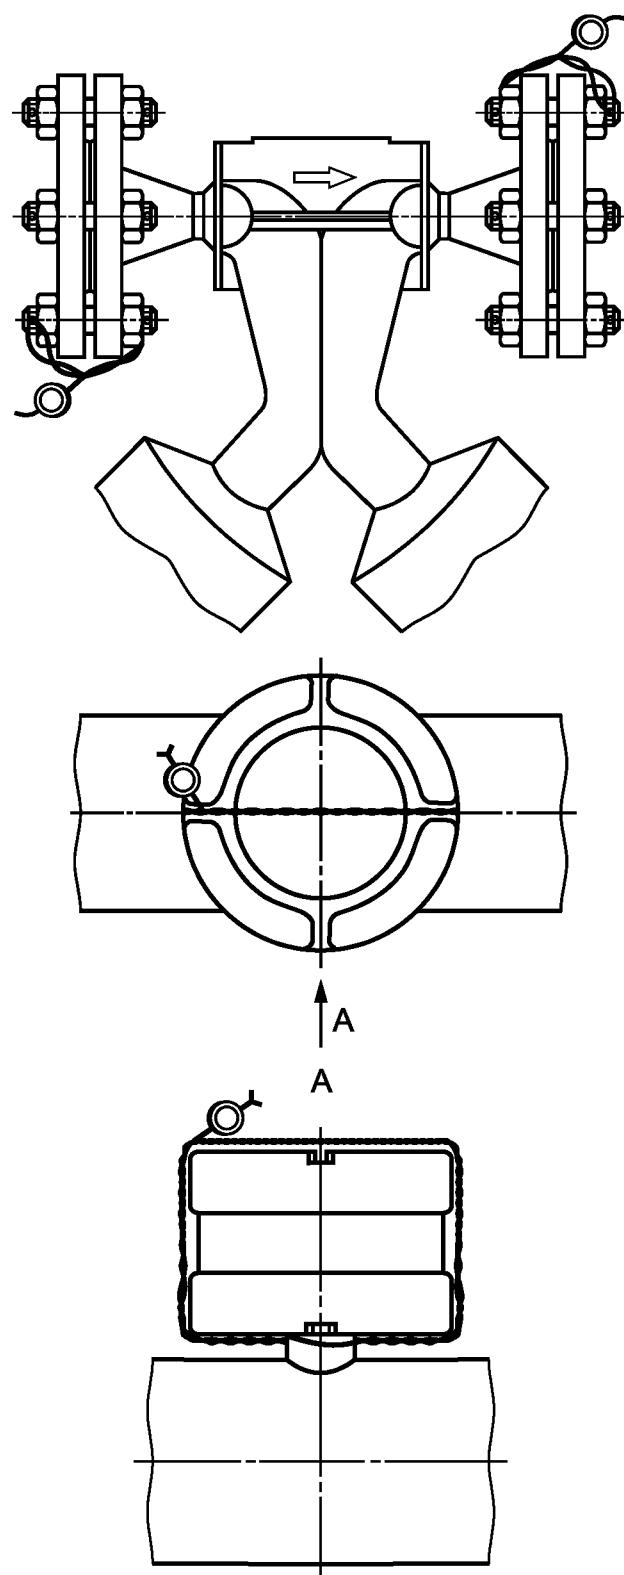


Рисунок Б.6 — Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель CMF 025 (050, 100) серии Elite, выполненный с базовым процессором, фирмы «Emerson Process Management, Fisher—Rosemount»

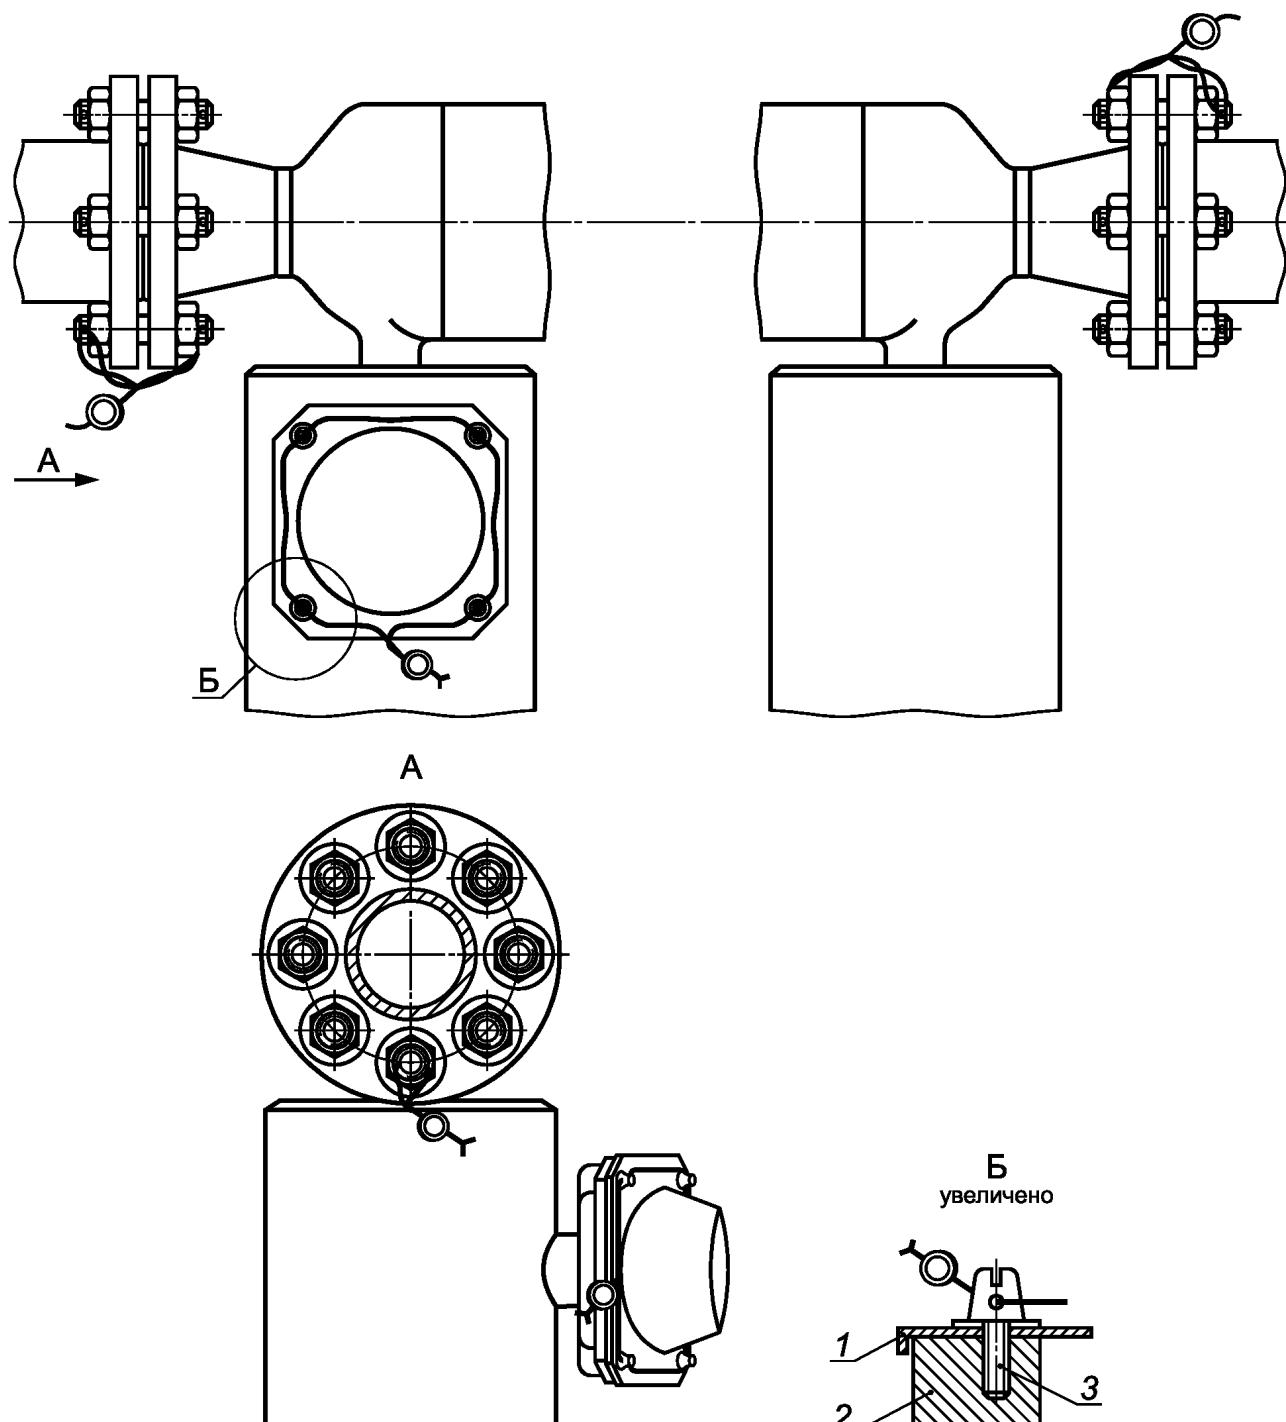

1 — крышка соединительной коробки;
2 — корпус соединительной коробки;
3 — крепежный винт под контровочную проволоку

Рисунок Б.7 — Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель CMF 200 (300) серии Elite, выполненный с соединительной коробкой, фирмы «Emerson Process Management, Fisher—Rosemount»

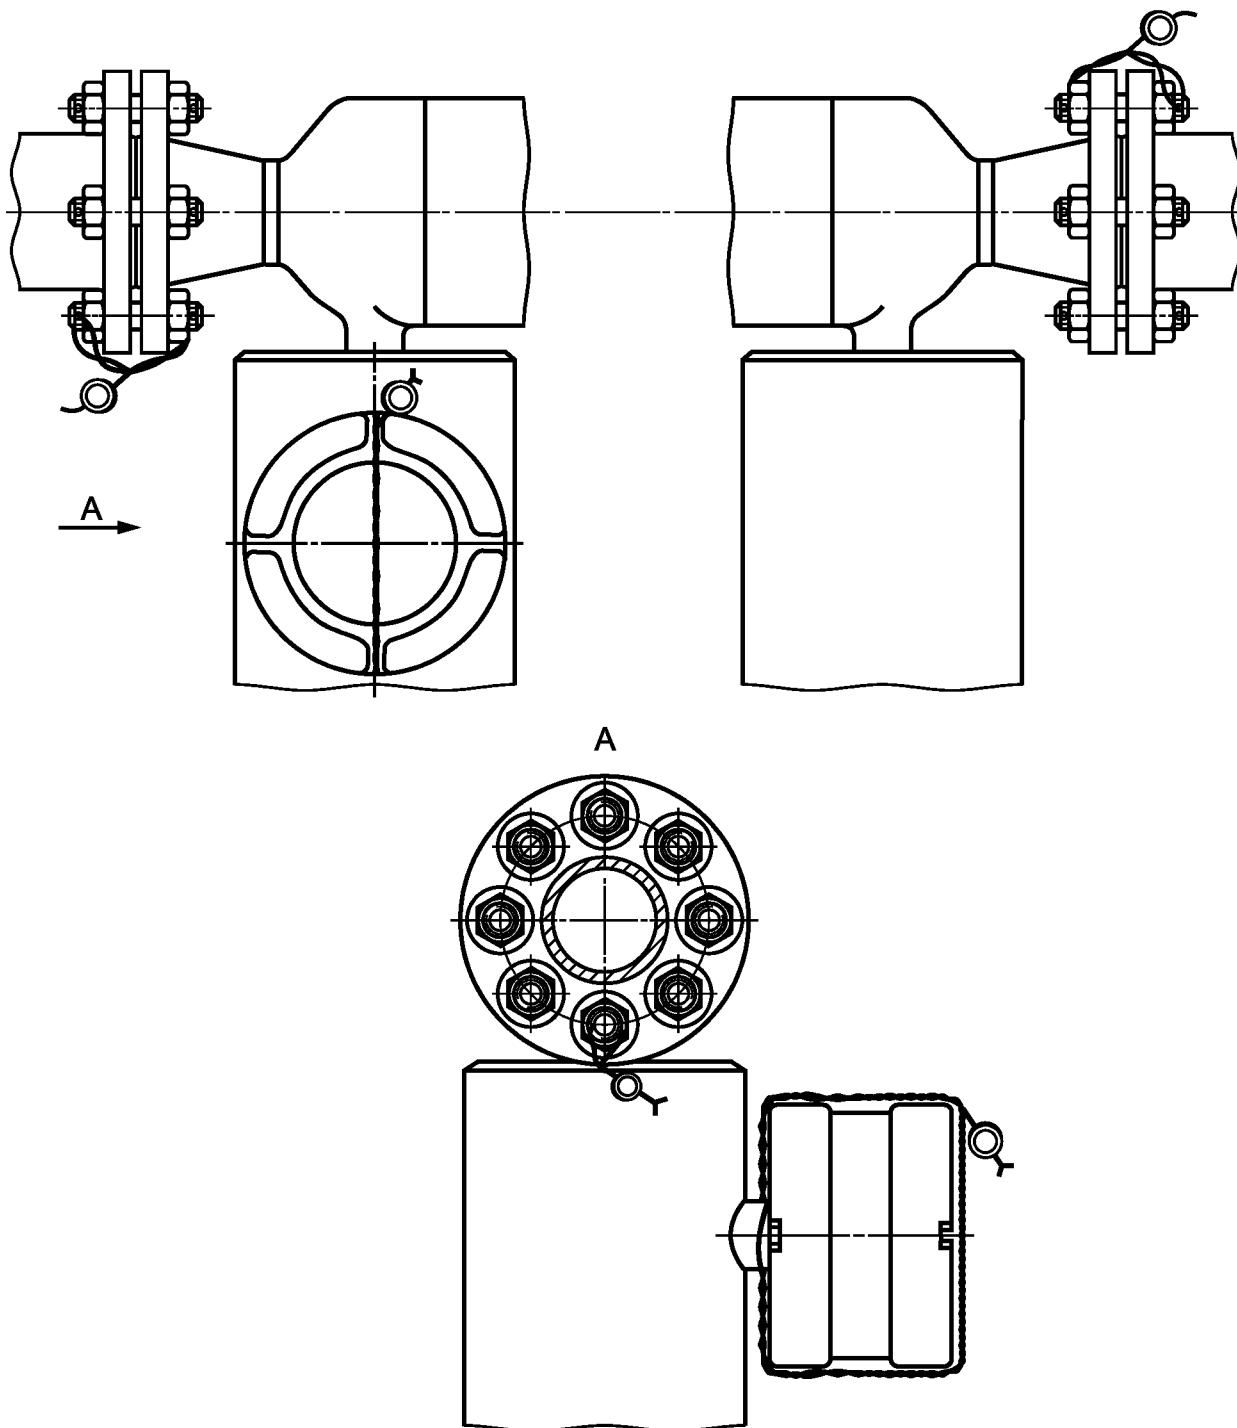


Рисунок Б.8 — Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель CMF 200 (300) серии Elite, выполненный с базовым процессором, фирмы «Emerson Process Management, Fisher—Rosemount»


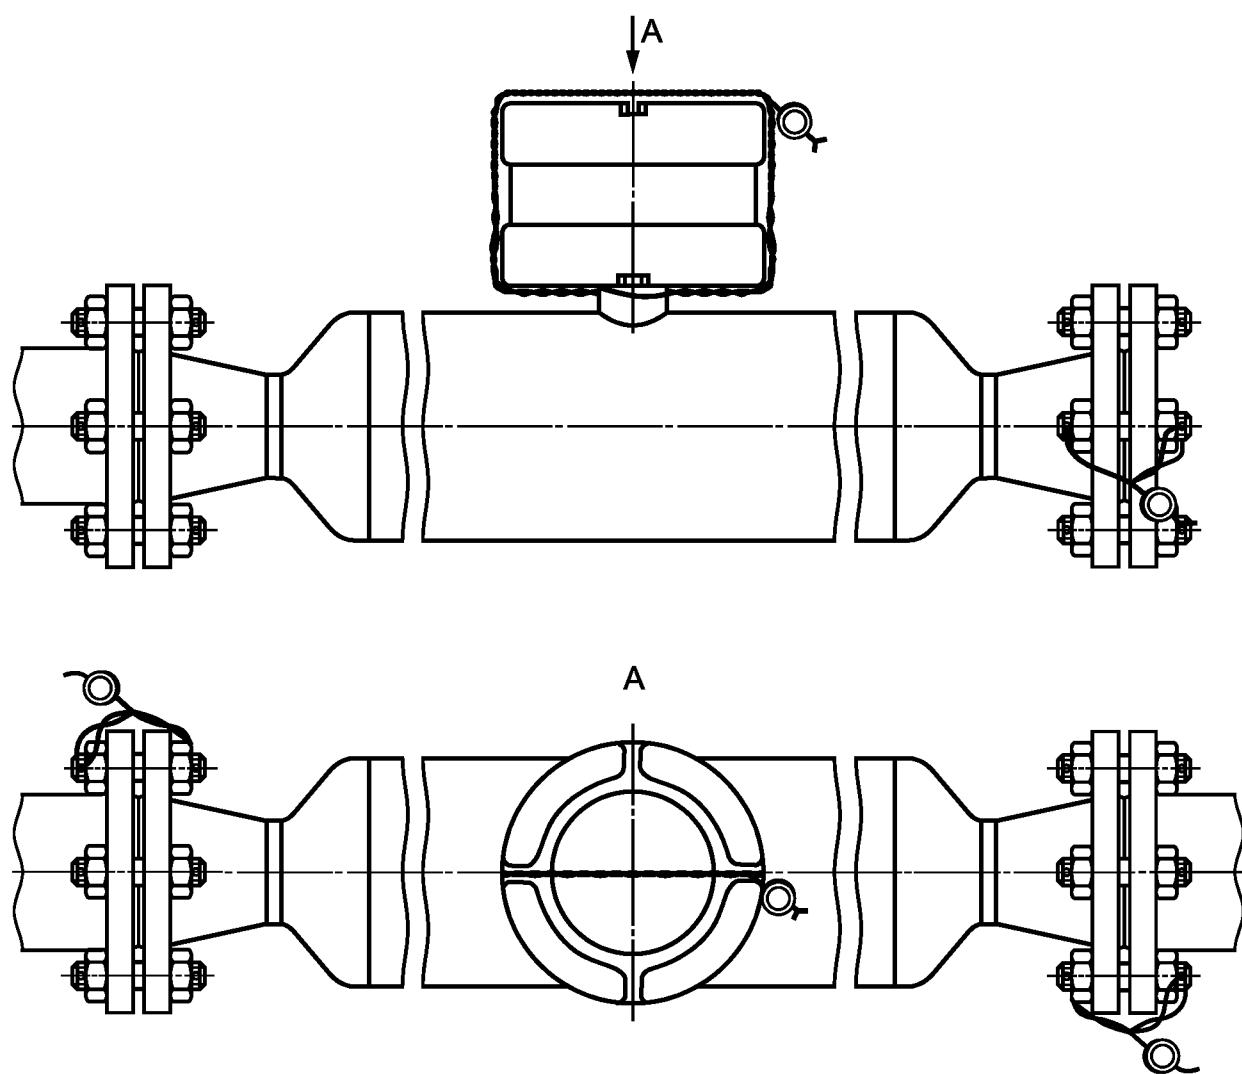


Рисунок Б.9 — Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель Т 025 (050, 100, 150), выполненный с базовым процессором, фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount»

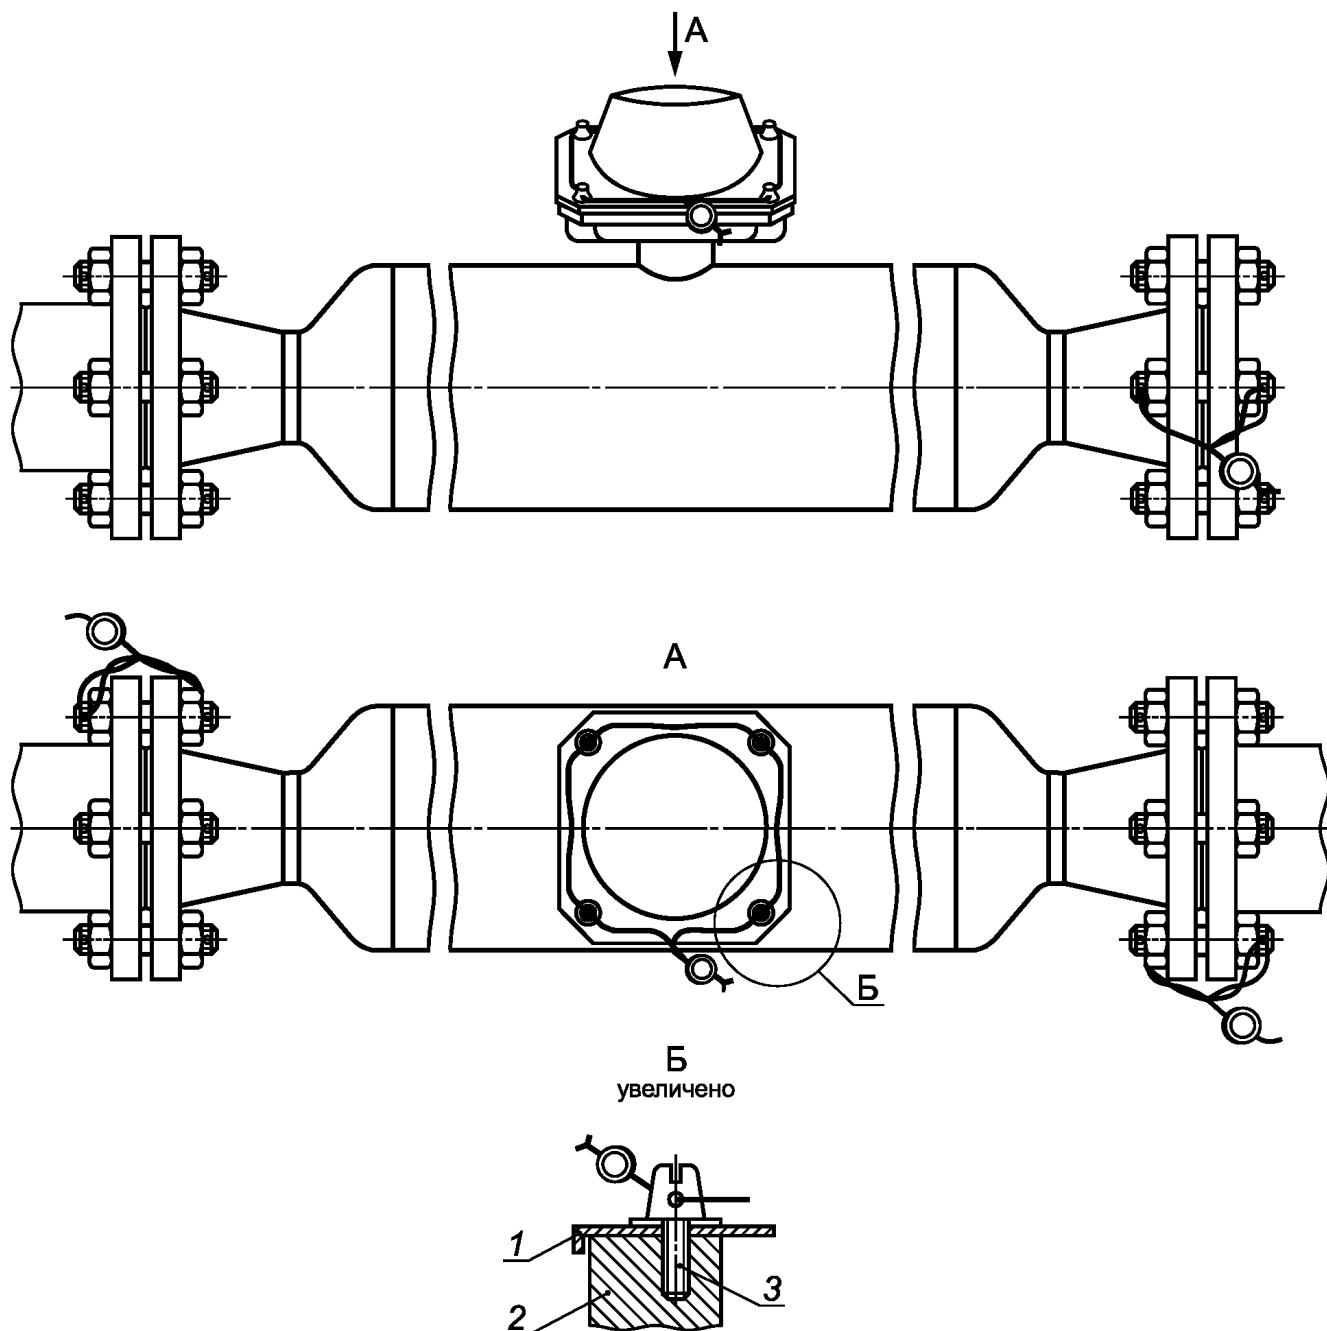

1 — крышка соединительной коробки; 2 — корпус соединительной коробки; 3 — крепежный винт под контровочную проволоку

Рисунок Б.10 — Счетчик-расходомер массовый Micro Motion модель Т 025 (050,100,150), выполненный с соединительной коробкой, фирмы «Emerson Process Management, Fisher—Rosemount»


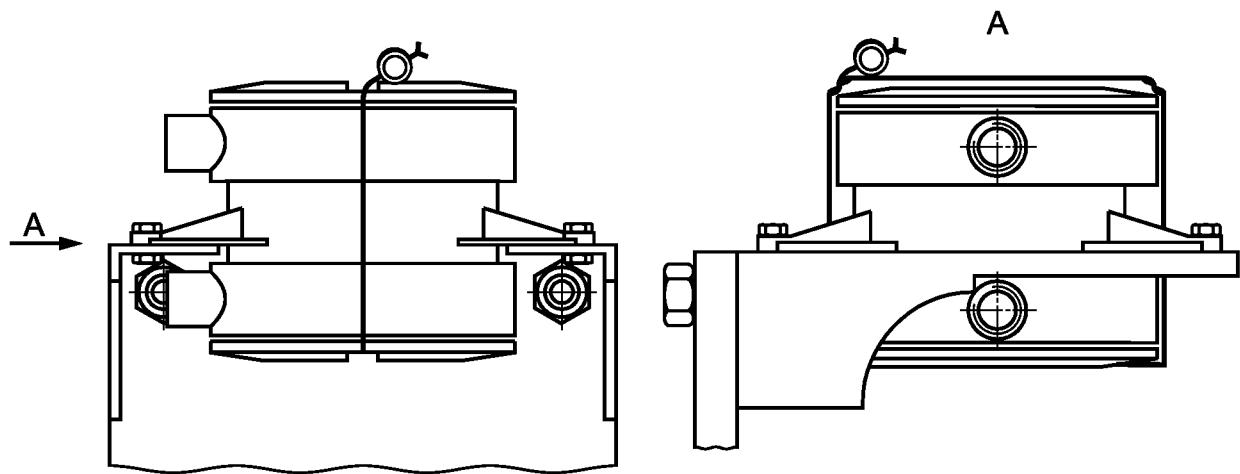


Рисунок Б.11 — Преобразователь измерительный RFT счетчика-расходомера массового Micro Motion фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount»

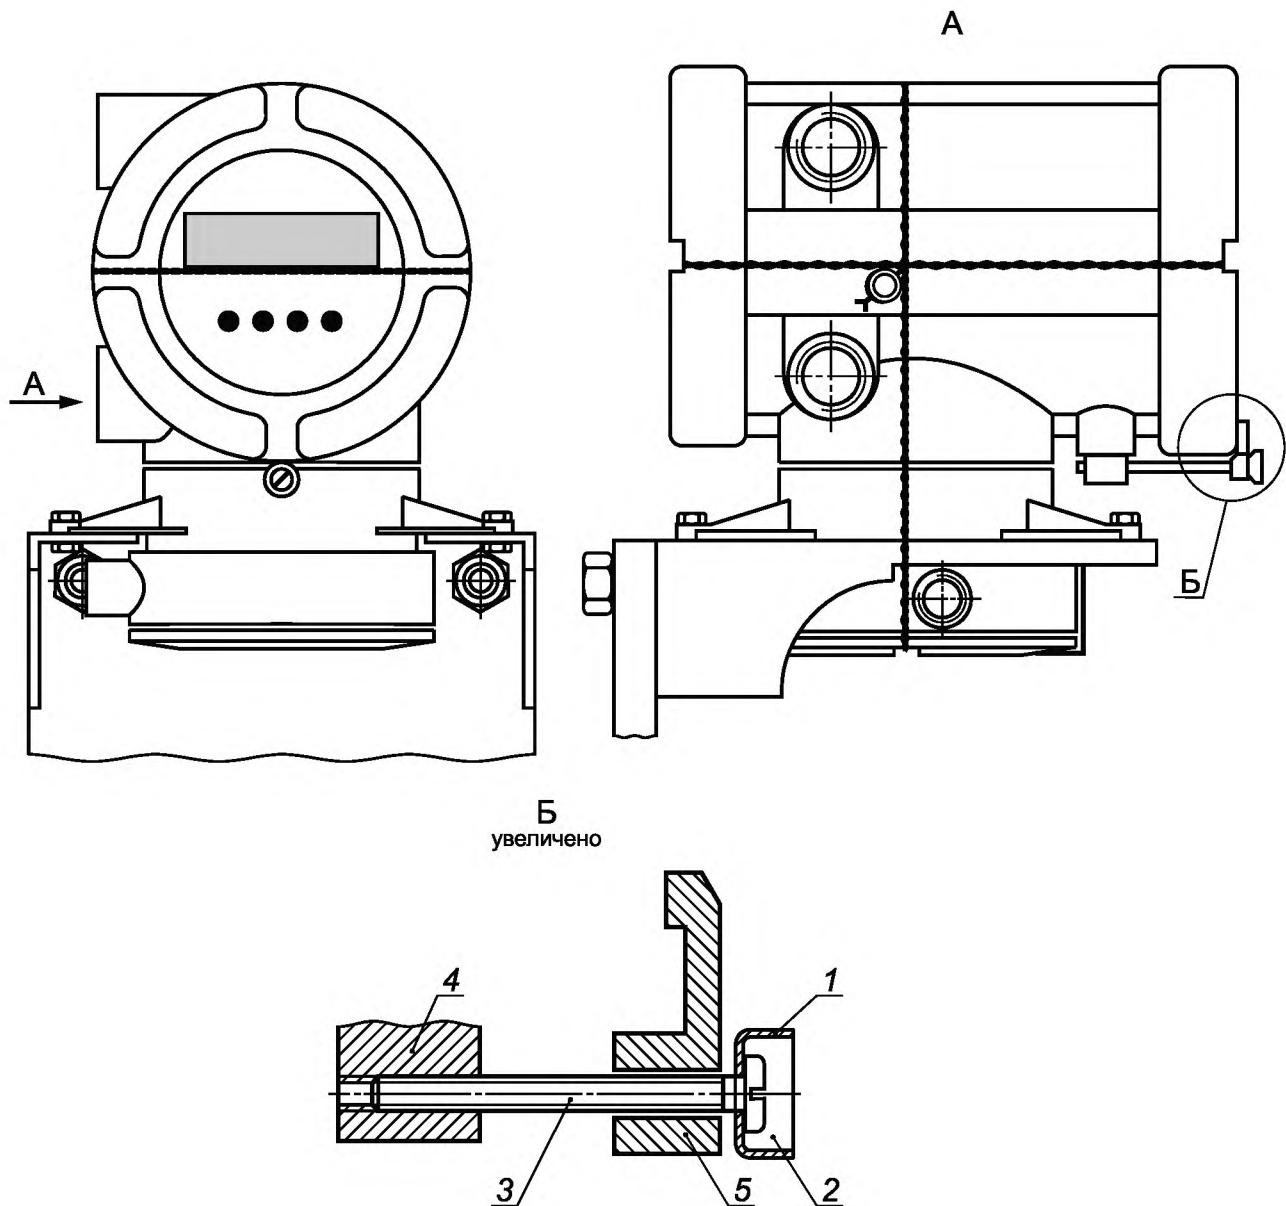

1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — корпус прибора; 5 — зажим

Рисунок Б.12 — Преобразователь измерительный RFT с трансмиттером счетчика-расходомера
массового Micro Motion фирмы «Emerson Process Management, Fisher-Rosemount»

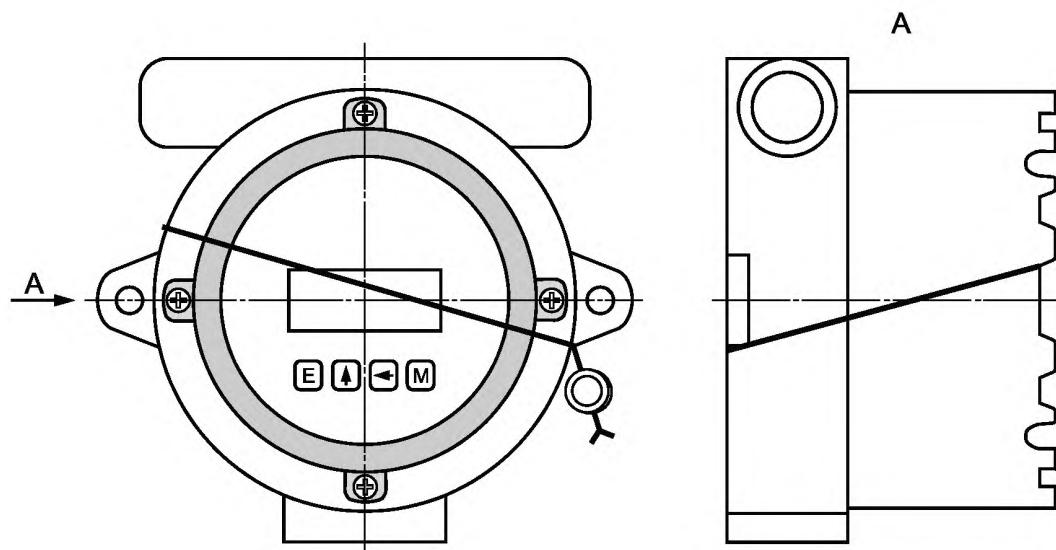


Рисунок Б.13 — Прибор вторичный счетчиков жидкости турбинных MRT 97 фирмы «Daniel»

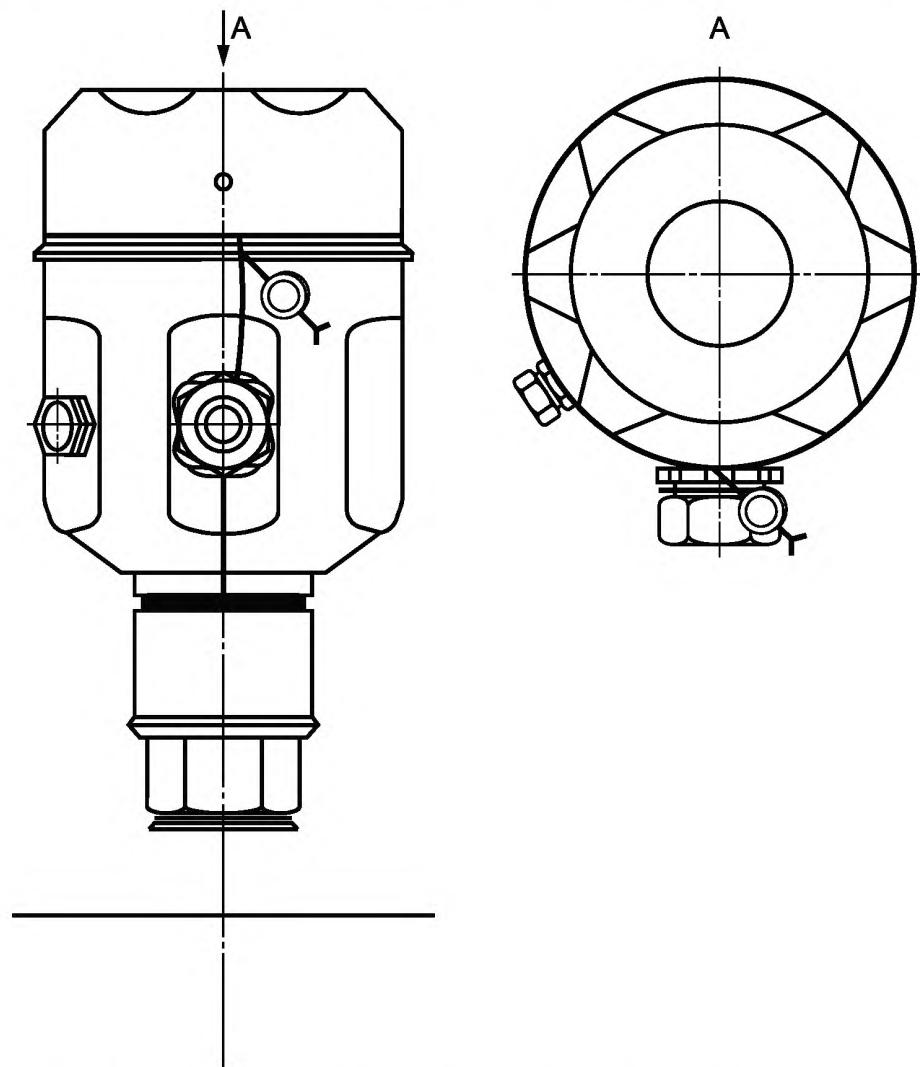


Рисунок Б.14 — Преобразователь давления измерительный Cerabar M фирмы «Endress+Hauser GmbH+Co» 39
30

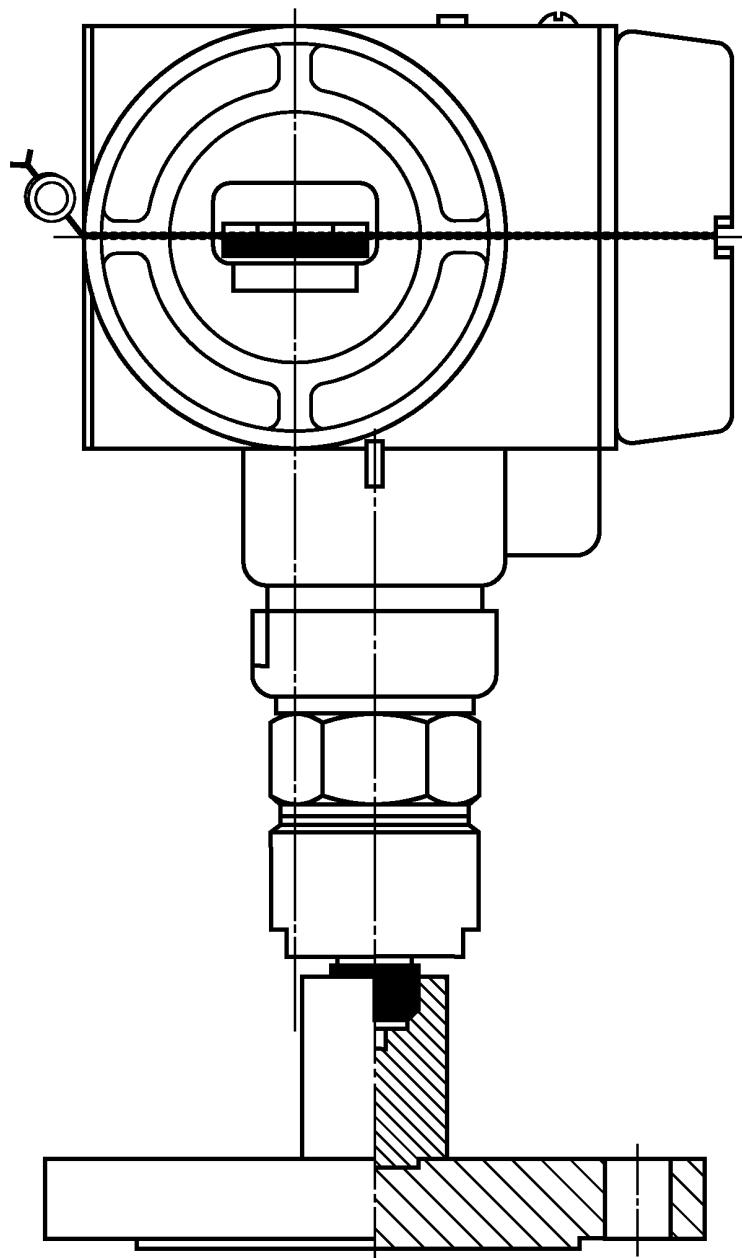


Рисунок Б.15 — Преобразователь давления измерительный Cerabar S с изолирующей диафрагмой и фланцем
фирмы «Endress+Hauser GmbH+Co. KG40»

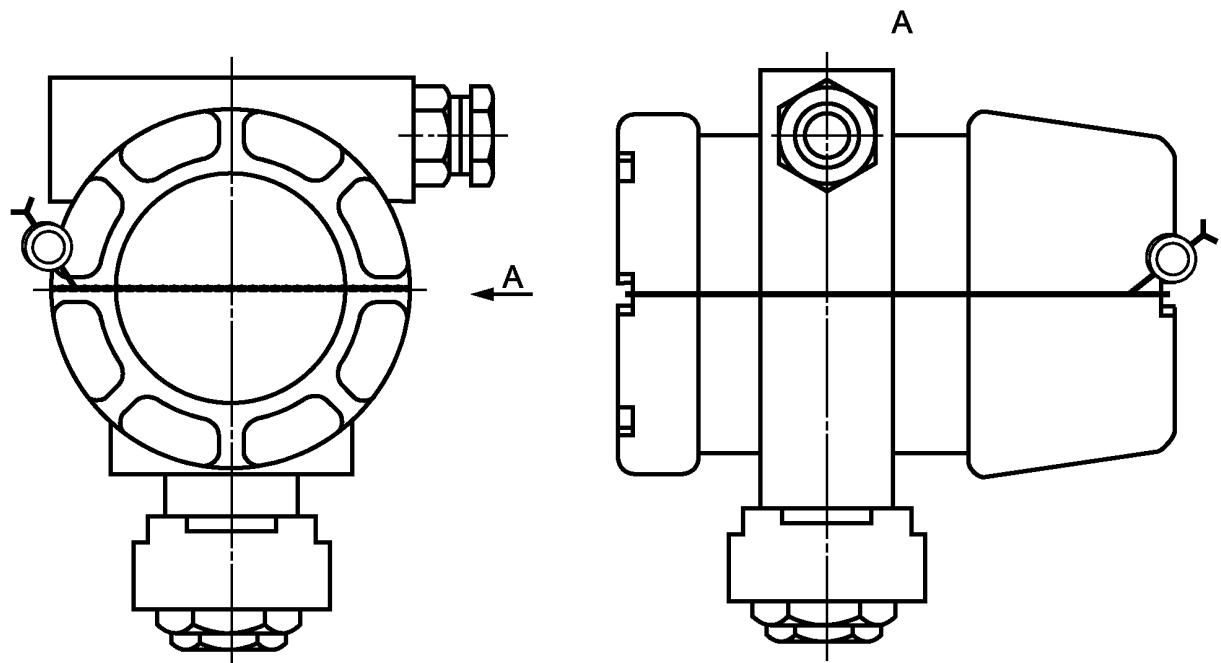


Рисунок Б.16 — Датчик давления МЕТРАН-100 группы предприятий МЕТРАН

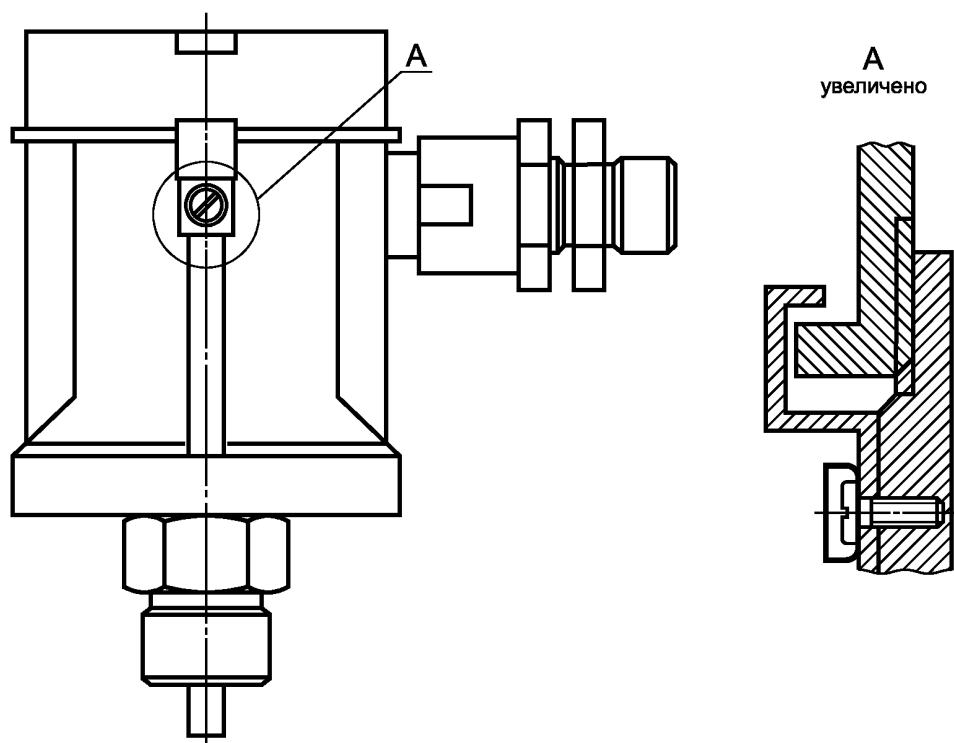


Рисунок Б.17 — Датчик давления МЕТРАН-55-Вн, группы предприятий МЕТРАН

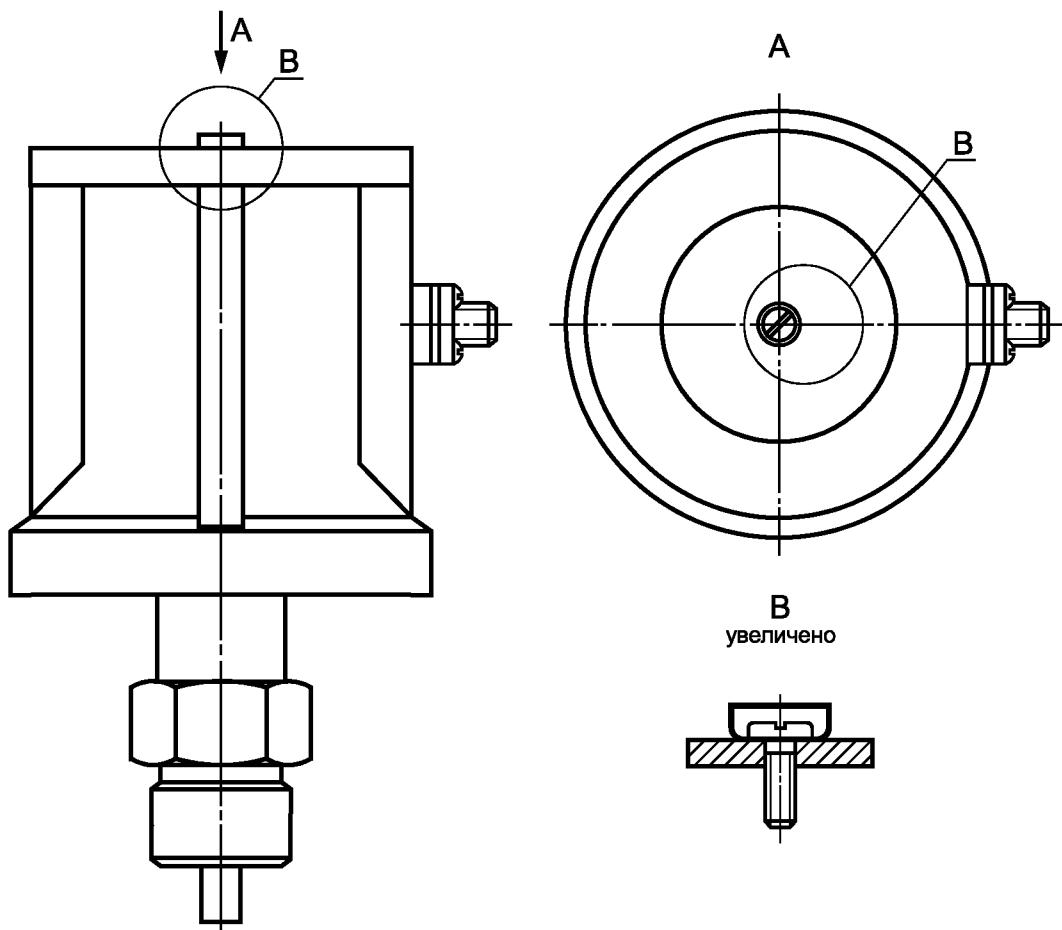


Рисунок Б.18 — Датчик давления МЕТРАН-55-Д, МЕТРАН-55-Ex-Д, группы предприятий МЕТРАН

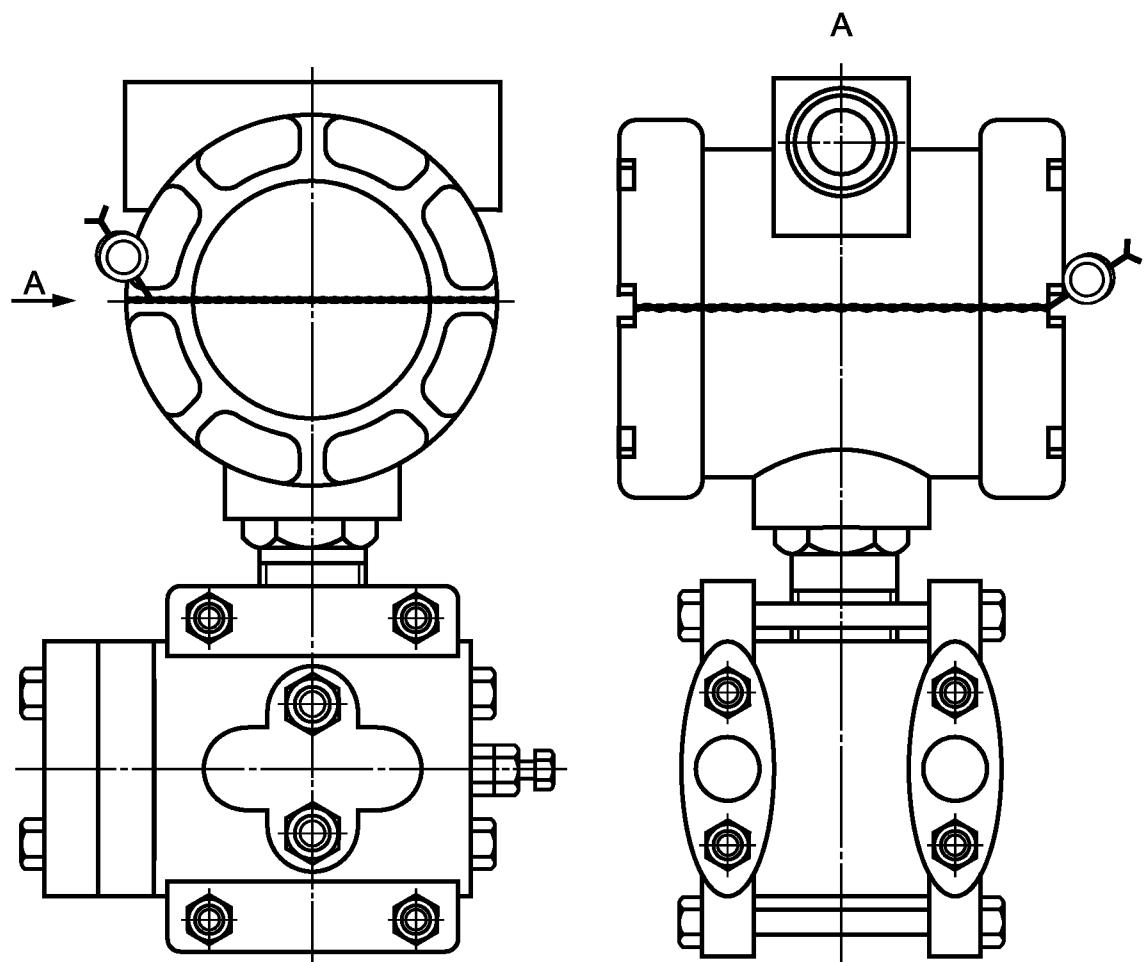


Рисунок Б.19 — Датчик давления 1151 фирмы «Fisher-Rosemount MFG CmbH & Co. OHG»

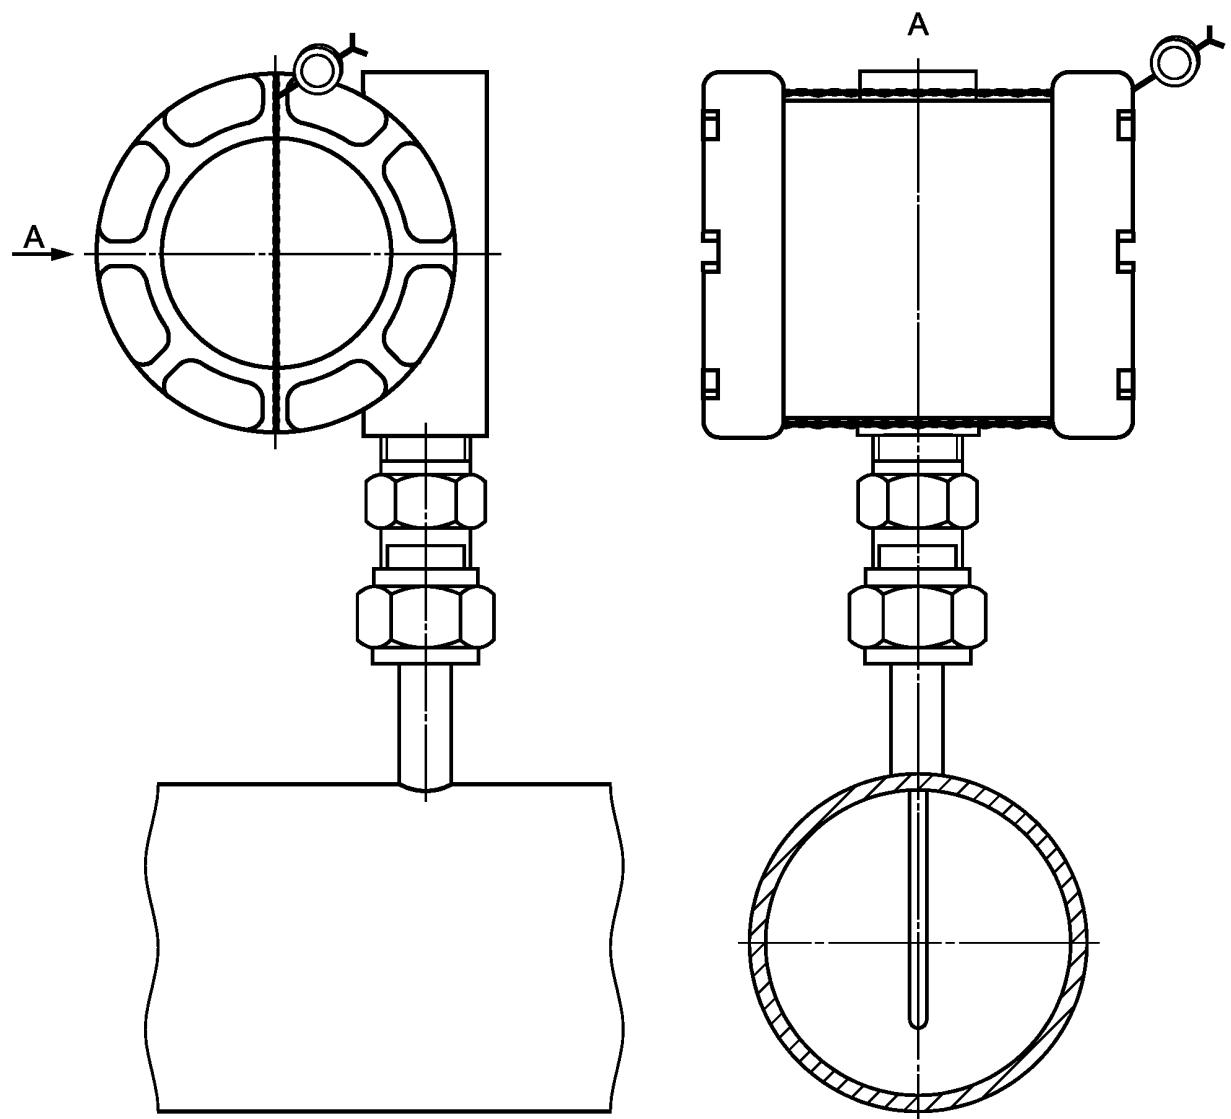


Рисунок Б.20 — Преобразователи измерительные 244, 644, 3144 к датчикам температуры
фирмы «Fisher-Rosemount»



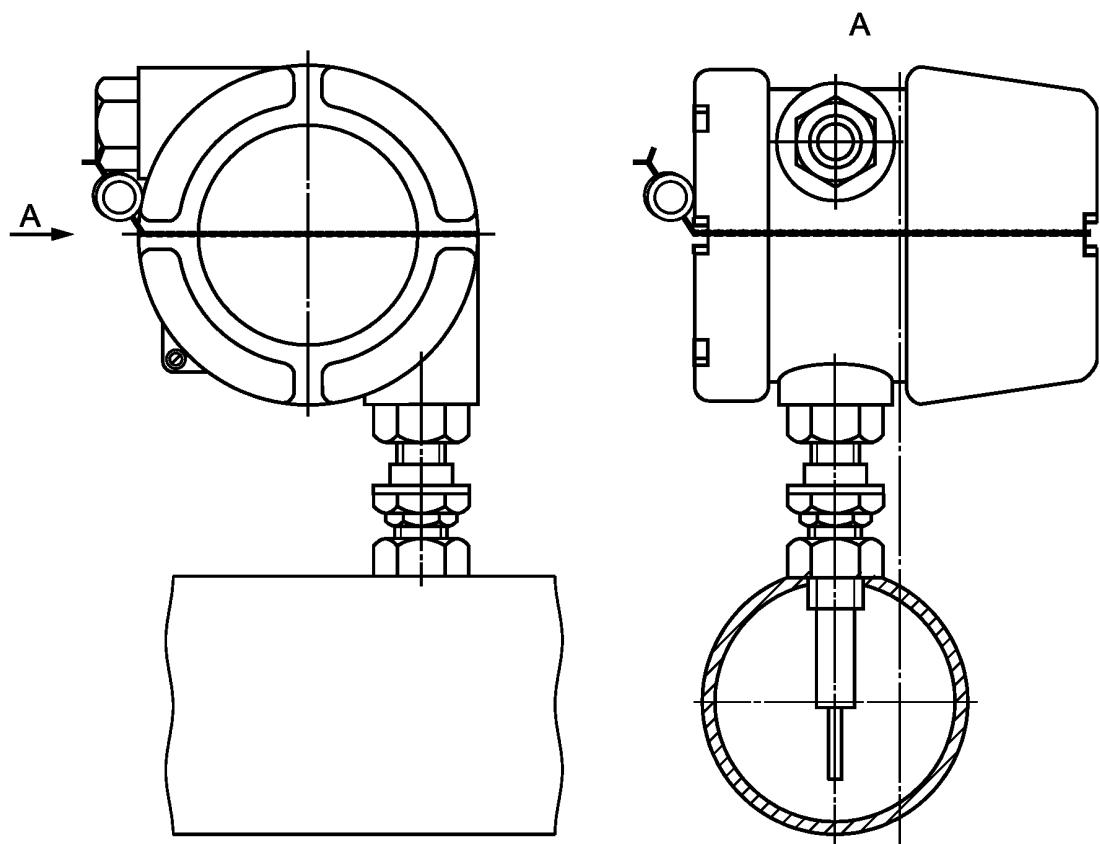


Рисунок Б.21 — Преобразователь температуры измерительный RTT20 фирмы «The Foxboro Company»

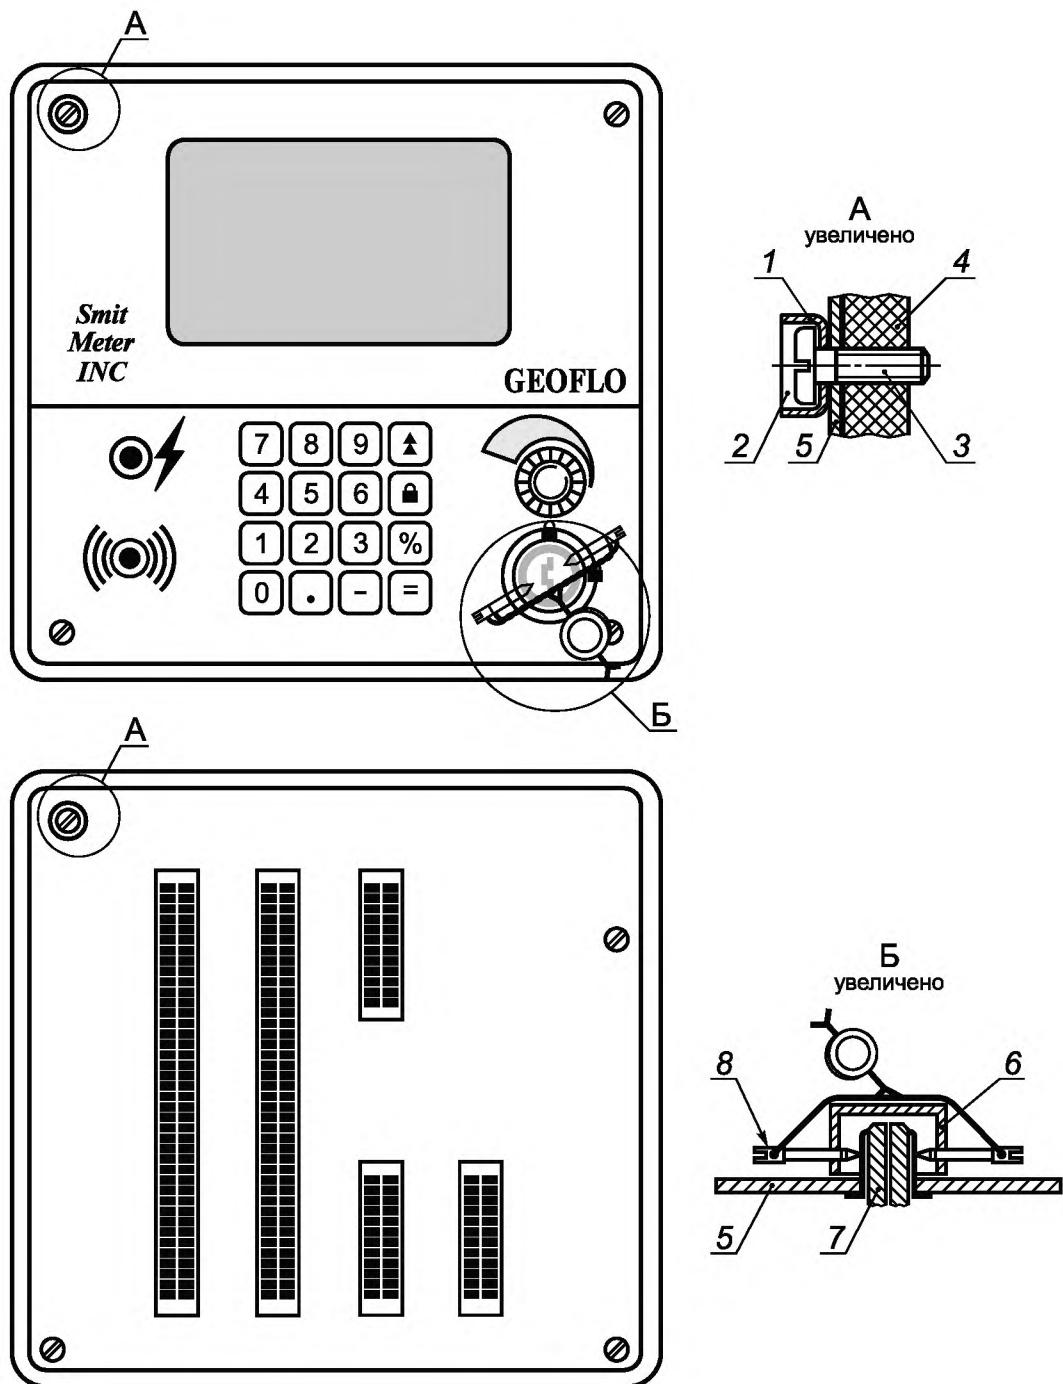


1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — передняя крышка прибора;
5 — корпус прибора; 6 — корпус замка; 7 — крышка; 8 — зажимные винты

Рисунок Б.22.1 — Вычислитель расхода GeoFlo и GeoProv фирмы «Smith Meter Inc.». Вариант пломбирования 1

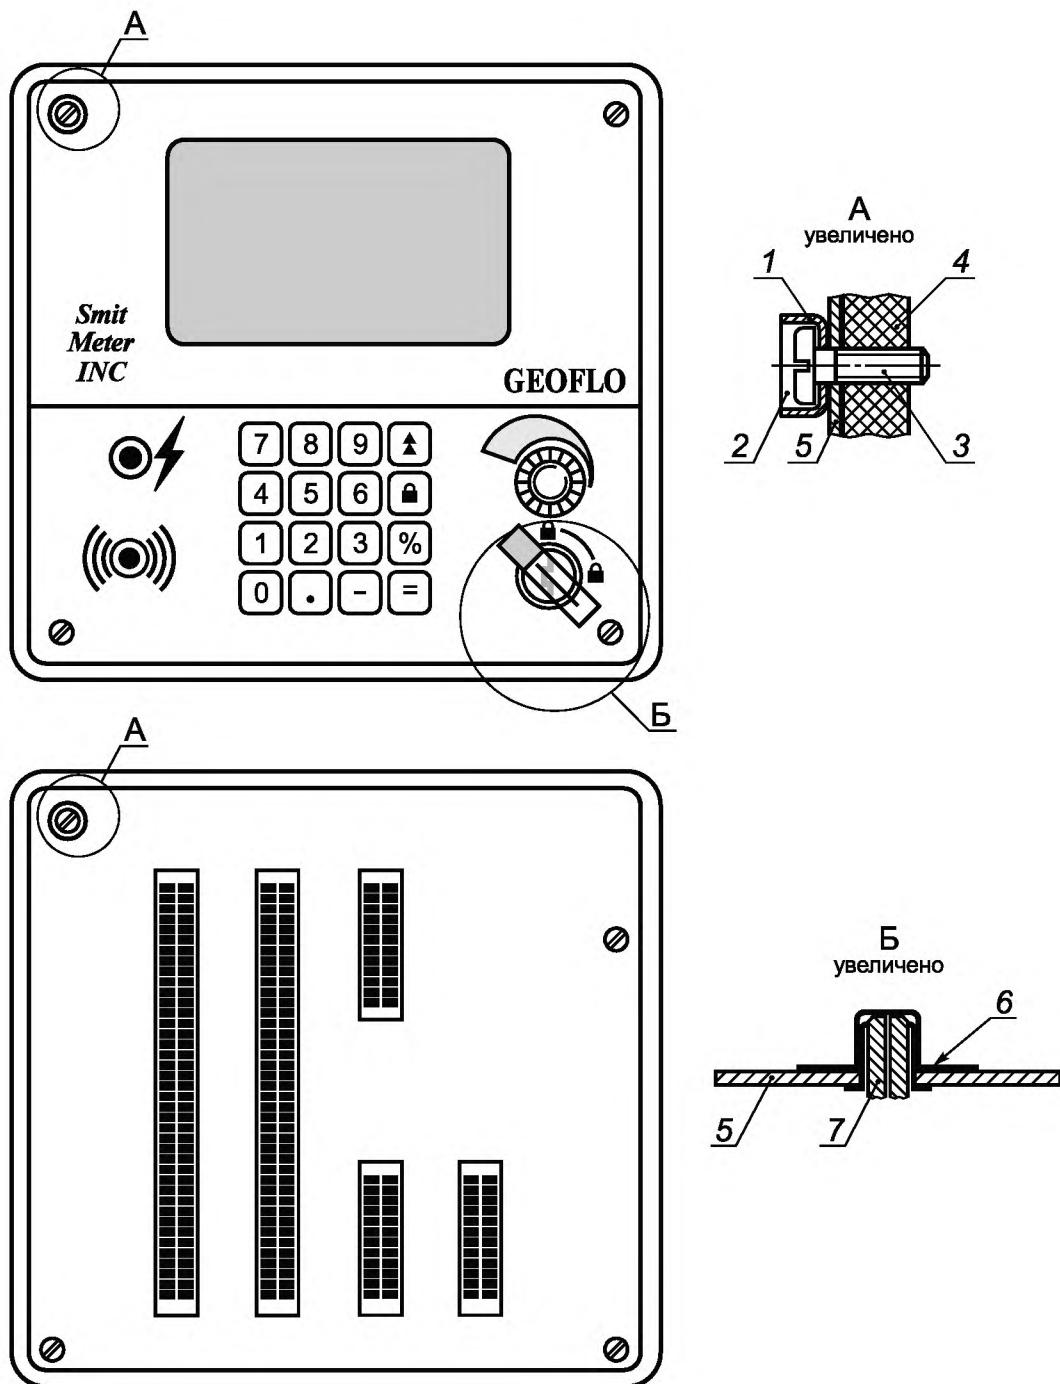


1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — передняя крышка прибора; 5 — корпус прибора; 6 — корпус замка; 7 — голограммическая наклейка обслуживающей организации

Рисунок Б.22.2 — Вычислитель расхода GeoFlo и GeoProv фирмы «Smith Meter Inc.». Вариант пломбирования 2

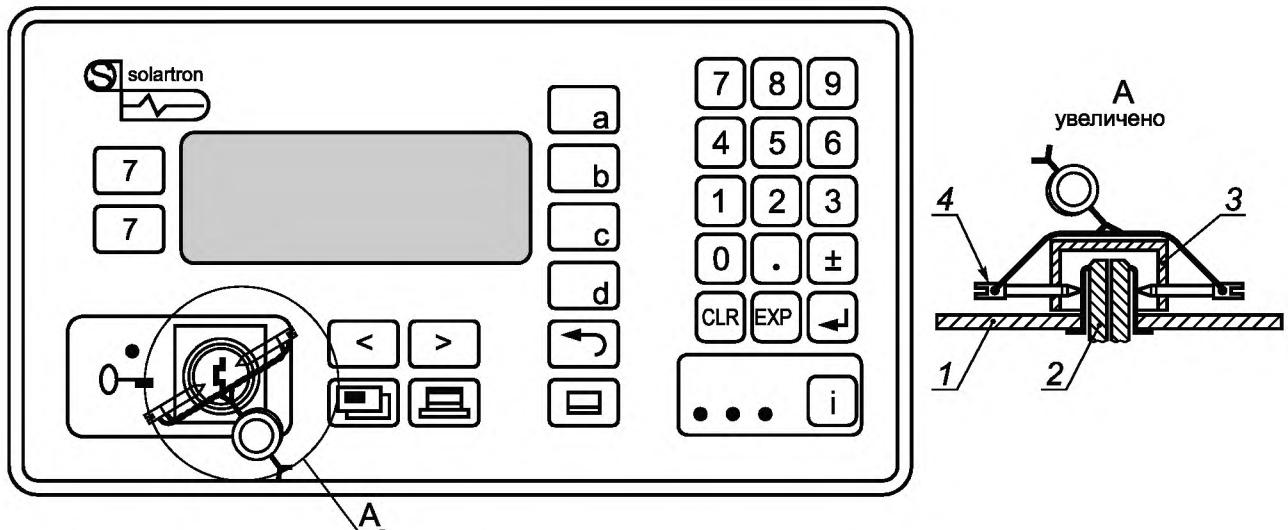


1 — передняя крышка прибора; 2 — корпус замка; 3 — крышка; 4 — зажимные винты

Рисунок Б.23.1 — Устройство измерения параметров жидкости и газа (моделей 7950, 7951, 7955) фирмы «Solartron Mobrey Ltd.». Вариант пломбирования 1

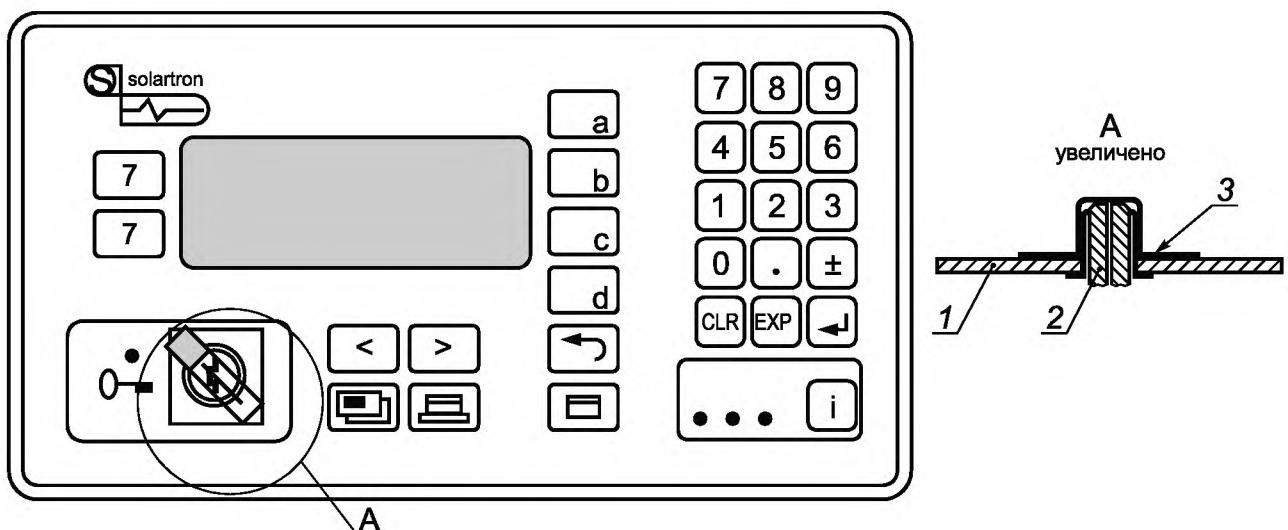



1 — передняя крышка прибора; 2 — корпус замка; 3 — голограммическая наклейка обслуживающей организации

Рисунок Б.23.2 — Устройство измерения параметров жидкости и газа (моделей 7950, 7951, 7955) фирмы «Solartron Mobrey Ltd.». Вариант пломбирования 2

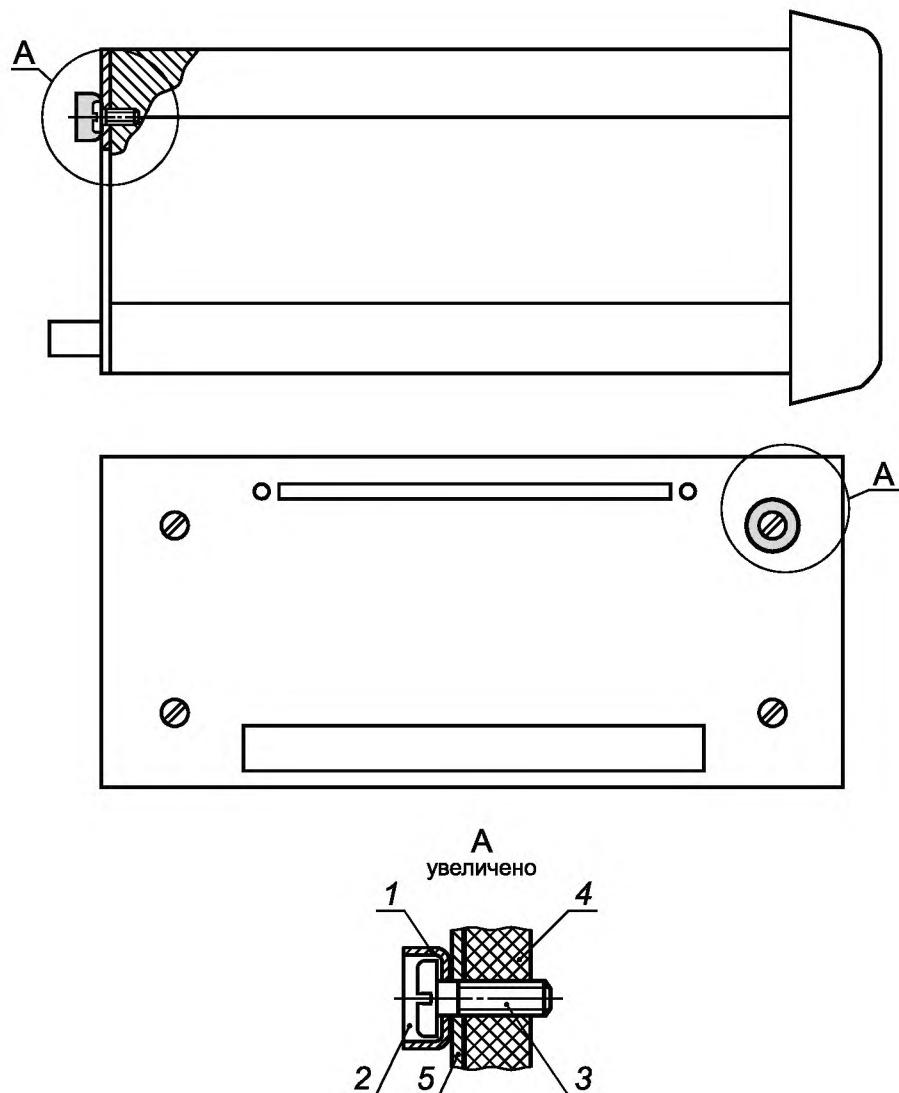



1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — задняя крышка прибора;
5 — корпус прибора

Рисунок Б.24 — Сумматор импульсов LCCC—40 фирмы «Smith Meter Inc.» FMC Energy Systems

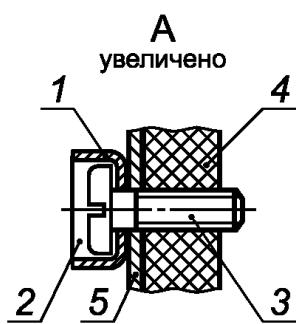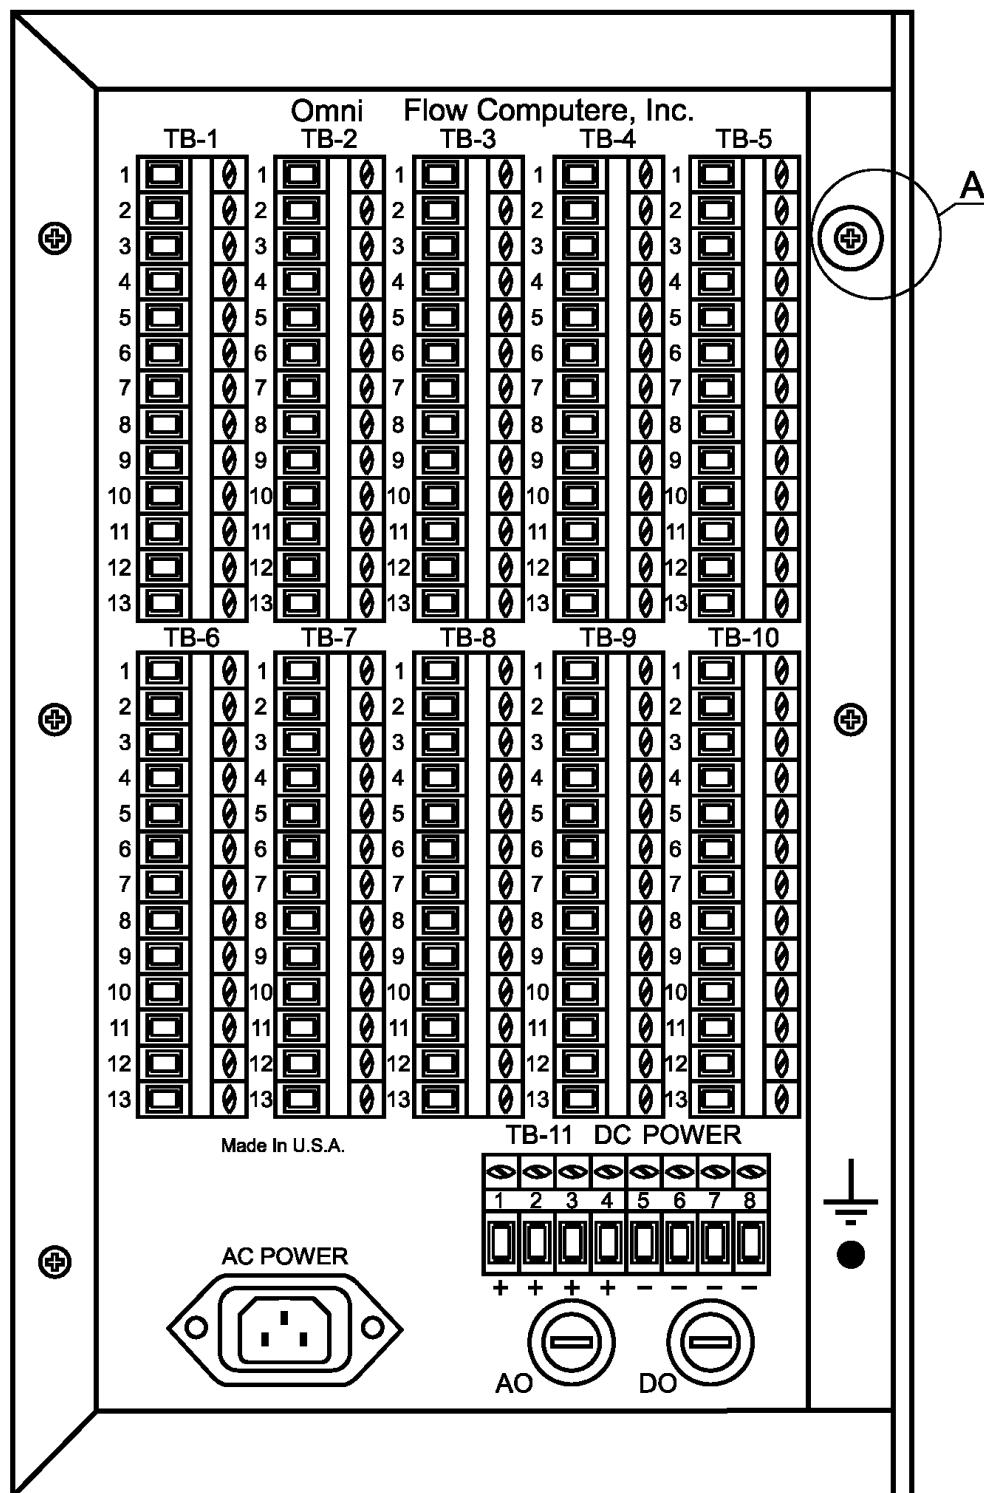


1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — задняя панель; 5 — корпус прибора

Рисунок Б.25 — Измерительно-вычислительный контроллер OMNI-6000 фирмы «OMNI FLOW COMPUTERS, INC»

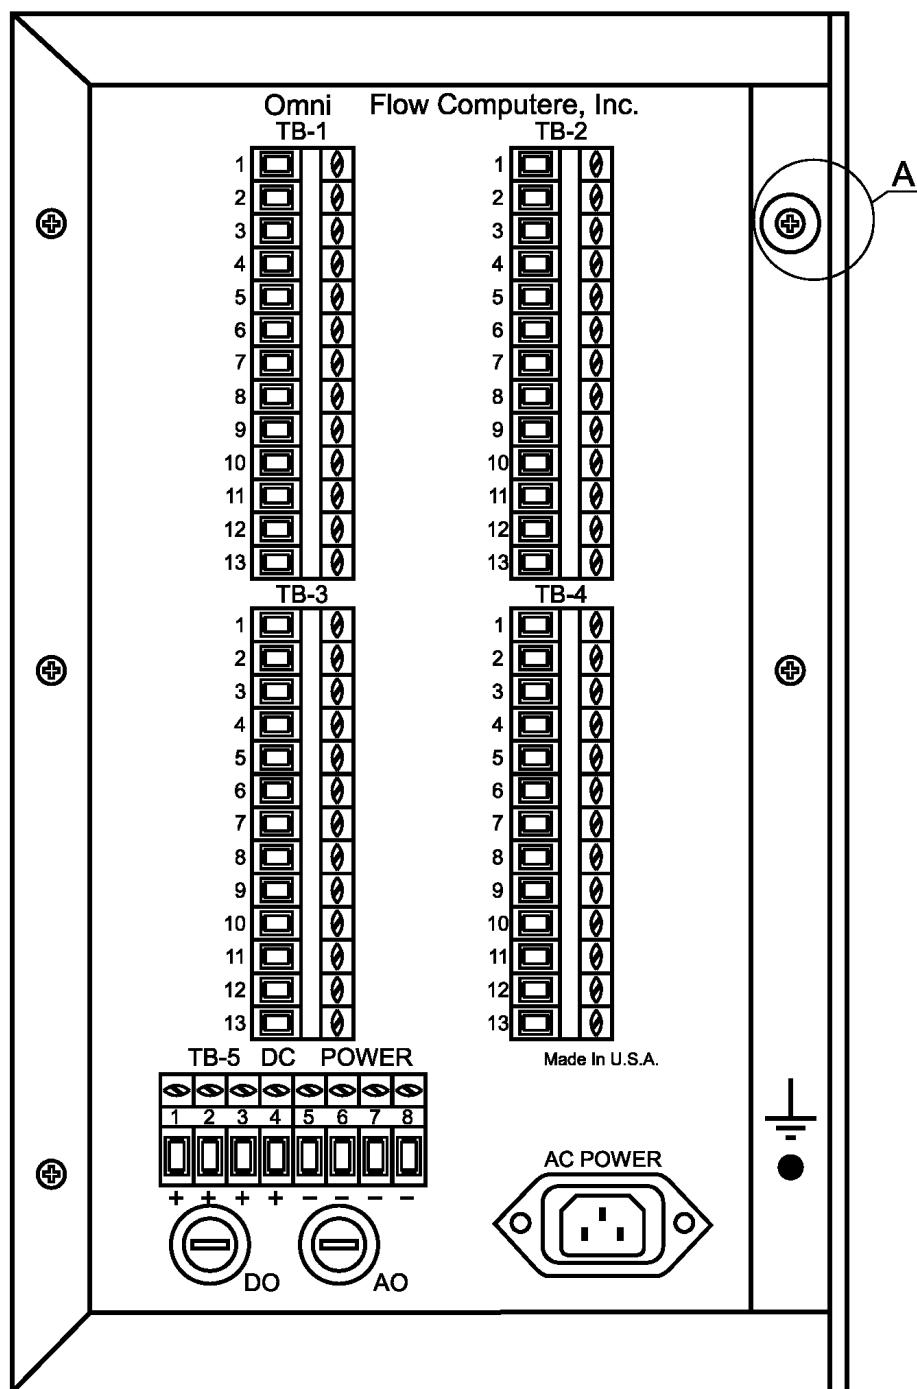

1 — шайба чашеобразная M5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт M4; 4 — задняя панель; 5 — корпус прибора

Рисунок Б.26 — Измерительно-вычислительный контроллер OMNI—3000
фирмы «OMNI FLOW COMPUTERS. MC»

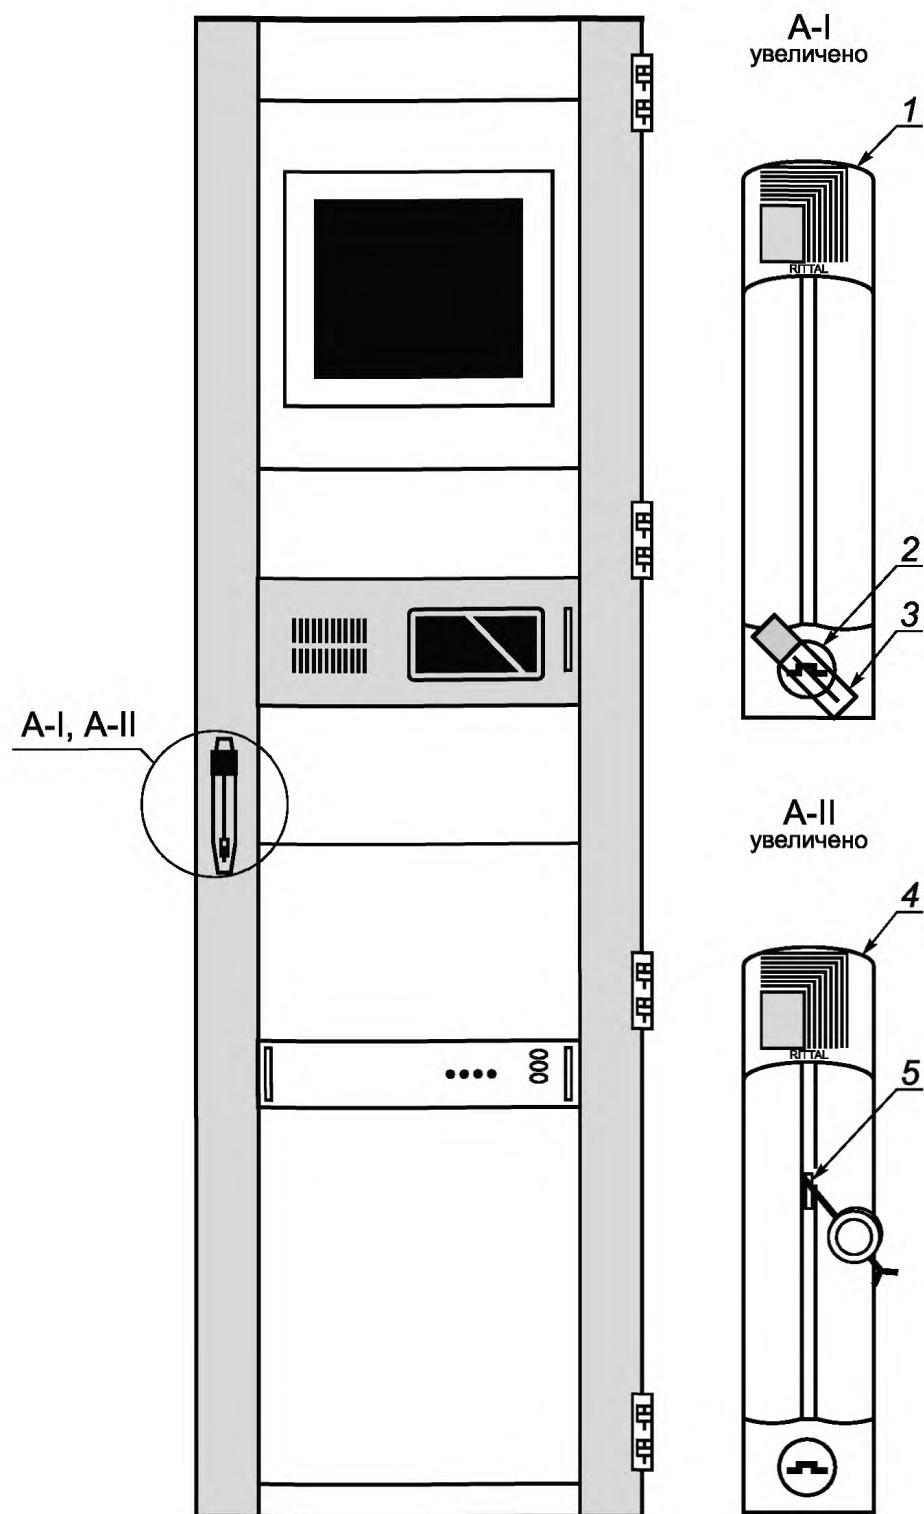


1 — корпус ручки Rittal 8611.020; 2 — вставка замка; 3 — голограммическая наклейка обслуживающей организации;
4 — корпус ручки Rittal 8611.290; 5 — дополнительная планка с отверстием для установки пломбы

П р и м е ч а н и я


- 1 А-І Пломбирование на стандартную ручку фирмы «Rittal» с использованием голограммической наклейки.
- 2 А-ІІ Пломбирование на ручку фирмы «Rittal» со специальным отверстием для установки пломбы.

Рисунок Б.27 — Измерительно-вычислительный комплекс модели «ИМЦ-03» ОАО «ИМС»

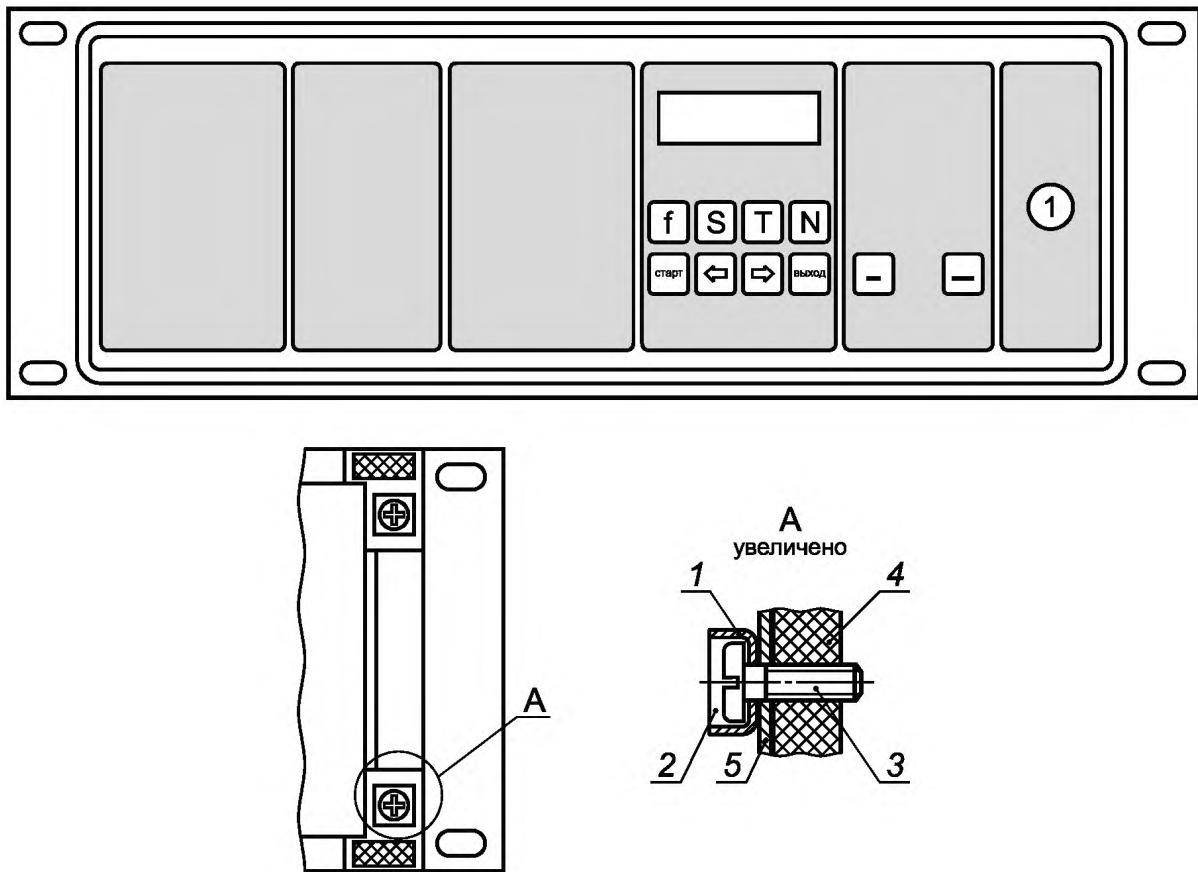

1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — панель задняя; 5 — корпус прибора

Рисунок Б.28 — Прибор поверки эталонный «ПУЛЬСАР—01Э» ООО «ПТП ЭРА—1».
Лицевая панель прибора и фрагмент задней панели прибора

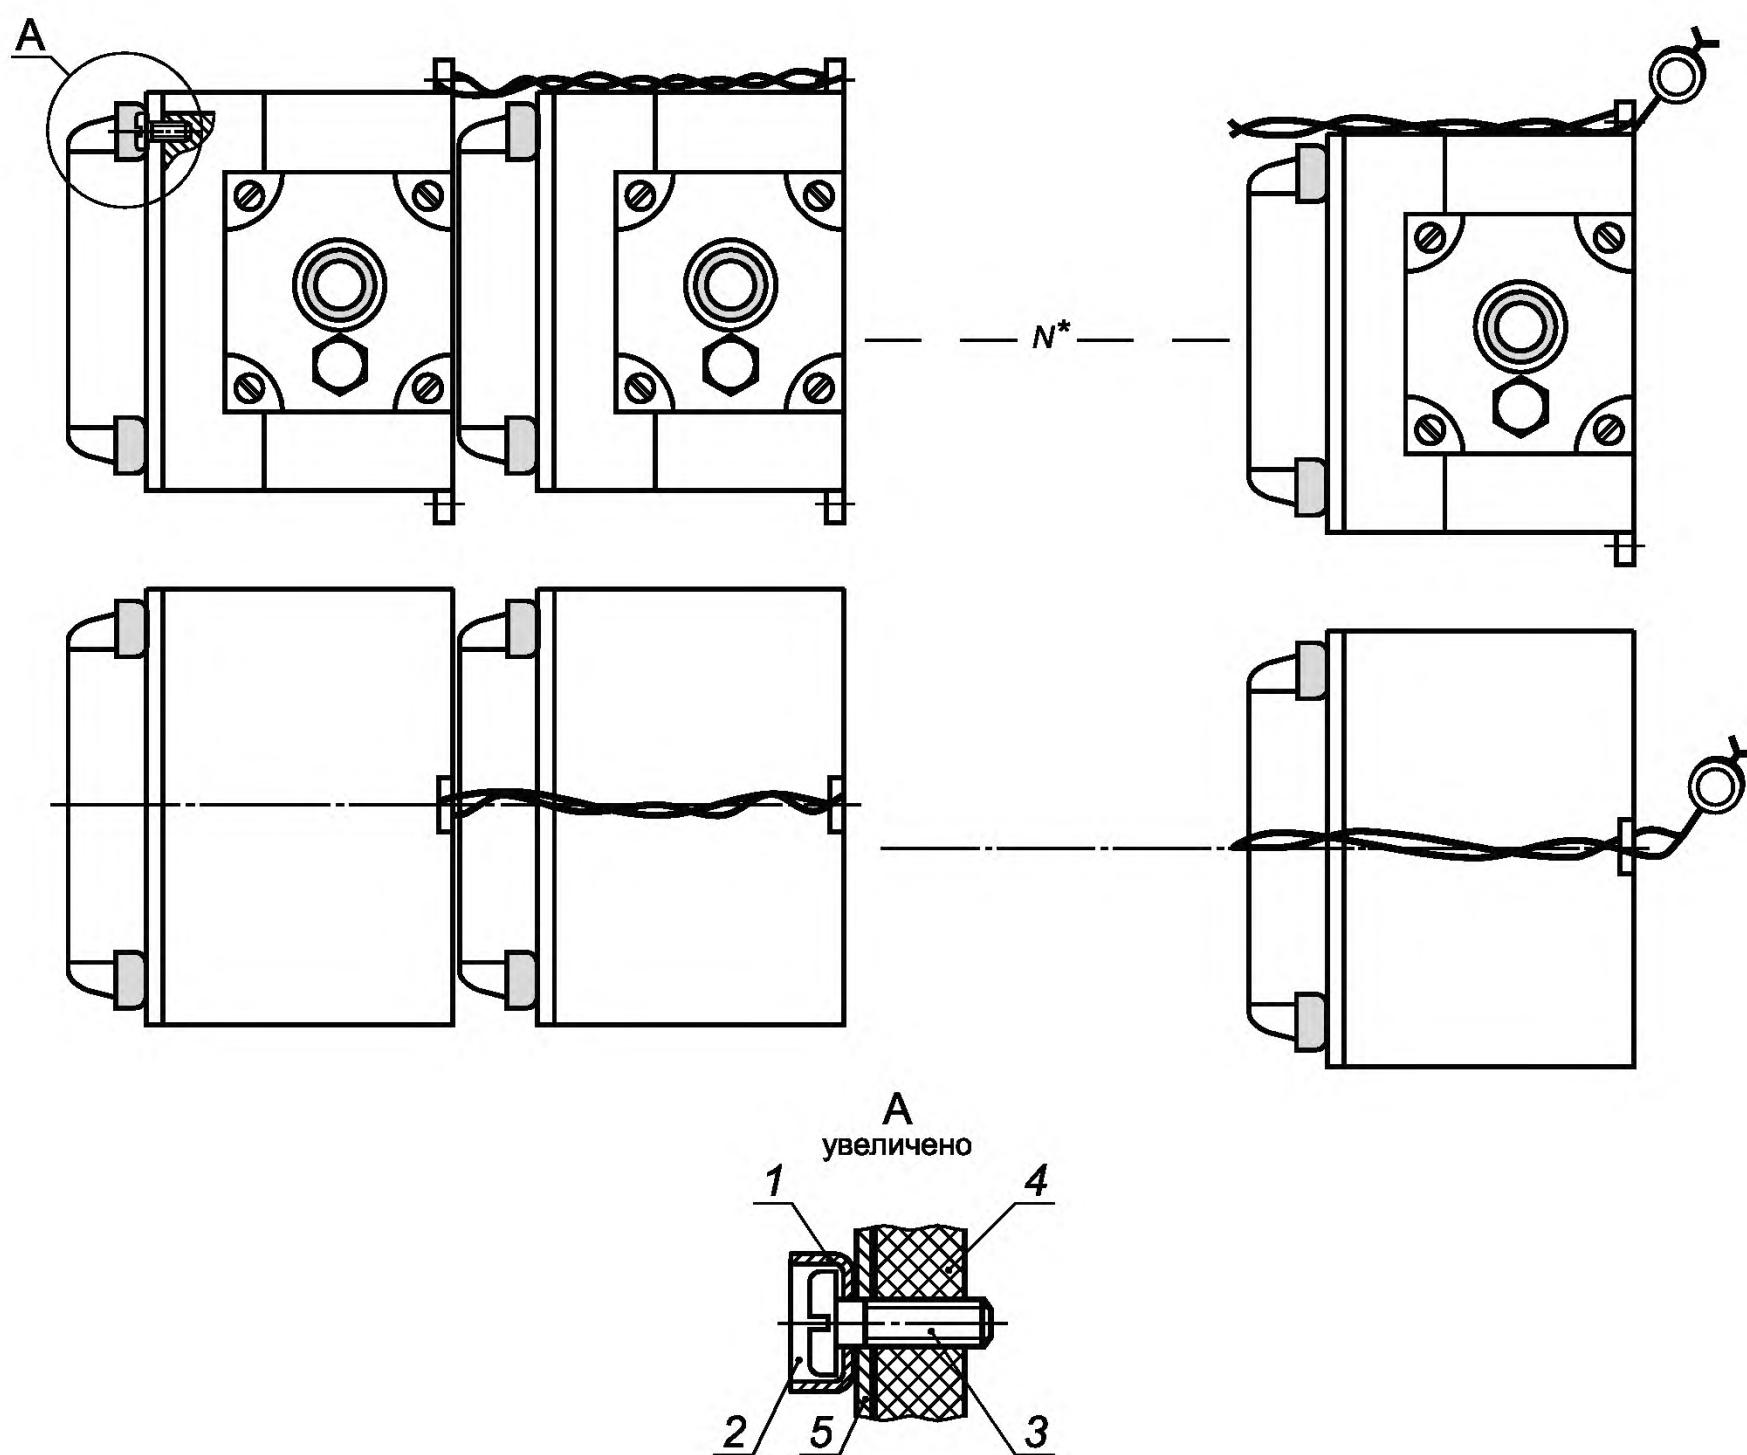


Для модели ИВК-Н количество модулей равно 6

Для модели ИВК-Т количество модулей равно 4

1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — лицевая панель прибора;
5 — корпус прибора

Рисунок Б.29 — Измерительно-вычислительный комплекс ИВК-Н ИПФ «Турбулент»

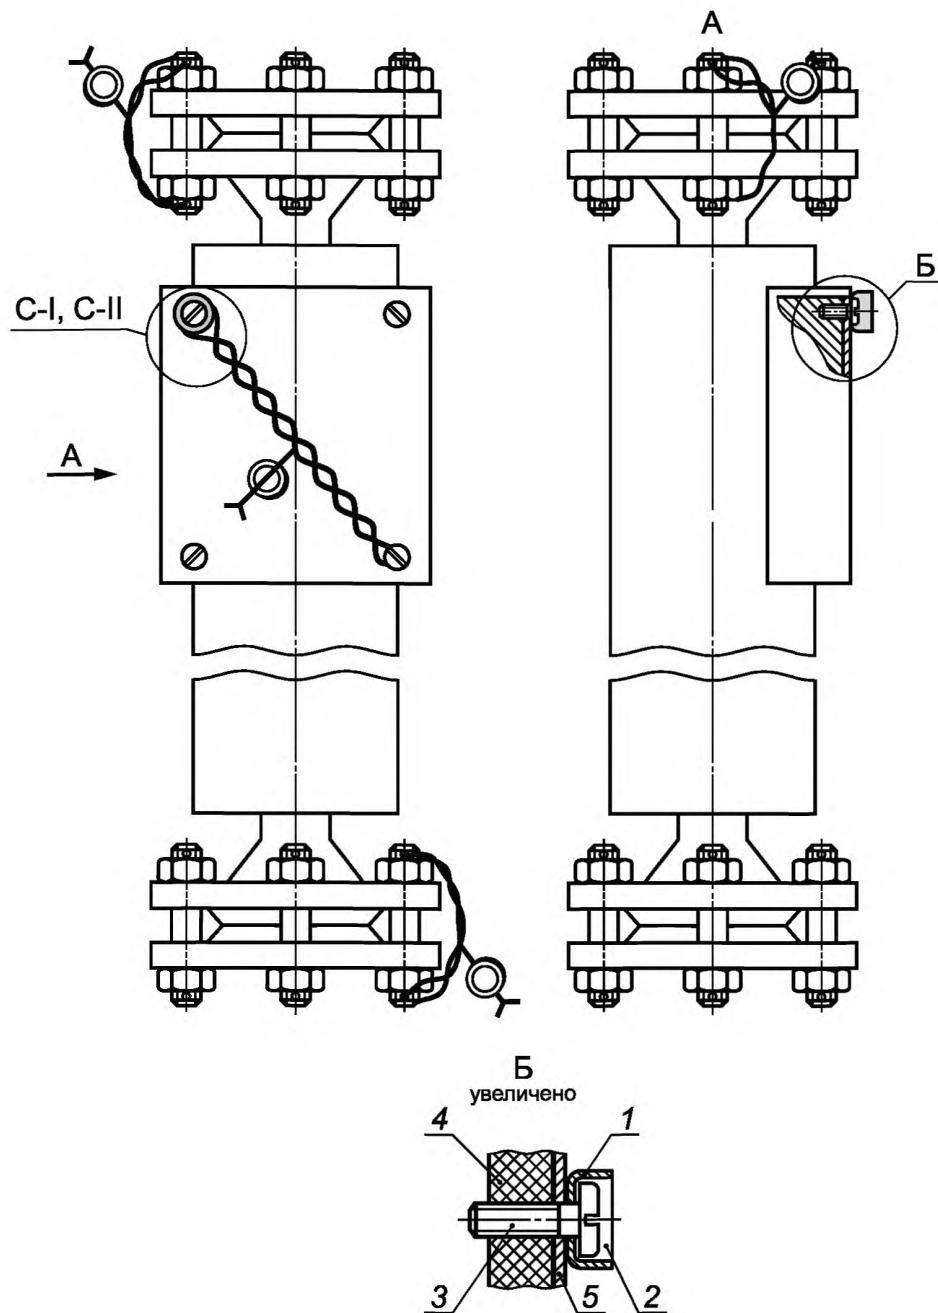

1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — задняя крышка прибора; 5 — корпус прибора

Примечания

- 1 С—I Оттиск клейма на пломбировочную мастику, нанесенную на винт с чашкой на крышке электронного блока.
- 2 С—II Оттиск клейма на пломбу, установленную на контрольной проволоке, пропущенной по диагонали крышки через отверстия в винтах.

Рисунок Б.30 — Преобразователь плотности жидкости измерительный модели 7835
фирмы «Solartron Mobrey Limited»

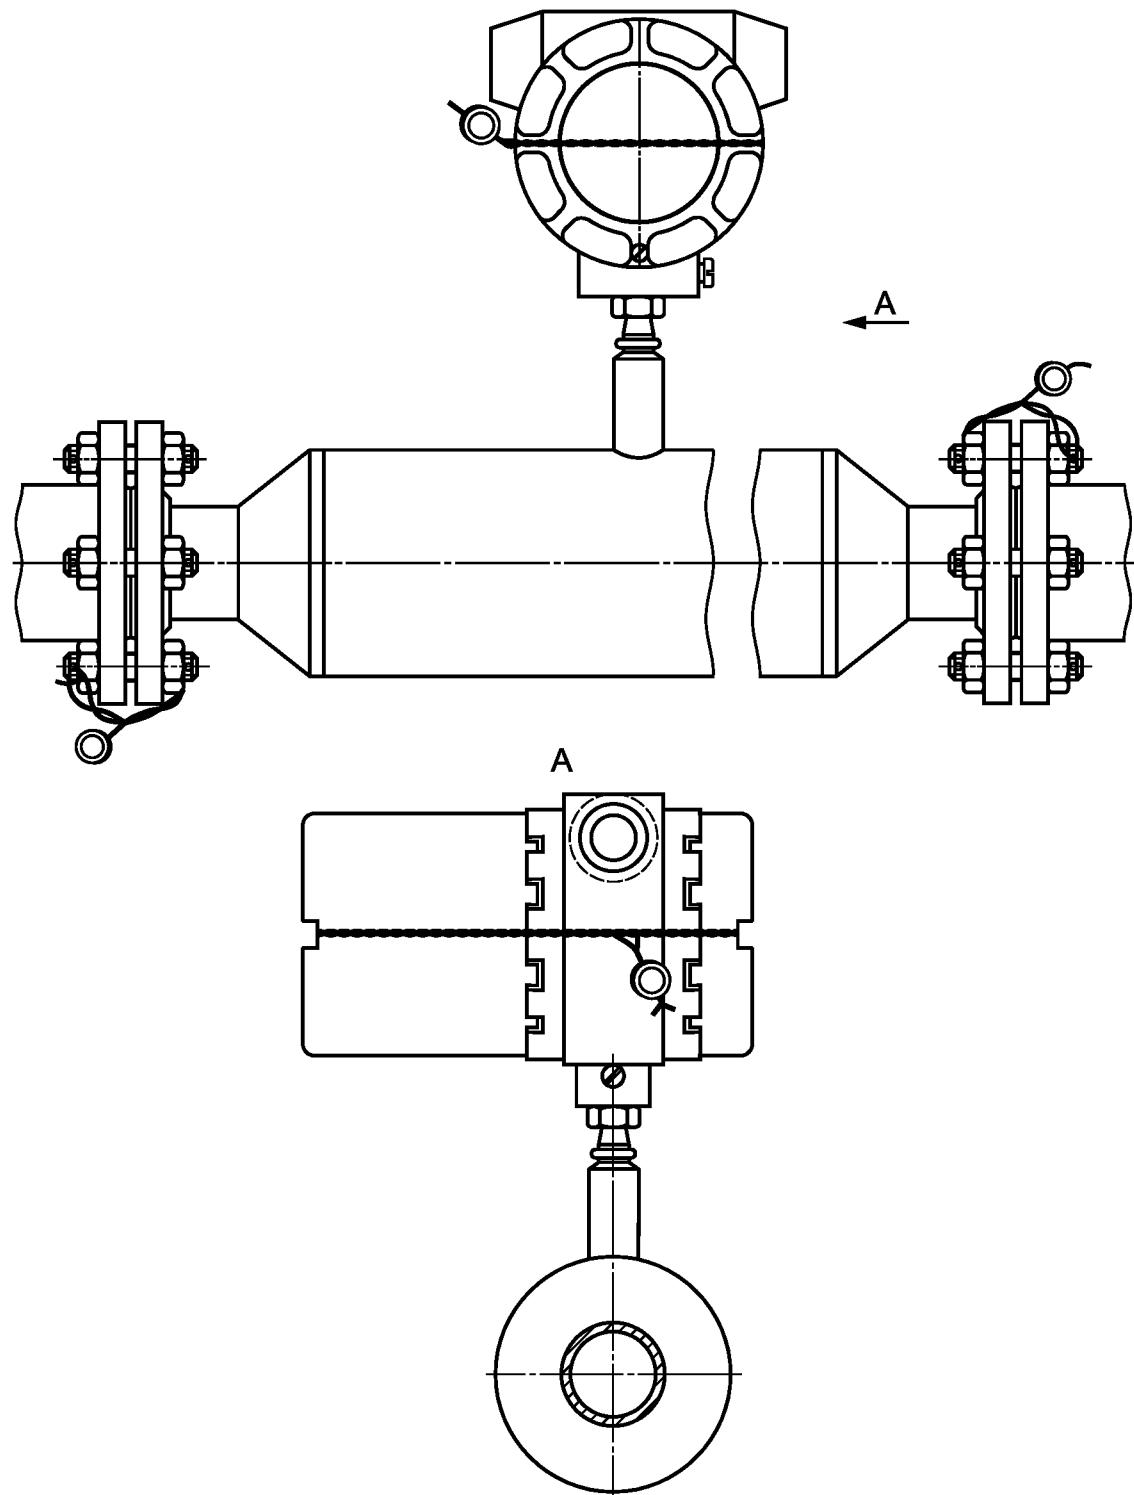


Рисунок Б.31 — Денсиметр SARASOTA модели FD 960 фирмы «Onix Measurement Ltd.»


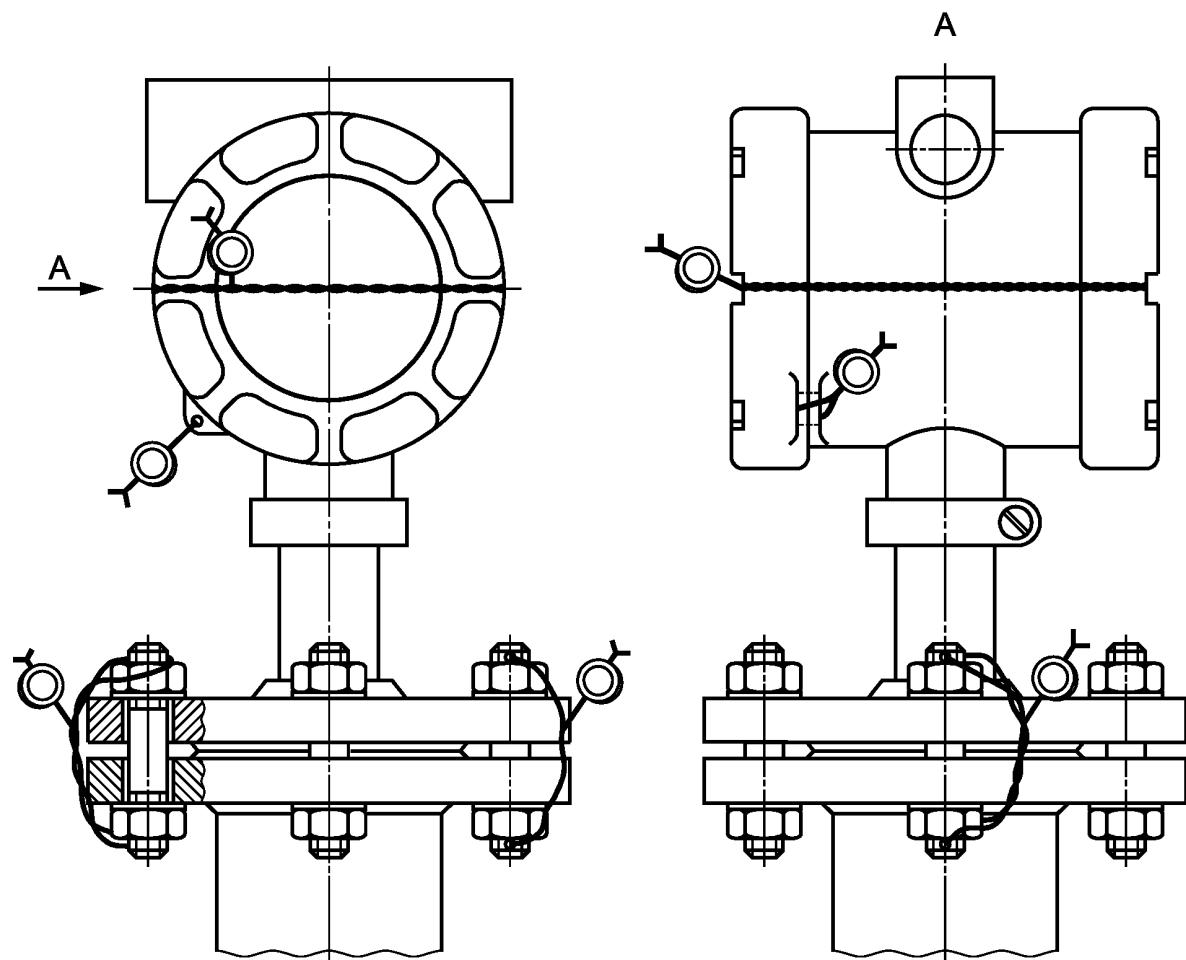


Рисунок Б.32 — Преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные (модели 7827, 7829) фирмы «Solartron Mobrey Limited»

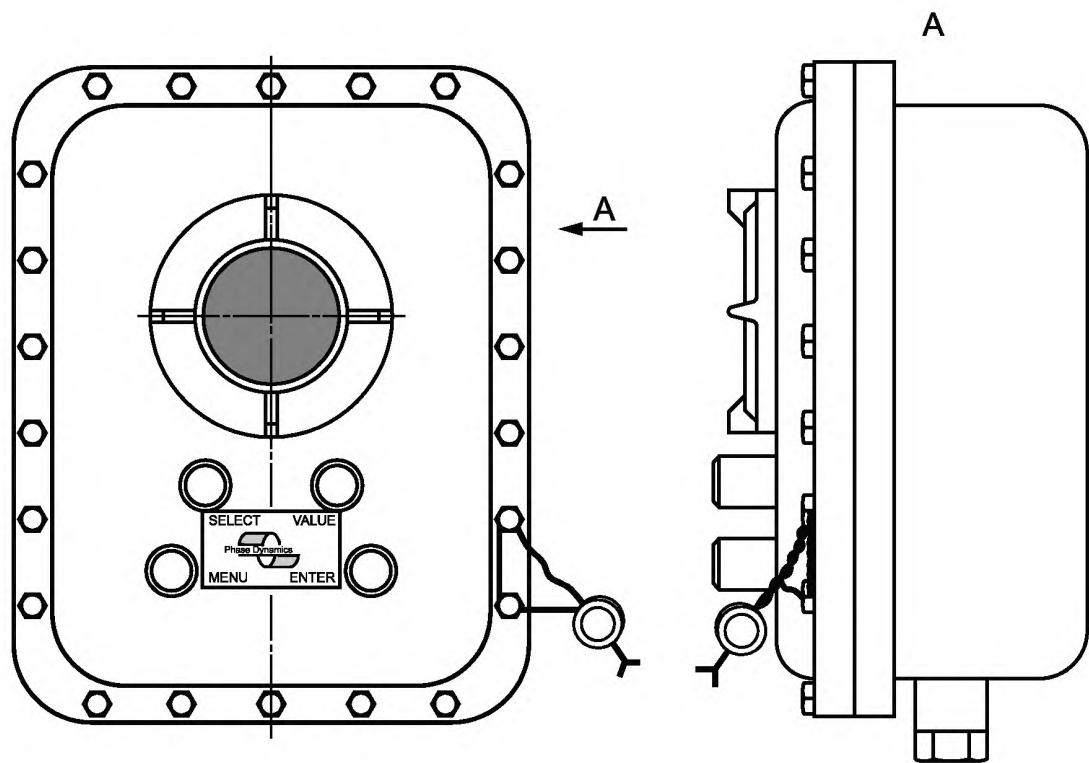

П р и м е ч а н и е — В головке болта предусмотреть отверстие для пропуска пломбировочной проволоки.

Рисунок Б.33 — Блок электронный влагомера поточного фирмы «Phase Dynamics, Inc.»

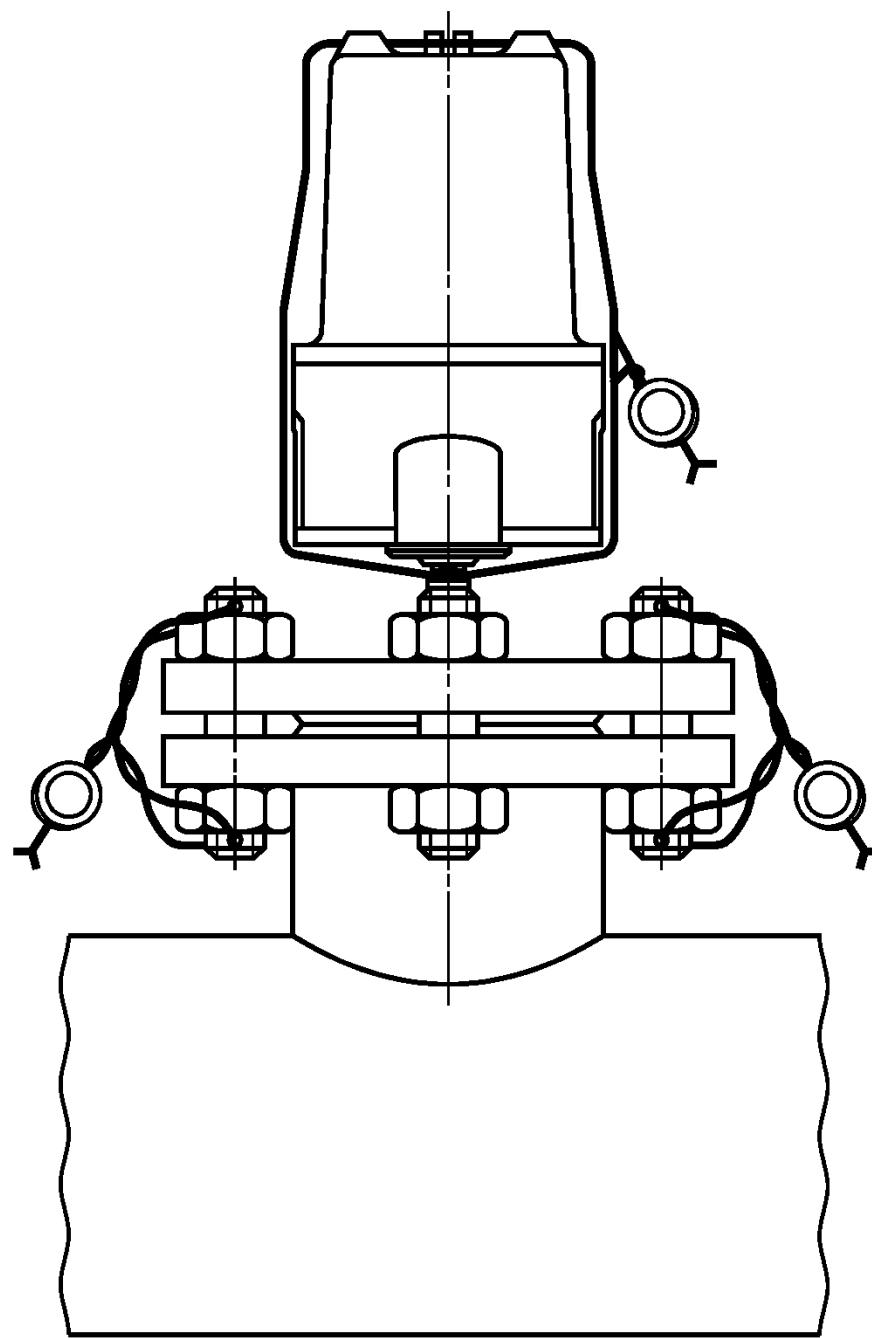


Рисунок Б.34.1 — Влагомер поточный фирмы «Phase Dynamics, Inc.».
Вариант исполнения 1

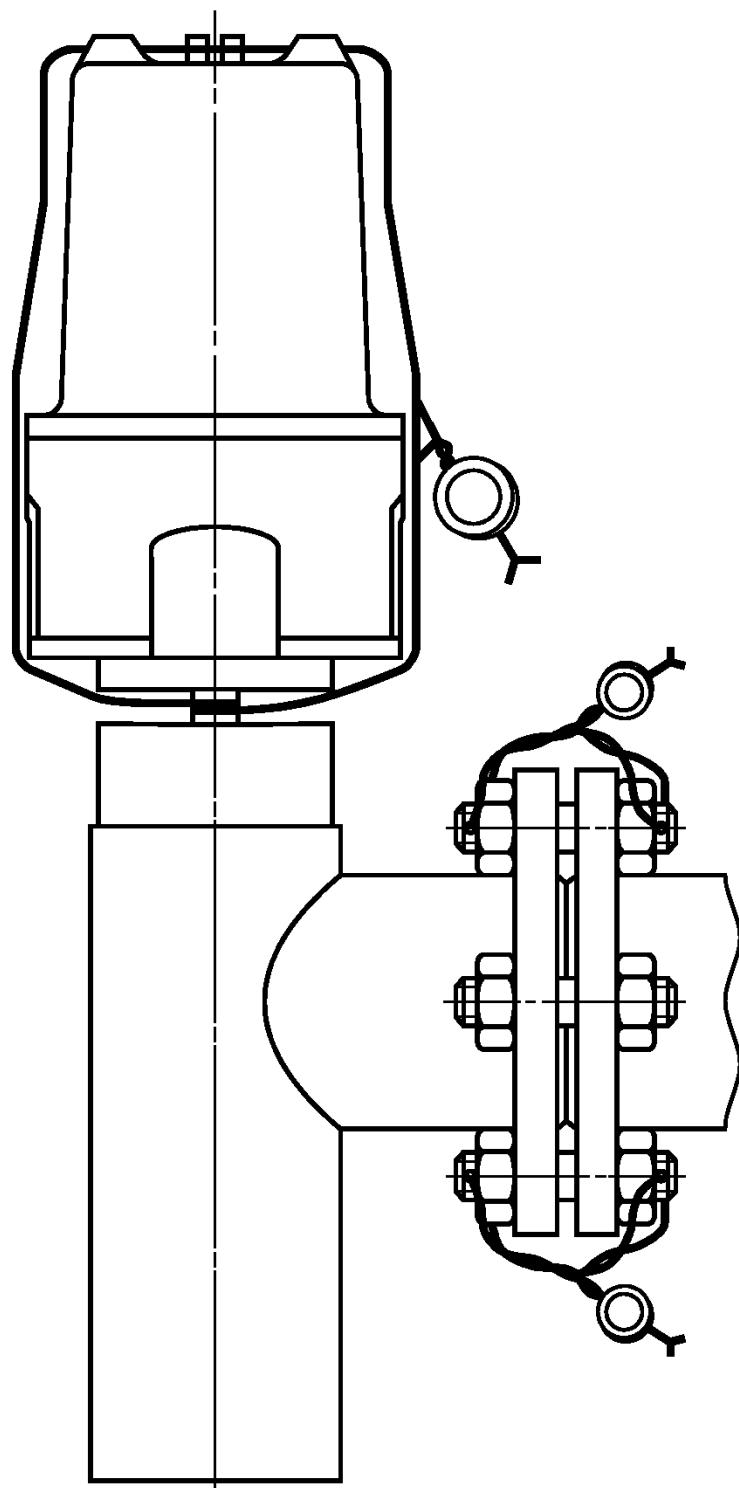


Рисунок Б.34.2 — Влагомер поточный фирмы «Phase Dynamics, Inc.».
Вариант исполнения 2

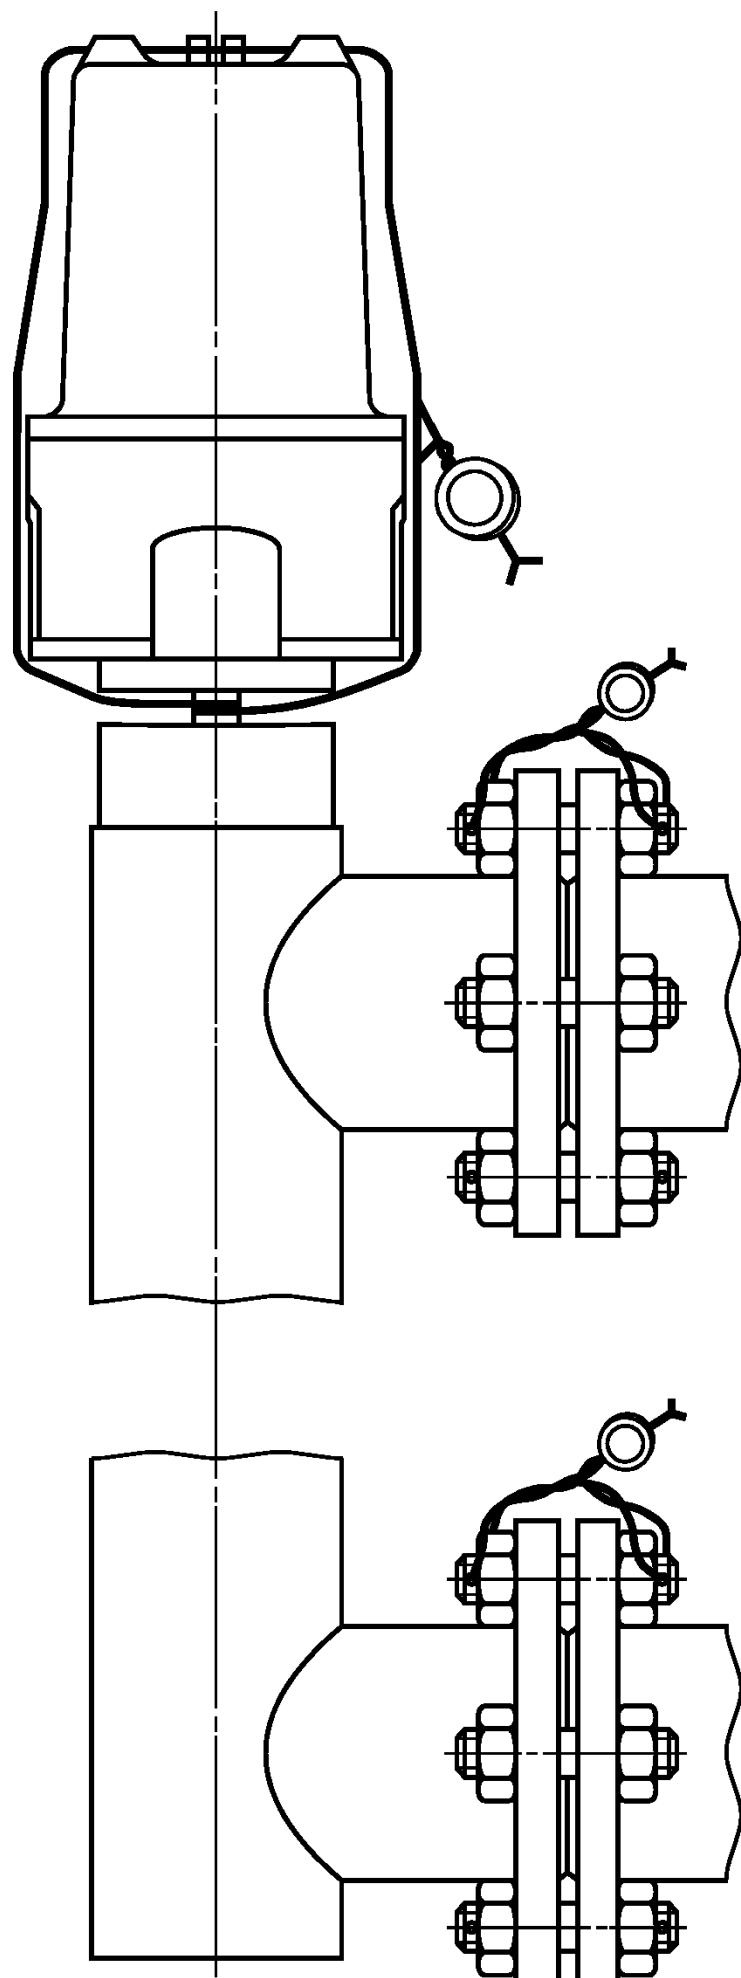


Рисунок Б.34.3 — Влагомер поточный фирмы «Phase Dynamics, Inc.». Вариант исполнения 3

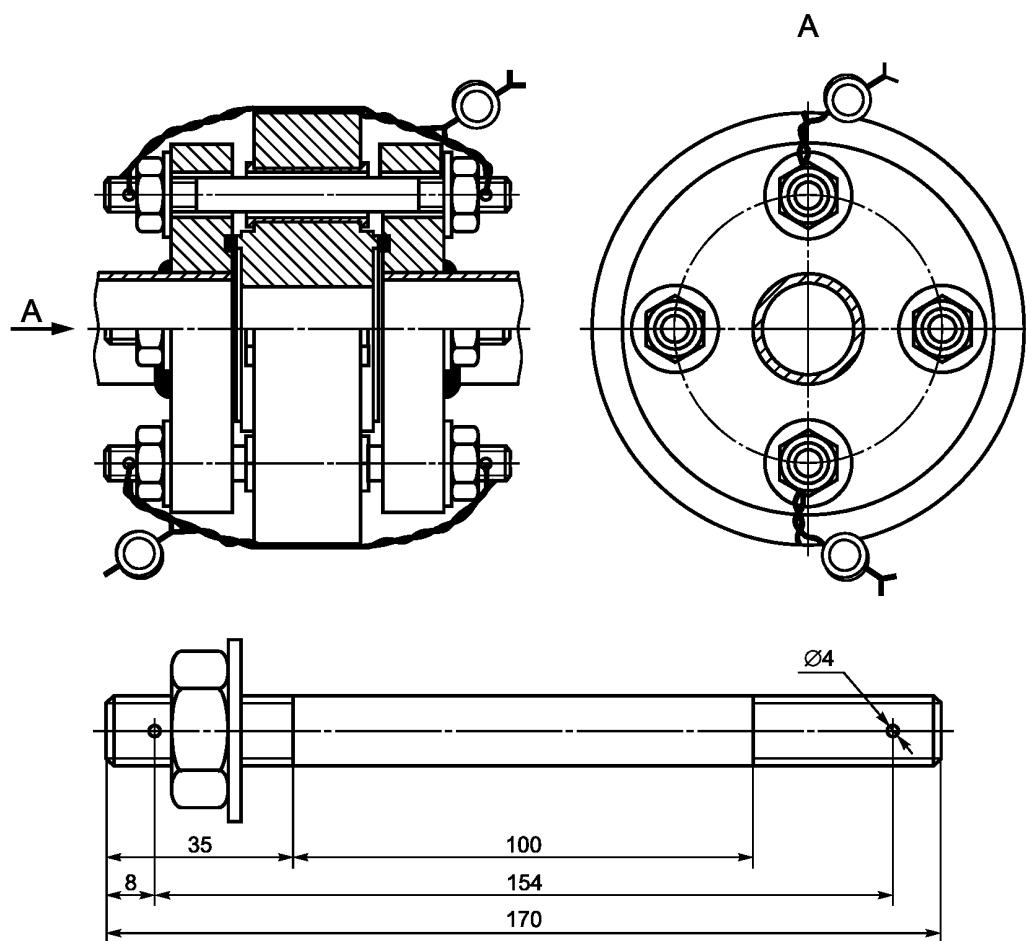


Рисунок Б.35 — Преобразователь измерительный сверхвысокочастотный влагомера нефти поточного УДВН—1пм ООО НПП «ГОСИБ»

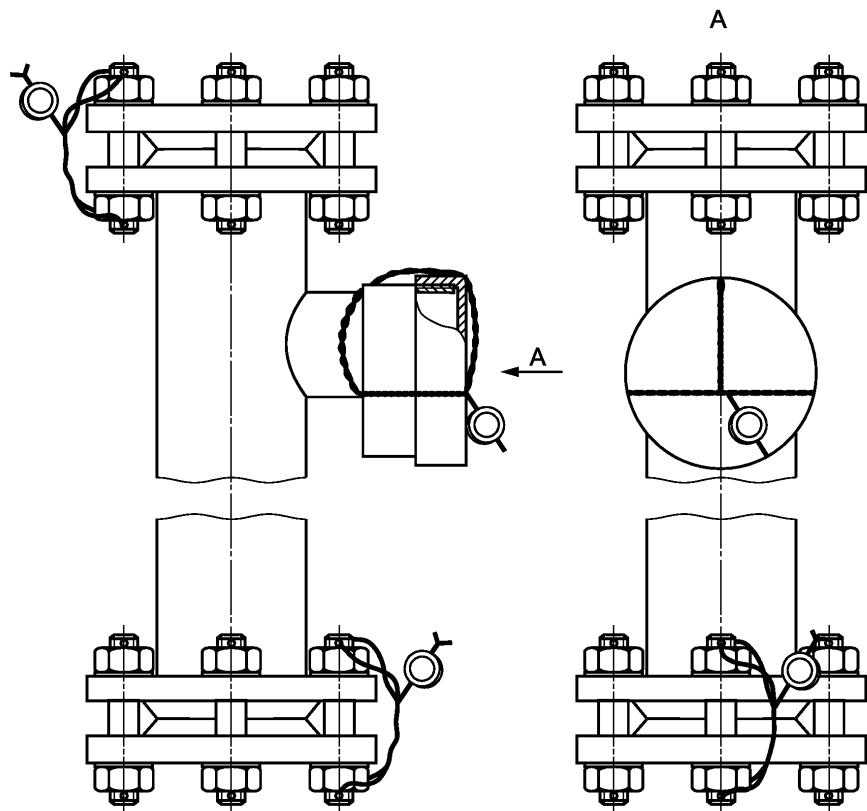


Рисунок Б.36 — Влагомер сырой нефти ВСН НПП «Нефтесервисприбор»



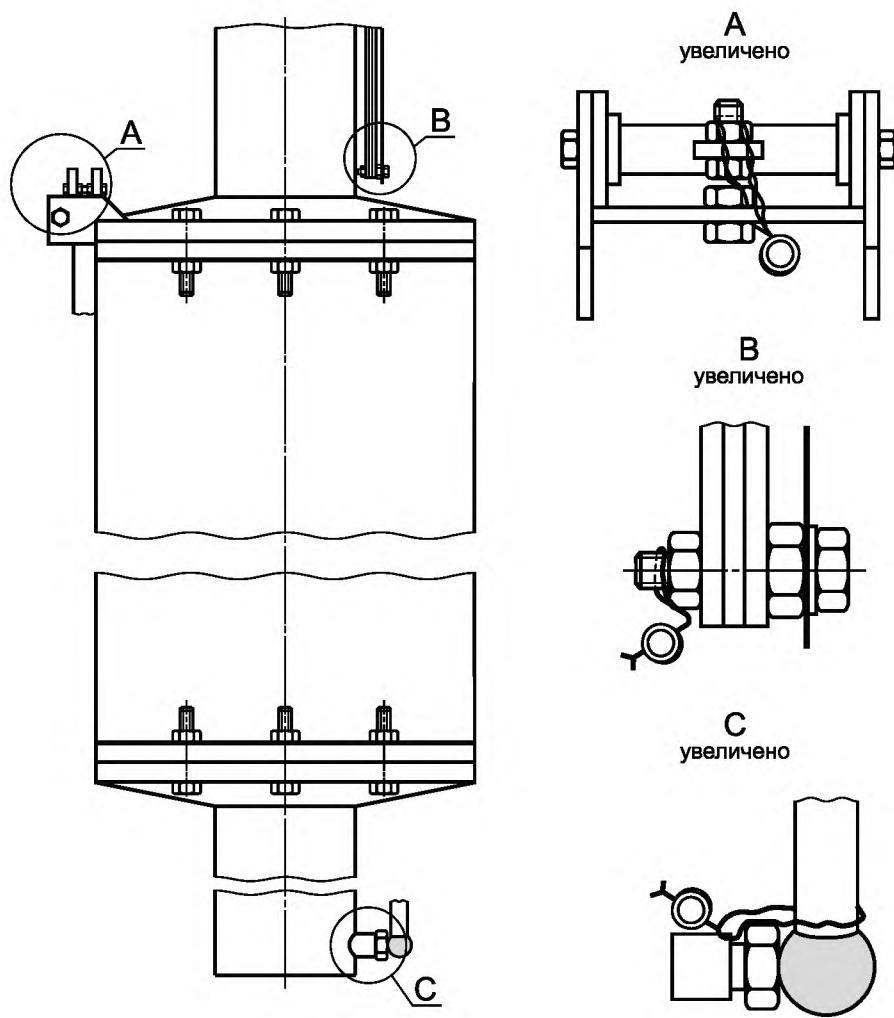


Рисунок Б.37 — Мерник образцовый МИР фирмы «Energoinvest»

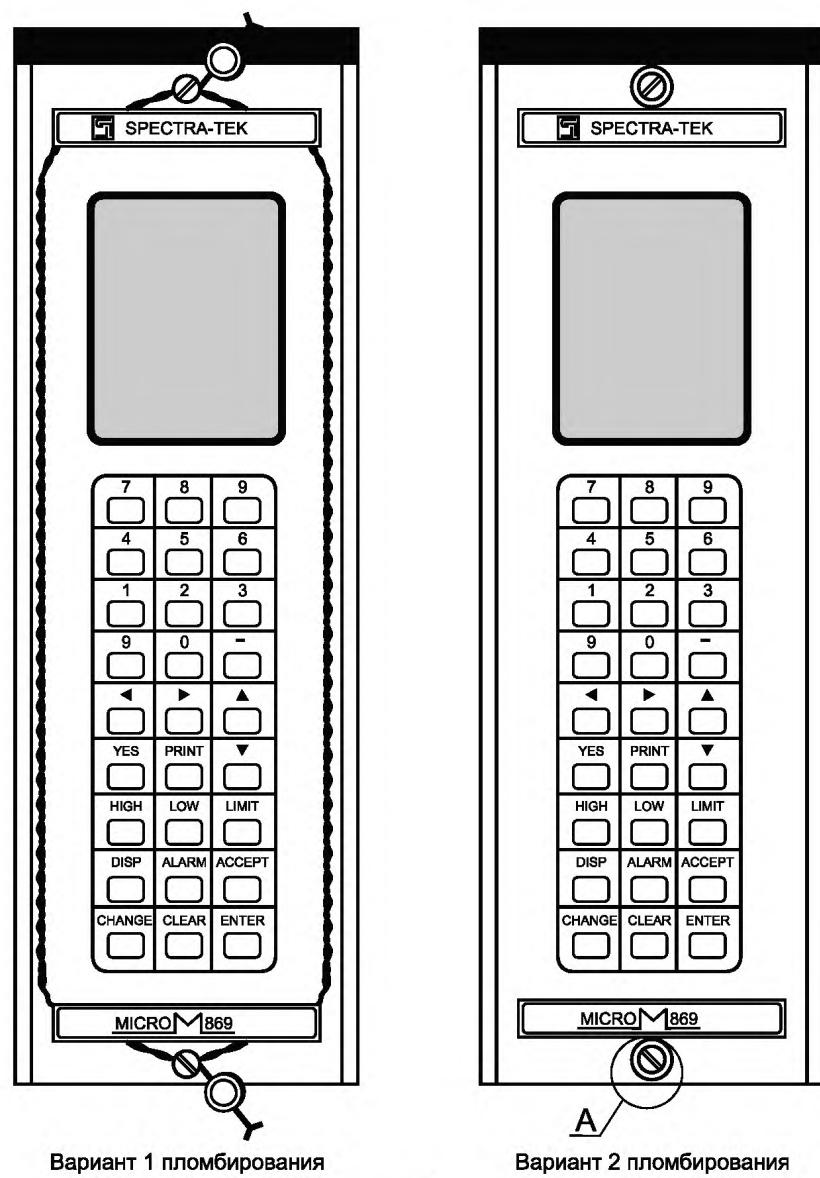



Вариант 1 пломбирования

Вариант 2 пломбирования



1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — передняя панель; 5 — корпус прибора

Рисунок Б.38 — Вторичная аппаратура ТПУ «Energoinvest»

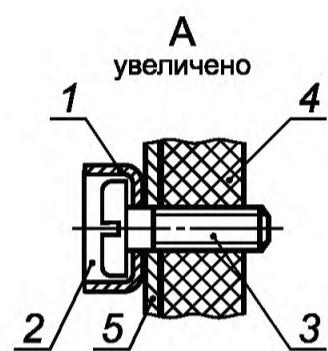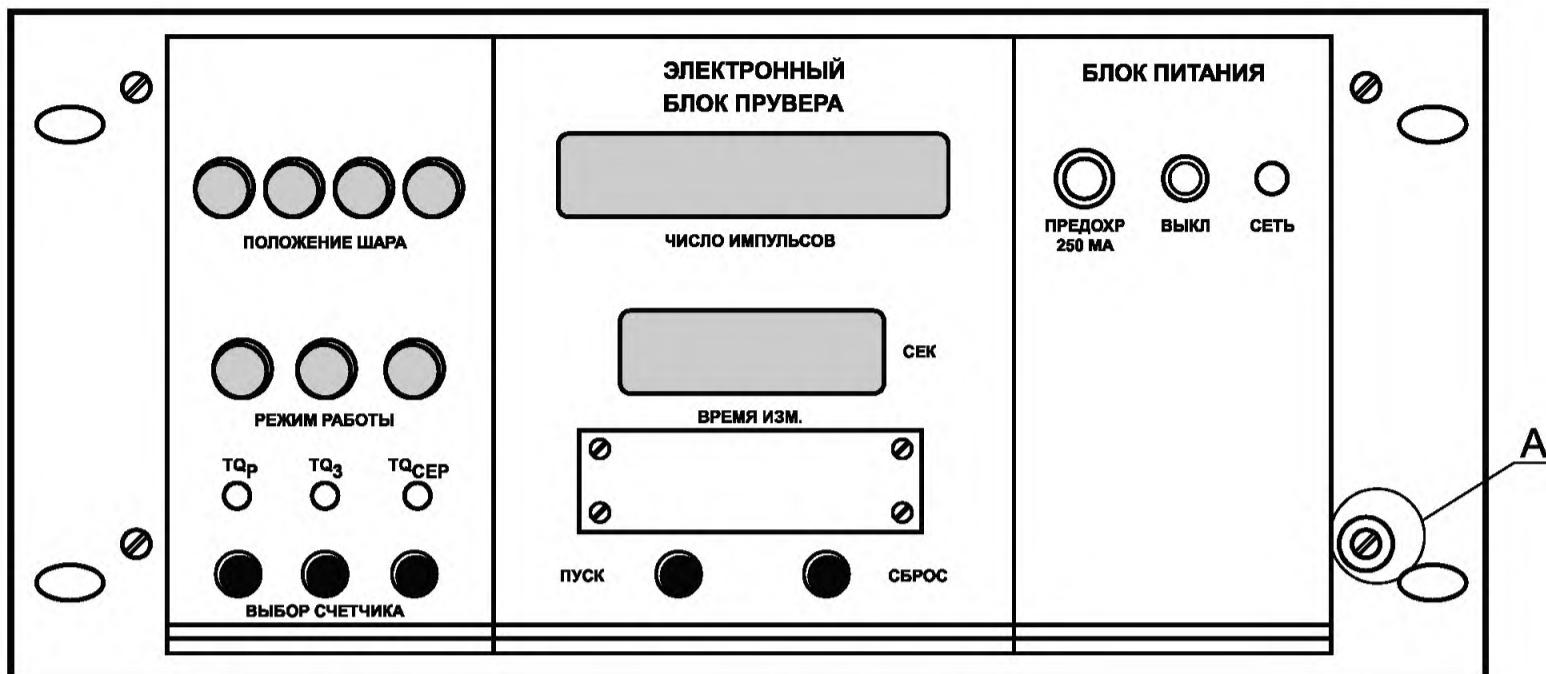

1 — шайба чашеобразная М5; 2 — мастика для оттиска клейма; 3 — винт М4; 4 — лицевая панель прибора;
5 — корпус прибора

Рисунок Б.39 — Вторичная аппаратура ТПУ «ММГ АМ»

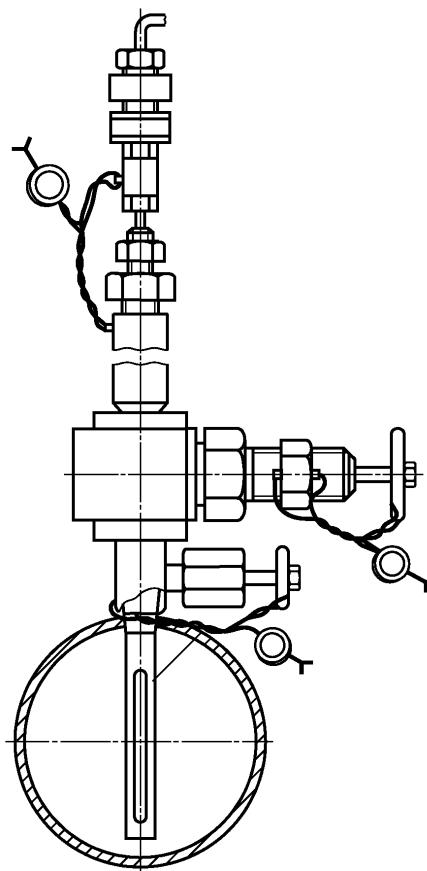


Рисунок Б.40 — Индикатор фазового состояния потока ИФС-1В-700 ОАО «Электрон»

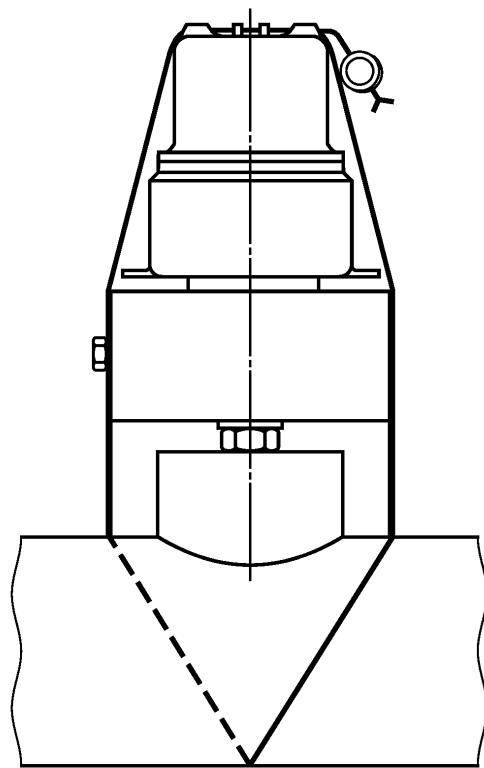


Рисунок Б.41 — Пробоотборник Cliff Mock «NuFlo Technologies, Inc.»

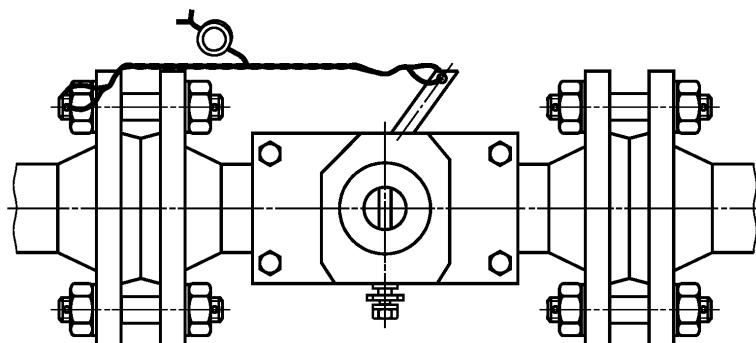


Рисунок Б.42 — Пробоотборник для ручного отбора «СТАНДАРТ» — Р БОЗНА

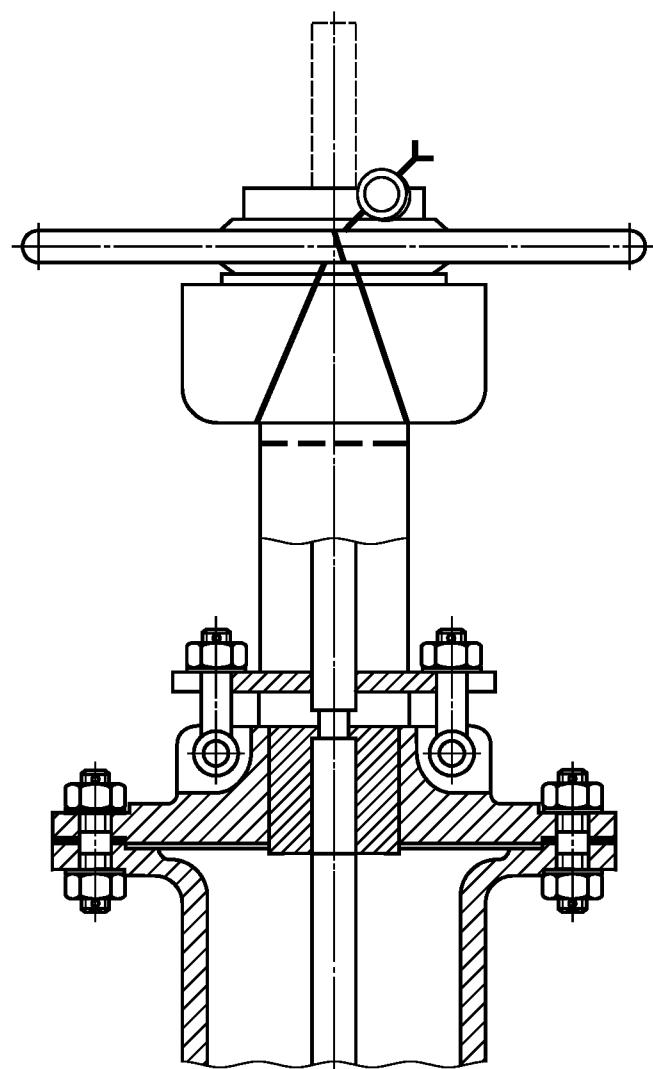


Рисунок Б.43 — Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем
ОАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры»

Приложение B
(справочное)

Примеры реализации в СОИ уровней доступа пользователей к выполнению защищенных функций

Системы обработки информации и вторичная аппаратура, входящие в состав и расположенные в операторской СИКН, снабжены различными уровнями защиты от несанкционированного доступа к изменению информации. Уровни доступа обеспечивают с помощью ключа, блокирующего переключатели и (или) пароли.

В.1 В блоке обработки информации СОИ «Пульсар-С» доступ пользователей к выполнению тех или иных защищенных функций реализован через предоставление определенному пользователю определенных прав доступа. Пользователи, работающие с системой, могут иметь следующие права доступа:

- «поверитель»;
- «покупатель»;
- «продавец»;
- «обслуживающий персонал».

Поверитель получает право доступа через разблокирование пломбируемого тумблера S1, расположенного на задней панели блока обработки информации.

Представители покупателя и продавца получают право доступа либо через разблокирование пломбируемых тумблеров S2 и S3 соответственно, либо через ввод личного пароля.

Представители обслуживающего персонала получают право доступа только через ввод личного пароля.

В.2 Вычислитель расхода DANIEL мод. 2522 имеет следующие уровни доступа:

- полный доступ к изменению любых параметров;
- полное отсутствие доступа к изменению какого-либо параметра;
- полный доступ к изменению любых параметров при вводе пароля.

В.3 Система защиты контроллера ROC 407/FLOBOSS поддерживает до 50 индивидуальных пользователей. Каждому пользователю присваивается уровень безопасности в диапазоне от нуля (самый высокий) до девяти (самый низкий).

В.4 В вычислителях расхода SOLARTRON мод. 7915, 7925 доступ пользователей реализован с помощью ввода паролей или переключателя внутри вычислителя. С помощью паролей реализовано четыре уровня доступа.

В.5 Для ограничения несанкционированного доступа в ИВК типа ИМЦ-03 введено четыре уровня доступа (от нуля — только просмотр) до трех (доступ ко всем константам) и паролей (продавца, покупателя, наладчика и поверителя).

В.6 В ИВК «OMNI» предусмотрены четыре уровня паролей (привилегированный, 1, 1A, 2) и блокирующий переключатель внутри передней панели ИВК. На привилегированном уровне можно изменять все константы и пароли, а на уровне 1A можно изменять константы ТПР и плотномера.

В.7 Для защиты вычислителей расхода мод. 7950, 7951, 7955 от несанкционированного доступа к изменению информации (ввод мгновенных значений, проведение поверки) предусмотрена также система паролей по следующим уровням доступа:

- «программист» или «калибровка» — персонал от организации, разработавшей программное обеспечение, и поверитель;
- «инженер» — персонал наладочной организации (при первоначальных пусконаладочных работах СИКН), в дальнейшем при эксплуатации СИКН — персонал сервисной организации, производящей техническое обслуживание СИКН;
- «оператор» — персонал организаций, сдающих и (или) принимающих нефть.

С помощью ключа обеспечивается доступ пользователей на всех уровнях без ввода паролей.

Доступные функции для пользователей представлены в таблице В.1.

Таблица В.1

Доступные функции	Уровни доступа			
	Калибровка	Инженер	Оператор	Всеобщий
Программируемые параметры, кроме кодов безопасности	Да	Да	Частично ¹⁾	Нет
Коды безопасности	Да	Нет	Нет	Нет
Функции программирования	Да	Да	Нет	Нет
Функции калибровки	Да	Нет	Нет	Нет
Отображение уровня светодиодом	Красный мигающий	Красный	Оранжевый	Зеленый

¹⁾ Все данные или функции, которые не влияют на результат вычислений.

На уровне доступа «калибровка» или «программист» поверитель совместно с инженером сервисной организации проводит поверку вычислителя расхода 7955, преобразователей расхода и ввод коэффициентов после поверки СИ, входящих в состав СИКН. На уровне доступа «инженер» представитель наладочной или сервисной организации вводит верхние и нижние предельные значения по измеряемым параметрам.

На уровне доступа «оператор» можно менять аварийные уставки по измеряемым величинам с обязательной регистрацией и указанием причины изменения в журнале эксплуатации СИКН.

В.8 Для защиты АРМ оператора «CROPOS» от несанкционированного доступа к изменению информации (ввод мгновенных значений, проведение поверки, редактирование файлов) предусмотрена следующая система паролей по уровням доступа, показанная на рисунке В. 1.



Библиография

[1] Правила по метрологии ПР 50.2.007—2001	Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма
[2] Правила по метрологии ПР 50.2.016—94	Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к выполнению калибровочных работ
[3] Правила по метрологии ПР РСК 002—95	Калибровочные клейма
[4] Рекомендации по метрологии МИ 1974—2004	Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи расхода турбинные. Методика поверки
[5] Рекомендации по метрологии МИ 2903—2005	Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики ультразвуковые ALTOSONIC-5 (мод. ALTOSONIC-5M). Методика поверки поверочной установкой «BCP-M» в комплекте с компаратором
[6] Рекомендации по метрологии МИ 2974—2006	Государственная система обеспечения единства измерений. Установки поверочные трубопоршневые 2-го разряда. Методика поверки трубопоршневой поверочной установкой 1-го разряда с компаратором

Рекомендации по межгосударственной стандартизации

РМГ 111—2011

Государственная система обеспечения единства измерений

**ПРАВИЛА ПЛОМБИРОВАНИЯ И КЛЕЙМЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СОСТАВЕ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
НЕФТИ**

Основные положения

Редактор *В.А. Бучумова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *М.В. Бучная*

Компьютерная верстка *А.В. Бестужевой*

Сдано в набор 07.12.2012. Подписано в печать 05.03.2013. Формат 60 ×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 7,90. Уч.-изд. л. 7,30. Тираж 200 экз. Зак. 250.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.