


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

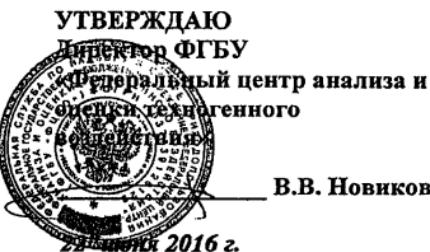

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОД

**МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ ХРОМА
В ПИТЬЕВЫХ, ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОДАХ
ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
С ДИФЕНИЛКАРБАЗИДОМ**

ПНДФ 14.1:2:4.52-96

**Методика допущена для целей государственного
экологического контроля**

**МОСКВА
(Издание 2016 г)**

Право тиражирования и реализации принадлежит разработчику.

Методика измерений аттестована Центром метрологии и сертификации «СЕРТИМЕТ» Уральского отделения РАН (Аттестат аккредитации № RA.RU.310657 от 12.05.2015), рассмотрена и одобрена федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФГБУ «ФЦАО»).

Настоящее издание методики введено в действие взамен предыдущего издания ГНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2011 г) и действует до выхода нового издания.

Сведения об аттестованной методике измерений переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Заместит

Б. Сучков

Разработ
ФГБУ «ФЦА»
Адрес: 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, -----
тел./факс: (495) 229-50-38, 943-2-944
e-mail: metod@fcao.ru

Полное или частичное тиражирование, копирование и размещение в Интернете и на любых других носителях информации данных материалов без письменного разрешения разработчика преследуется по ст. 146 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации ионов хрома общего, трех- и шестивалентного в питьевых, природных (*пресных, включая воды поверхностных и подземных источников*) и сточных водах фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. Методика предназначена для измерения показателей состава питьевых, природных и сточных вод.

Диапазон измерений от 0,010 до 3,0 мг/дм³.

Если массовая концентрация ионов хрома в анализируемой пробе ниже минимально определяемой, то допускается концентрирование путем упаривания.

Если массовая концентрация ионов хрома в анализируемой пробе превышает верхнюю границу диапазона, то допускается разбавление пробы таким образом, чтобы массовая концентрация ионов хрома соответствовала регламентированному диапазону.

Определению мешают присутствующие в высоких массовых концентрациях (свыше 200 мг/дм³) ионы ртути. С дифенилкарбазидом также вступают в реакцию и окрашивают раствор ванадий и молибден (VI), присутствие этих элементов допустимо при массовых концентрациях до 200 мг/дм³.

Мешает определению железо (III) при содержании более 1 мг/дм³, образующее с дифенилкарбазидом соединение, окрашивающее анализируемый раствор в желто-бурый цвет. Влияние железа устраняется добавлением ортофосфорной кислоты, что предусматривается в ходе определения.

Марганец при большом его содержании в пробе при окислении персульфатом может выпасть в осадок в виде диоксида марганца: осадок тогда отделяют фильтрованием через пористую пластинку.

При определении хрома (VI) на результаты может повлиять то обстоятельство, что хром в виде хромата и бихромата может окислять некоторые содержащиеся в пробе вещества в интервале времени между отбором пробы и анализом. В подобных случаях хром определяют непосредственно после отбора пробы.

В водах с высоким содержанием растворенных веществ может оказывать мешающее влияние повышенное содержание кальция, который в реакции с серной кислотой в ходе определения дает помутнение, вызванное осаждением сульфата кальция. В таких случаях рекомендуется использовать вариант определения, при котором вместо серной кислоты применяют трихлоруксусную кислоту (п.9.3).

В нейтральных или щелочных водах раздельное определение хрома (VI) и хрома (III) затруднено тем, что при подкислении таких вод, если они (как это обычно бывает) содержат восстановители – соли железа, сульфиты, многие органические вещества и т.п., происходит восстановление хрома (VI) до хрома (III).

В водах, содержащих окрашенные органические вещества, а также органические вещества, приводящие к восстановлению хрома при подкислении пробы, определить хром (VI) фотометрическим методом трудно даже тогда, когда эти воды имеют кислую реакцию, и поэтому по данной методике в мутных и окрашенных водах определяют только общее содержание хрома.

При невозможности устранения мешающих влияний при определении хрома по данной методике необходимо проводить определение хрома в соответствии с другими аттестованными методиками измерений.

Методика ФР 1.31.2016.24677* предназначена для работы с 22 сентября 2016 года.

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16/items/275989>

2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Методика измерений должна обеспечивать выполнение измерений с погрешностью (неопределенностью), не превышающей нормы точности измерений показателей состава и свойств вод, установленных ГОСТ 27384-2002.

Значения показателя точности измерений¹ – расширенной относительной неопределенности измерений по настоящей методике при коэффициенте охвата 2 приведены в таблице 1. Бюджет неопределенности измерений приведен в приложении А.

¹ В соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 (п. 3.4) в качестве показателя точности измерений использованы показатели неопределенности измерений.

Таблица 1 – Диапазон измерений, показатели неопределенности измерений

Диапазон измерений, мг/дм ³	Суммарная стандартная относительная неопределенность, <i>u</i> , %	Расширенная относительная неопределенность, <i>U</i> при коэффициенте охвата <i>k</i> = 2, %
От 0,010 до 0,10 включ.	14	28
Св. 0,10 до 3,0 включ.	9	18

Значения показателя точности методики используют при:

- оформлении результатов анализа, выдаваемых лабораторией;
- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;
- оценке возможности использования настоящей методики в конкретной лаборатории.

3 ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, МАТЕРИАЛАМ, РЕАКТИВАМ

При выполнении измерений должны быть применены следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, реактивы.

3.1 Средства измерений, стандартные образцы

Спектрофотометр или фотоколориметр, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны $\lambda = 540$ нм.

Весы лабораторные неавтоматического действия, обеспечивающие в диапазоне от 1 г до 210 г измерения с относительной погрешностью не более 0,1%. Весы должны быть поверены.

Государственные стандартные образцы (ГСО) состава раствора ионов хрома с массовой концентрацией 1 мг/см³. Относительная погрешность аттестованных значений массовой концентрации не более 1% при $P=0,95$.

Колбы мерные вместимостью 50; 100; 500; 1000 см³ по ГОСТ 1770-74, 2 класс точности.

Пипетки градуированные вместимостью 1; 2; 5 и 10 см³ по ГОСТ 29227-91, 2 класс точности.

Пипетки с одной отметкой вместимостью 1; 2; 5; 25 и 50 см³ по ГОСТ 29169-91, 2 класс точности.

Цилиндры мерные вместимостью 50; 100 и 250 см³ по ГОСТ 1770-74, 2 класс точности.

Шкаф сушильный с температурным режимом $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$, например, СНОЛ по ТУ 16-681.032-84.

3.2 Вспомогательное оборудование, материалы

Кюветы с толщиной поглощающего слоя 10 и 50 мм.

Баня песчаная или плитка электрическая с регулятором температуры по ГОСТ 14919-83.

Фильтры обеззоленные по ТУ 6-09-1678-95.

Бумага индикаторная универсальная (с шагом 1 ед. pH) по ТУ 6-09-1181-89.

Колбы конические плоскодонные термостойкие КН-1(2)-100(250) по ГОСТ 25336-82.

Воронки стеклянные для фильтрования по ГОСТ 25336-82.

Фильтры Шотта по ГОСТ 25336-82 или фильтры мембранные с диаметром пор 0,40-0,45 мкм, например, производства фирмы Millipore или фирмы Владипор.

Холодильник бытовой любой марки, обеспечивающий хранение проб при температуре $(2 - 8)^\circ\text{C}$.

Бутыли из полимерного материала или боросиликатного стекла с притертymi или винтовыми пробками вместимостью не менее 250 см^3 для отбора и хранения проб.

Таймер любой модели.

П р и м е ч а н и я

1 Допускается использование других средств измерений утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью.

2 Допускается использование другого оборудования с метрологическими и техническими характеристиками, аналогичными указанным.

3 Средства измерений должны быть поверены в установленные сроки.

3.3 Реактивы

Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220-75.

Аммоний надсернокислый (персульфат аммония) по ГОСТ 20478-75.

Спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ Р 55878-2013.

Серная кислота по ГОСТ 4204-77.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77.

Дифенилкарбазид, ч.д.а.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552-80.

Кислота азотная по ГОСТ 4461-77.

Трихлоруксусная кислота по ТУ 6-09-1926-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

П р и м е ч а н и я

1 Все реактивы, используемые для измерений, должны быть квалификации ч.д.а. или х.ч.

2 Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных.

4 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Фотометрический метод определения массовой концентрации ионов хрома основан на реакции дифенилкарбазида в кислой среде с бихромат-ионами с образованием соединения фиолетового цвета, в котором хром содержится в восстановленной форме в виде хрома (III), а дифенилкарбазид окислен до дифенилкарбазона.

Измерение проводят при длине волны $\lambda = 540$ нм.

В одной порции пробы проводят окисление хрома (III) до хрома (VI) персульфатом и определяют суммарное содержание в пробе обеих форм хрома, в другой порции пробы окисление хрома (III) не проводят и определяют только содержание хрома (VI). По разности между полученными результатами находят содержание хрома (III).

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При выполнении измерений массовой концентрации ионов хрома необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности.

5.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами ГОСТ 12.1.007-76.

5.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ Р 12.1.019-2009.

5.3 Организация обучения работающих безопасности труда по ГОСТ 12.0.004-2015*.

5.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

5.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

5.6 Используемую в работе посуду не допускается мыть хромовой смесью! Для обработки стеклянной посуды необходимо применять моющие средства, раствор азотной кислоты и тщательно промывать водопроводной, а затем дистиллированной водой.

6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

Выполнение измерений может производить химик-аналитик, владеющий техникой фотометрического анализа, изучивший инструкции по эксплуатации спектрофотометра или фотоколориметра и получивший удовлетворительные результаты при выполнении контроля процедуры измерений.

7 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения проводятся в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха $(20\pm5)^\circ\text{C}$;
- атмосферное давление $(84,0\text{--}106,7)$ кПа $(630\text{--}800)$ мм рт.ст);
- относительная влажность не более 80 % при $t=25^\circ\text{C}$;
- напряжение сети (220 ± 22) В.

8 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

При подготовке к выполнению измерений должны быть проведены следующие работы: отбор и хранение проб, подготовка прибора к работе, приготовление вспомогательных и градуировочных растворов, установление и контроль стабильности градуировочной характеристики.

8.1 Отбор и хранение проб

8.1.1 Отбор проб природных и сточных вод производится в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2015 г.) «Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод».

Отбор проб питьевых вод производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

При необходимости определения хрома (VI) анализ осуществляют непосредственно после отбора пробы, так как хромат или бихромат может окислять некоторые вещества, находящиеся в пробе между взятием пробы и ее исследованием. Срок хранения пробы при этом не более 6 часов после

отбора пробы при обычных условиях и не более 24 часов при хранении в тёмном месте при температуре (2-8)°С.

8.1.2 Бутыли для отбора и хранения проб воды при необходимости обезжирают раствором синтетического моющего средства, промывают водопроводной водой, обрабатывают раствором азотной кислоты (1:1), тщательно промывают водопроводной, затем 3-4 раза дистиллированной водой.

8.1.3 Пробы воды (объём не менее 250 см³) отбирают в бутыли из полимерного материала или стекла, предварительно ополоснутые отби-раемой водой.

8.1.4 Пробы анализируют не позже, чем через 6 часов после отбора. При определении общего содержания хрома допускается консервирование (приблизительно 5 см³ концентрированной азотной кислоты (HNO₃) на 1 дм³ воды до достижения pH пробы не менее 2 ед. pH по универсальной индикаторной бумаге). Срок хранения законсервированной пробы составляет не более 1 месяца.

Если требуется отдельно определить хром в растворимой и нерас-творимой формах, часть пробы фильтруют через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм (до консервации), и в ней определяют растворенную форму. В этом случае, пробы необходимо отбирать только в ёмкости из полимерного материала, консервировать при этом следует полученный фильтрат.

8.1.5 Проба воды не должна подвергаться воздействию прямого солнечного света. Для доставки в лабораторию сосуды с пробами упаковыва-ют в тару, обеспечивающую сохранность и предохраняющую от резких перепадов температуры. При отборе проб составляют сопроводительный документ по утвержденной в лаборатории форме, в котором указывают:

- цель анализа, предполагаемые загрязнители;
- место, время отбора;
- номер пробы;
- объём пробы;
- должность, фамилия отбирающего пробу, дата.

8.2 Подготовка прибора к работе

Подготовку спектрофотометра или фотоэлектроколориметра к рабо-те проводят в соответствии с рабочей инструкцией по эксплуатации при-бора.

8.3 Приготовление вспомогательных растворов

8.3.1 Гидроксид натрия ($NaOH$), водный раствор молярной концентрации 1,0 моль/дм³

40 г NaOH растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, переносят в мерную колбу на 1 дм³ и доводят до метки дистиллированной водой. Срок хранения в полиэтиленовом флаконе с плотно завинчивающейся крышкой – 6 месяцев.

8.3.2 Серная кислота (H_2SO_4), водный раствор молярной концентрации 0,5 моль/дм³

27,3 см³ серной кислоты плотностью 1,84 г/см³ вносят небольшими порциями при перемешивании в (150-200) см³ дистиллированной воды, переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм³ и доводят до метки дистиллированной водой. Срок хранения – 6 месяцев.

8.3.3 Серная кислота, разбавленный раствор (1:1)

Смешивают равные объёмы серной кислоты и дистиллированной воды, осторожно приливая кислоту в воду. Срок хранения – 6 месяцев.

8.3.4 Азотная кислота, разбавленный раствор (1:1)

Смешивают равные объёмы кислоты и дистиллированной воды, приливая кислоту в воду. Срок хранения – 6 месяцев.

8.3.5 Дифенилкарбазид ($C_{13}H_{14}ON_4$), спиртовой раствор массовой доли 1,0%

Растворяют 0,50 г дифенилкарбазида в 50 см³ этилового спирта. Раствор хранят в тёмной склянке не более 7 суток. Если раствор приобретает при хранении окраску, он непригоден для использования.

8.3.6 Персульфат аммония ($(NH_4)_2S_2O_8$, раствор массовой доли ≈10%*

10,0 г персульфата аммония растворяют в 100 см³ дистиллированной воды. Раствор хранят не более 5 суток.

8.3.7 Трихлоруксусная кислота, раствор

Растворяют 163,4 г трихлоруксусной кислоты приблизительно в 500 см³ дистиллированной воды, переносят в мерную колбу на 1 дм³ и доводят до метки этой же водой. Срок хранения составляет не более 3 месяцев.

8.3.8 Приготовление основного градуировочного раствора из ГСО² с аттестованным содержанием ионов хрома

В качестве основного градуировочного раствора используется ГСО³ (1 см³ раствора должен содержать 1 мг хрома).

Основной градуировочный раствор готовят из ГСО и хранят в соответствии с инструкцией по применению.

8.3.9 Приготовление рабочего градуировочного раствора (I)

Рабочий раствор готовят в день проведения анализа разбавлением основного раствора в 100 раз дистиллированной водой. В 1 см³ раствора содержится 0,010 мг хрома.

8.3.10 Приготовление рабочего градуировочного раствора (II)

Раствор готовят в день проведения анализа разбавлением рабочего раствора (I) в 10 раз дистиллированной водой.

Для этого в мерную колбу вместимостью 50 см³ пипеткой вносят 5,0 см³ рабочего градуировочного раствора (I). Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

1 см³ раствора должен содержать 0,001 мг хрома.

*Рабочие градуировочные растворы готовят в день проведения анализа.**

8.4 Построение градуировочных графиков

8.4.1 Градуировочный график для определения хрома (VI)

Для построения градуировочного графика необходимо приготовить образцы для градуировки с массовой концентрацией ионов хрома 0,01 – 1,0 мг/дм³.

Для этого в ряд мерных колб вместимостью 100 см³ необходимо поместить аликвоту соответствующего рабочего градуировочного раствора в соответствии с таблицей 2. Далее объем разбавляют дистиллированной водой до приблизительно 80 см³, перемешивают и приливают 1 см³ серной кислоты (1:1), 0,3 см³ фосфорной кислоты, тщательно перемешивают, вносят 2 см³ раствора дифенилкарбазида (по п.8.3.5), доводят объем дистилированной водой до 100 см³ и снова перемешивают.

² Приготовление градуировочных растворов из бихромата калия приведено в Приложении Б.

³ Разрешается использование ГСО состава водного раствора ионов хрома другого значения при условии приготовления градуировочных растворов с указанными значениями массовой концентрации хрома.

Полученный раствор переносят в кювету через 10-15 минут и фотометрируют при $\lambda = 540$ нм по отношению к холостой пробе. Холостой пробой служит нулевой раствор (номер образца 1 в таблице 2).

Холостые пробы для определения хрома общего и хрома шестивалентного приготавливаются отдельно!

Состав и количество образцов для градуировки приведены в таблице 2. Неопределенность, обусловленная процедурой приготовления, для образцов для градуировки не превышает 2,8 %.

Таблица 2 - Состав и количество образцов для градуировки

№ р-ра	Массовая кон- центрация ионов хрома в градуи- ровочных рас- творах, мг/дм ³	Аликовтная часть растворов (см ³), помещенных в мерную колбу на 100 см ³	
		Рабочий раствор (II) с массовой концентрацией 0,001 мг/см ³ . График 1 (кувета 50 мм)	Рабочий раствор (I) с массовой концентрацией 0,010 мг/см ³ . График 2 (кувета 10 мм)
1	0,00	0,00	0,00
2	0,01	1,00	-
3	0,02	2,00	-
4	0,03	3,00	-
5	0,05	5,00	-
6	0,08	8,00	-
7	0,10	10,00	1,00
8	0,20	-	2,00
9	0,30	-	3,00
10	0,50	-	5,00
11	0,80	-	8,00
12	1,00	-	10,00

8.4.2 Градуировочный график для определения хрома общего

Для построения градуировочного графика для определения хрома общего необходимо в конические колбы вместимостью до* 250 см³ поместить аликовты соответствующих рабочих градуировочных растворов в соответствии с таблицей 2, развести дистиллированной водой до приблизительно 80 см³, прилить 0,3 см³ серной кислоты (по п.8.3.3) и 10 см³ раствора персульфата аммония. Полученную смесь необходимо прокипятить в течение 20-25 мин (весь персульфат должен разложиться, так как даже

следы неразложившегося персульфата аммония мешают последующему фотометрическому определению с дифенилкарбазидом) – при этом объём упаривается приблизительно до 50 см³, охлажденный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³ и дальше продолжают анализ как при определении хрома (VI)*.

Анализ образцов для градуировки проводят в порядке возрастания их концентрации. Для построения градуировочных графиков каждую искусственную смесь необходимо фотометрировать 3 раза с целью исключения случайных результатов и усреднения данных. При построении градуировочных графиков по оси ординат откладывают значения оптической плотности, а по оси абсцисс – величину концентрации вещества в колориметрируемой пробе воды, мг/дм³.

8.4.3 Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в квартал, а также при смене партий реактивов, после поверки или ремонта прибора. Средствами контроля являются вновь подготовленные образцы для градуировки.

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении для каждого образца для градуировки следующего условия:

$$| X - C | \leq 0,01 \cdot 1,96 \cdot C \cdot u_{I(TOE)} , \quad (1)$$

где X – результат контрольного измерения массовой концентрации ионов хрома в образце для градуировки, мг/дм³;

C – аттестованное значение массовой концентрации ионов хрома, мг/дм³;

$u_{I(TOE)}$ – стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности, %.

Значения $u_{I(TOE)}$ приведены в приложении А.

Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется, необходимо выполнить повторное измерение этого образца с целью исключения результата, содержащего грубую погрешность.

Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют причины и повторяют контроль с использованием других образцов для градуировки, предусмотренных методикой. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики строят новый градуировочный график.

9 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 Определение хрома (VI)

Отбирают такой объём предварительно профильтрованной анализируемой воды, чтобы в нем содержалось от 0,001 до 0,1 мг хрома (полученное значение массовой концентрации не должно превышать верхнюю границу диапазона градуировочной характеристики), переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³. Пробу нейтрализуют раствором гидроксида натрия (по п.8.3.1) или раствором серной кислоты (по п.8.3.2) до pH = 4 ед.рН, контролируя значение pH по универсальной индикаторной бумаге. Затем приливают 1 см³ серной кислоты (по п.8.3.3), 0,3 см³ фосфорной кислоты, перемешивают, вносят 2 см³ раствора дифенилкарбазида (по п.8.3.5), снова перемешивают. Далее доводят объём дистиллированной водой до 100 см³ и через 10-15 мин измеряют оптическую плотность при λ = 540 нм по отношению к холостой пробе.

В случае, если окраска и мутность пробы не уничтожены в процессе фильтрования, необходимо измерить оптическую плотность данной пробы подготовленной так же, как и при анализе, но без реагтива дающего окраску – без дифенилкарбазида («корректирующий раствор») и вычесть из полученной оптической плотности раствора с дифенилкарбазидом.

9.2 Определение суммарного (общего) содержания хрома (III) и (VI)

100 см³ первоначально неразбавленной, разбавленной или сконцентрированной пробы, содержащей в этом объёме (0,001-0,1) мг хрома, нейтрализуют раствором едкого натра (по п.8.3.1) или раствором серной кислоты (по п.8.3.2) до pH около 4 ед.рН, контролируя значение pH по универсальной индикаторной бумаге. Затем прибавляют 0,3 см³ раствора серной кислоты (по п.8.3.3*) и 10 см³ раствора персульфата аммония (по п.8.3.6) и кипятят в термостойкой колбе *не менее** 20-25 мин для *окисления** Cr³⁺ до Cr⁶⁺.

Если вышал осадок диоксида марганца (в процессе окисления персульфатом в случае присутствия больших количеств марганца), его отфильтровывают через фильтр Шотта или стеклянную фильтрующую пластиночку.

Раствор выпаривают примерно до 50 см³, охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, и дальше продолжают анализ, как при определении хрома (VI), начиная со стадии добавления серной кислоты: приливают 1 см³ серной кислоты (по п.8.3.3), 0,3 см³ фосфорной кислоты, перемешивают, вносят 2 см³ раствора дифенилкарбазида (по п.8.3.5),

снова перемешивают и доводят объём дистиллированной водой до 100 см³ – через 10-15 мин измеряют оптическую плотность при $\lambda = 540$ нм по отношению к холостой пробе.

Определив суммарное содержание обеих форм хрома и содержание хрома (VI) по формуле 2, по разности находят содержание хрома (III).

9.3 Определение содержания хрома (VI) при высоком содержании кальция

Отбирают такой объём, предварительно профильтрованной, анализируемой воды (рН ~ 7,0), чтобы в нем содержалось от 0,001 до 0,1 мг хрома (VI), переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, добавляют 2 см³ раствора трихлоруксусной кислоты (по п.8.3.7) и 1 см³ раствора дифенилкарбазида (по п.8.3.5). Объём доводят дистиллированной водой до 100 см³, хорошо перемешивают и через 15 мин измеряют оптическую плотность.

10 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Массовую концентрацию ионов хрома X (мг/дм³) рассчитывают по формуле

$$X = \frac{C \cdot 100}{V}, \quad (2)$$

где С – массовая концентрация хрома, найденная по градуировочному графику, мг/дм³;

100 – объём, до которого была разбавлена проба, см³;

V – объём, взятый для анализа, см³.

10.2 За результат измерений принимают единичное значение или в случае анализа нестандартных проб сточной воды (со сложной матрицей, существенным превышением значения ПДК и т.д.) X_{cp} – среднее арифметическое значение двух параллельных определений X_1 и X_2 :

$$X_{cp} = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad (3)$$

для которых выполняется следующее условие:

$$|X_1 - X_2| \leq 0,01 \cdot r \cdot X_{cp} \quad (4)$$

где r – предел повторяемости, значения которого приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Значения предела повторяемости при вероятности Р=0,95

Диапазон измерений, мг/дм ³	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений), г, %
От 0,010 до 0,10 включ.	25
Св. 0,10 до 3,0 включ.	17

При невыполнении условия (4) могут быть использованы методы проверки приемлемости результатов параллельных определений и установления окончательного результата согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результат измерений в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде:

$$(X \pm 0,01 \cdot U \cdot X) \text{ мг/дм}^3 \text{ или } (X_{cp} \pm 0,01 \cdot U \cdot X_{cp}) \text{ мг/дм}^3,$$

где X , X_{cp} – результат измерений массовой концентрации, установленный по п.10, мг/дм³;

U – значение показателя точности измерений (расширенная неопределенность измерений с коэффициентом охвата 2).

Значение U приведено в таблице 1.

Допускается результат измерений в документах, выдаваемых лабораторией, представлять в виде:

$$(X \pm 0,01 \cdot U_x \cdot X) \text{ мг/дм}^3 \text{ или } (X_{cp} \pm 0,01 \cdot U_x \cdot X_{cp}) \text{ мг/дм}^3, \text{ при условии}$$

$U_x < U$, где U_x – значение показателя точности измерений (расширенной неопределенности с коэффициентом охвата 2), установленное при реализации методики в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

П р и м е ч а н и е

При представлении результата измерений в документах, выдаваемых лабораторией, указывают:

- количество результатов параллельных определений, использованных для расчета результата измерений;
- способ определения результата измерений (среднее арифметическое значение или медиана результатов параллельных определений).

12 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

12.1 Общие положения

Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает:

- оперативный контроль процедуры измерений;

- контроль стабильности результатов измерений на основе контроля стабильности среднего квадратического отклонения (СКО) повторяемости, СКО промежуточной (внутрилабораторной) прецизионности и правильности.

Периодичность контроля исполнителем процедуры выполнения измерений и алгоритмы контрольных процедур, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов измерений регламентируют во внутренних документах лаборатории.

Ответственность за организацию проведения контроля стабильности результатов анализа возлагают на лицо, ответственное за систему менеджмента качества в лаборатории.

Разрешение противоречий между результатами двух лабораторий проводят в соответствии с 5.3.3 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.

12.2 Оперативный контроль процедуры измерений с использованием метода добавок

Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры K_x с нормативом контроля K .

Результат контрольной процедуры K_x рассчитывают по формуле:

$$K_x = | X_{\varphi}' - X_{\varphi} - C_d |, \quad (5)$$

где X_{φ}' – результат анализа массовой концентрации ионов хрома в пробе с известной добавкой – среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми удовлетворяет условию (4), мг/дм³.

X_{φ} – результат анализа массовой концентрации ионов хрома в исходной пробе – среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми удовлетворяет условию (4), мг/дм³.

C_d – величина добавки, мг/дм³.

Норматив контроля K рассчитывают по формуле:

$$K = 2 \sqrt{\sigma_{I(TOE)}^2_{X_{\varphi}} + \sigma_{I(TOE)}^2_{X_{\varphi'}}}, \quad (6)$$

где $\sigma_{I(\text{тоe})_{X_\varphi}}^2, \sigma_{I(\text{тоe})_{X_\varphi}}^3$ - стандартные отклонения промежуточной прецизионности, соответствующие массовой концентрации ионов хрома в пробе с известной добавкой и в исходной пробе соответственно, $\text{мг}/\text{дм}^3$.

Процедуру измерений признают удовлетворительной при выполнении условия:

$$K_x \leq K \quad (7)$$

При невыполнении условия (7) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (7) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

12.3 Оперативный контроль процедуры измерений с использованием образцов для контроля

Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры K_x с нормативом контроля K .

Результат контрольной процедуры K_x рассчитывают по формуле:

$$K_x = | C_\varphi - C |, \quad (8)$$

где C_φ – результат анализа массовой концентрации ионов хрома в образце для контроля – среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми удовлетворяет условию (4), $\text{мг}/\text{дм}^3$;

C – аттестованное значение образца для контроля, $\text{мг}/\text{дм}^3$.

Норматив контроля K рассчитывают по формуле

$$K = 2\sigma_{I(\text{тоe})}, \quad (9)$$

где $\sigma_{I(\text{тоe})}$ – стандартное отклонение промежуточной прецизионности, соответствующие массовой концентрации ионов хрома в образце для контроля, $\text{мг}/\text{дм}^3$.

Процедуру анализа признают удовлетворительной при выполнении условия:

$$K_x \leq K \quad (10)$$

При невыполнении условия (10) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (10) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

13 ПРОВЕРКА ПРИЕМЛЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ДВУХ ЛАБОРАТОРИЯХ

Расхождение между результатами анализа, полученными в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба результата анализа, и в качестве окончательного может быть использовано их среднее арифметическое значение. Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 4.

**Таблица 4 - Значения предела воспроизводимости при вероятности
 $P=0,95$**

Диапазон измерений, мг/дм ³	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в разных лабораториях), R, %
От 0,010 до 0,10 включ.	38
Св. 0,10 до 3,0 включ.	22

При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов анализа согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(информационное)

Таблица А.1 – Бюджет неопределенности измерений

Источник неопределенности	Оценка типа	Стандартная относительная неопределенность, %	
		(от 0,01 - 0,1) мг/дм ³	(св. 0,1 – 3,0) мг/дм ³
Приготовление градуировочных растворов, u_1 , %	B	2,8	2,8
Степень чистоты реактивов и дистиллированной воды, u_2 , %	B	2,3	1,5
Подготовка проб к анализу, u_3 , %	B	2,2	2,2
Стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях повторяемости ⁴ , u_r (σ_r), %	A	9	6
Стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности ⁵ , $u_{(TOK)}$ ($\sigma_{(TOK)}$), %	A	12	7
Стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости, u_R (σ_R), %	A	13,5	8
Суммарная стандартная относительная неопределенность, u_c , %		14	9
Расширенная относительная неопределенность, ($U_{отн.}$) при $k = 2$, %		28	18
Примечания			
1 Оценка (неопределенности) типа А получена путем статистического анализа ряда наблюдений.			
2 Оценка (неопределенности) типа В получена способами, отличными от статистического анализа ряда наблюдений.			

⁴ Согласно ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 учтено при расчете стандартного отклонения результатов измерений, получаемых в условиях воспроизводимости.

⁵ Согласно ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 учтено при расчете стандартного отклонения результатов измерений, получаемых в условиях воспроизводимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Приготовление градуировочных растворов из бихромата калия ($K_2Cr_2O_7$)

B.1 Приготовление основного градуировочного раствора

Растворяют $(2,828 \pm 0,001)$ г бихромата калия, высущенного в течение 2 часов при $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$, и доводят до метки бидистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 1 дм^3 .

1 см^3 раствора содержит 1,0 мг хрома.

Срок хранения раствора – 2 месяца при температуре $(2 - 8)^\circ\text{C}$.

B.2 Приготовление рабочих градуировочных растворов

Рабочий градуировочный раствор (I) с массовой концентрацией ионов хрома $0,010 \text{ мг}/\text{см}^3$ и рабочий градуировочный раствор (II) с массовой концентрацией ионов хрома $0,001 \text{ мг}/\text{см}^3$ готовят соответствующим разведением основного градуировочного раствора в мерных колбах бидистиллированной водой.⁶

Растворы готовят в день проведения анализа.

⁶ Изменение №2 от 01.10.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1 из 1

к свидетельству № 88-16207-051-RA.RU.310657-2016
об аттестации методики (метода) измерения
массовой концентрации хрома
в питьевых, промышленных и сточных водах
фотометрическим методом с диффузором-фильтром
на 1 действие
(общественное)

Значения показателей точности измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Диапазон измерений массовой концентрации хрома, значения показателей точности и распределенность измерений

Диапазон измерений, мг/дм ³	Установленная измерительность (срок службы измерения) $t = 2$, U ₉₅ , %	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, излучаемыми в ритме лаборатории), R, %	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, излучаемыми в ритме лаборатории), R, %
От 0,010 до 0,10 мг/дм ³	28	40%	38
С 0,10 до 3,0 мг/дм ³	18		22

Руководитель Центра «СЕРТИМЕТ» АХУ УрО РАН



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ ПО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УГАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Центр метрологии и сертификации «СЕРТИМЕТ»
(Центр «СЕРТИМЕТ» АХУ УрО РАН)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ (МЕТОДА) ИЗМЕРЕНИЙ

№ 88-16207-051-RA.RU.310657-2016

Методика измерения массовой концентрации хрома в питьевых, промышленных и сточных фотовизуальном методом с диффузором-фильтром,

разработанная ФГБУ «ФГИ (ЛО)» (117105, г. Москва, Воронцовский проезд, д.39 А)

предназначенная для измерения показательной состава питьевых, промышленных и сточных вод

и регламентирована в ПНД Ф 14.1.2:4.53-96 (издание 2016 г.) «Методика измерений массовой концентрации хрома в питьевых, промышленных и сточных водах фотометрические и с диффузором-фильтром», утвержденная в 2016 г., на 19 л.

Методика измерений соответствует в соответствии с ФЗ № 102 от 26 июня 2008 г.
специальными санитарными нормами.

Аттестация осуществляется по результатам метрологической экспертизы материалов по этим методикам измерений.

В результате разразования установлено, что методика измерений соответствует предъявляемым метрологическим требованиям и обладает показателями точности, приведенными в табл.


Приложение показывает точности методики измерений на 1 действие.

Лист выдачи свидетельства

22 июня 2016 г.

АХУ УрО РАН

Карельский Центр «СЕРТИМЕТ» АХУ УрО РАН

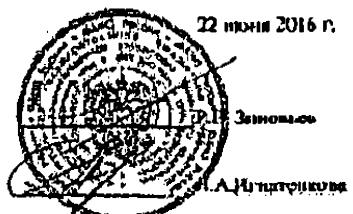

г. Екатеринбург, ул. Есениева, 1
тел (343) 362-30-97