



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ
ЭТАЛОН И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ МОЩНОСТИ
ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ФОТОННОГО
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ГОСТ 8.070-83

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ**

В. А. Берлянд, канд. техн. наук (руководитель темы), Е. В. Чуркин

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта Л. К. Исаев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-
ного комитета СССР по стандартам от 1 сентября 1983 г. № 85**

к ГОСТ 8.070—83 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для
средств измерений мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излу-
чения

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 2 (после п. 2.1.1)	2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 2,5 до 5 %.	2.1.2. Доверительные относительные погрешности δ_0 образцовых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 2,5 до 5 %.

(ИУС № 6 1984 г.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**Государственная система обеспечения
единства измерений**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ
ДОЗЫ ФОТОННОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ**

State system for ensuring the uniformity of measurements.
State primary standard and state verification schedule
for means measuring absorbed dose rate
of photon ionising radiation

ОКСТУ 0008

ГОСТ
8.070—83

Взамен
ГОСТ 8.070—73 и
ГОСТ 8.071—73

с 01.07.84

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 сентября
1983 г. № 85 срок введения установлен**

Настоящий стандарт распространяется на государственный первичный эталон и государственную поверочную схему для средств измерений мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения и устанавливает назначение государственного первичного эталона единицы мощности поглощенной дозы — грея в секунду (Гр/с) фотонного ионизирующего излучения, комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения от государственного первичного эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ**1.1. Государственный эталон**

1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения и передачи размера единицы при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения с энергией фотонов от 60 кэВ до



50 МэВ должна быть положена единица, воспроизводимая указанным эталоном.

1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

комплект дифференциальных калориметров теплового потока для воспроизведения размера единицы поглощенной дозы в графите;

графитовый фантом;

компаратор (радиационная установка, создающая коллимированный пучок гамма-излучения кобальта-60; ионизационная камера).

1.1.4. Диапазон значений мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения с энергией фотонов 1,25 МэВ, воспроизводимых эталоном, составляет $1 \cdot 10^{-3} \div 1 \cdot 10^{-1}$ Гр/с.

1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений S_0 , не превышающим $2 \cdot 10^{-3}$ при 15 независимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность Θ_0 не превышает $4 \cdot 10^{-3}$.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единицы мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения вторичным эталонам и рабочим средствам измерений повышенной точности непосредственным сличением.

1.2. Вторичные эталоны

1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют:

измерительные установки с ионизационной камерой и фантомами стандартных размеров ($30 \times 30 \times 30$ см) из воды и тканеэквивалентного вещества по ГОСТ 18622—79 в диапазоне измерений $5 \cdot 10^{-4} \div 1 \cdot 10^{-1}$ Гр/с с энергией фотонов 1,25 МэВ;

измерительные установки с герметизированной нормальной ионизационной камерой, заполняемой водо- и тканеэквивалентным газом в диапазоне измерений $5 \cdot 10^{-4} \div 1 \cdot 10^{-2}$ Гр/с с энергией фотонов от 60 до 250 кэВ;

установки с комплектом первичных калориметрических преобразователей для измерений мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения в графите в диапазоне измерений $1 \cdot 10^{-3} \div 1 \cdot 10^{-1}$ Гр/с с энергией фотонов от 1,25 до 50 МэВ;

установки с комплектом первичных калориметрических преобразователей для измерений мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения в стандартных материалах: графи-

те, воде и полистироле в диапазоне измерений $1 \cdot 10^{-2} \div 10$ Гр/с с энергией фотонов 0,66 и 1,25 МэВ.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличений S_{Σ} рабочих эталонов с государственным составляют от 0,6 до 1,5%.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера единицы образцовым 1 и 2-го разрядов и рабочим средствам измерений терапевтическим и повышенной точности методом прямых измерений и сличением при помощи компаратора (калориметров, ионизационных камер и химических или твердотельных дозиметров).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяют установки с коллимированным и диффузным полем излучения с радиоизотопными источниками, дозиметры с ионизационными камерами и калориметрами, термolumинесцентные дозиметры, химические и твердотельные дозиметры в диапазоне измерений $1 \cdot 10^{-6} \div 10$ Гр/с с энергией фотонов от 60 кэВ до 50 МэВ.

2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 2,5 до 5%.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измерений методом прямых измерений, сличением при помощи компаратора (калориметров, ионизационных камер и химических дозиметров) и непосредственным сличением.

2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют установки с коллимированным и диффузным полем излучения с радиоизотопными источниками, дозиметры с ионизационными камерами и калориметрами, термolumинесцентные дозиметры, химические и твердотельные дозиметры в диапазоне измерений $1 \cdot 10^{-8} \div 10$ Гр/с с энергией фотонов от 60 кэВ до 1,25 МэВ.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности δ_0 образцовых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 5 до 10%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений методом прямых измерений и непосредственным сличением.

2.3. Образцовые средства измерений, заимствованные из других поверочных схем

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствованных из других поверочных схем, применяют образцовые дозиметрические приборы 1-го разряда по ГОСТ 8.034—82.


2.3.2. Образцовые средства измерений, заимствованные из других поверочных схем, применяют для поверки рабочих средств измерений методом косвенных измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют терапевтические, аварийные и технологические дозиметры, дозиметры техники безопасности, основанные на калориметрическом, ионизационном, твердотельном, химическом и термolumинесцентном методах, и рабочие установки.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Δ_0 рабочих средств измерений составляют от 2 до 50%.

Государственная поверочная схема для средств измерений мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения

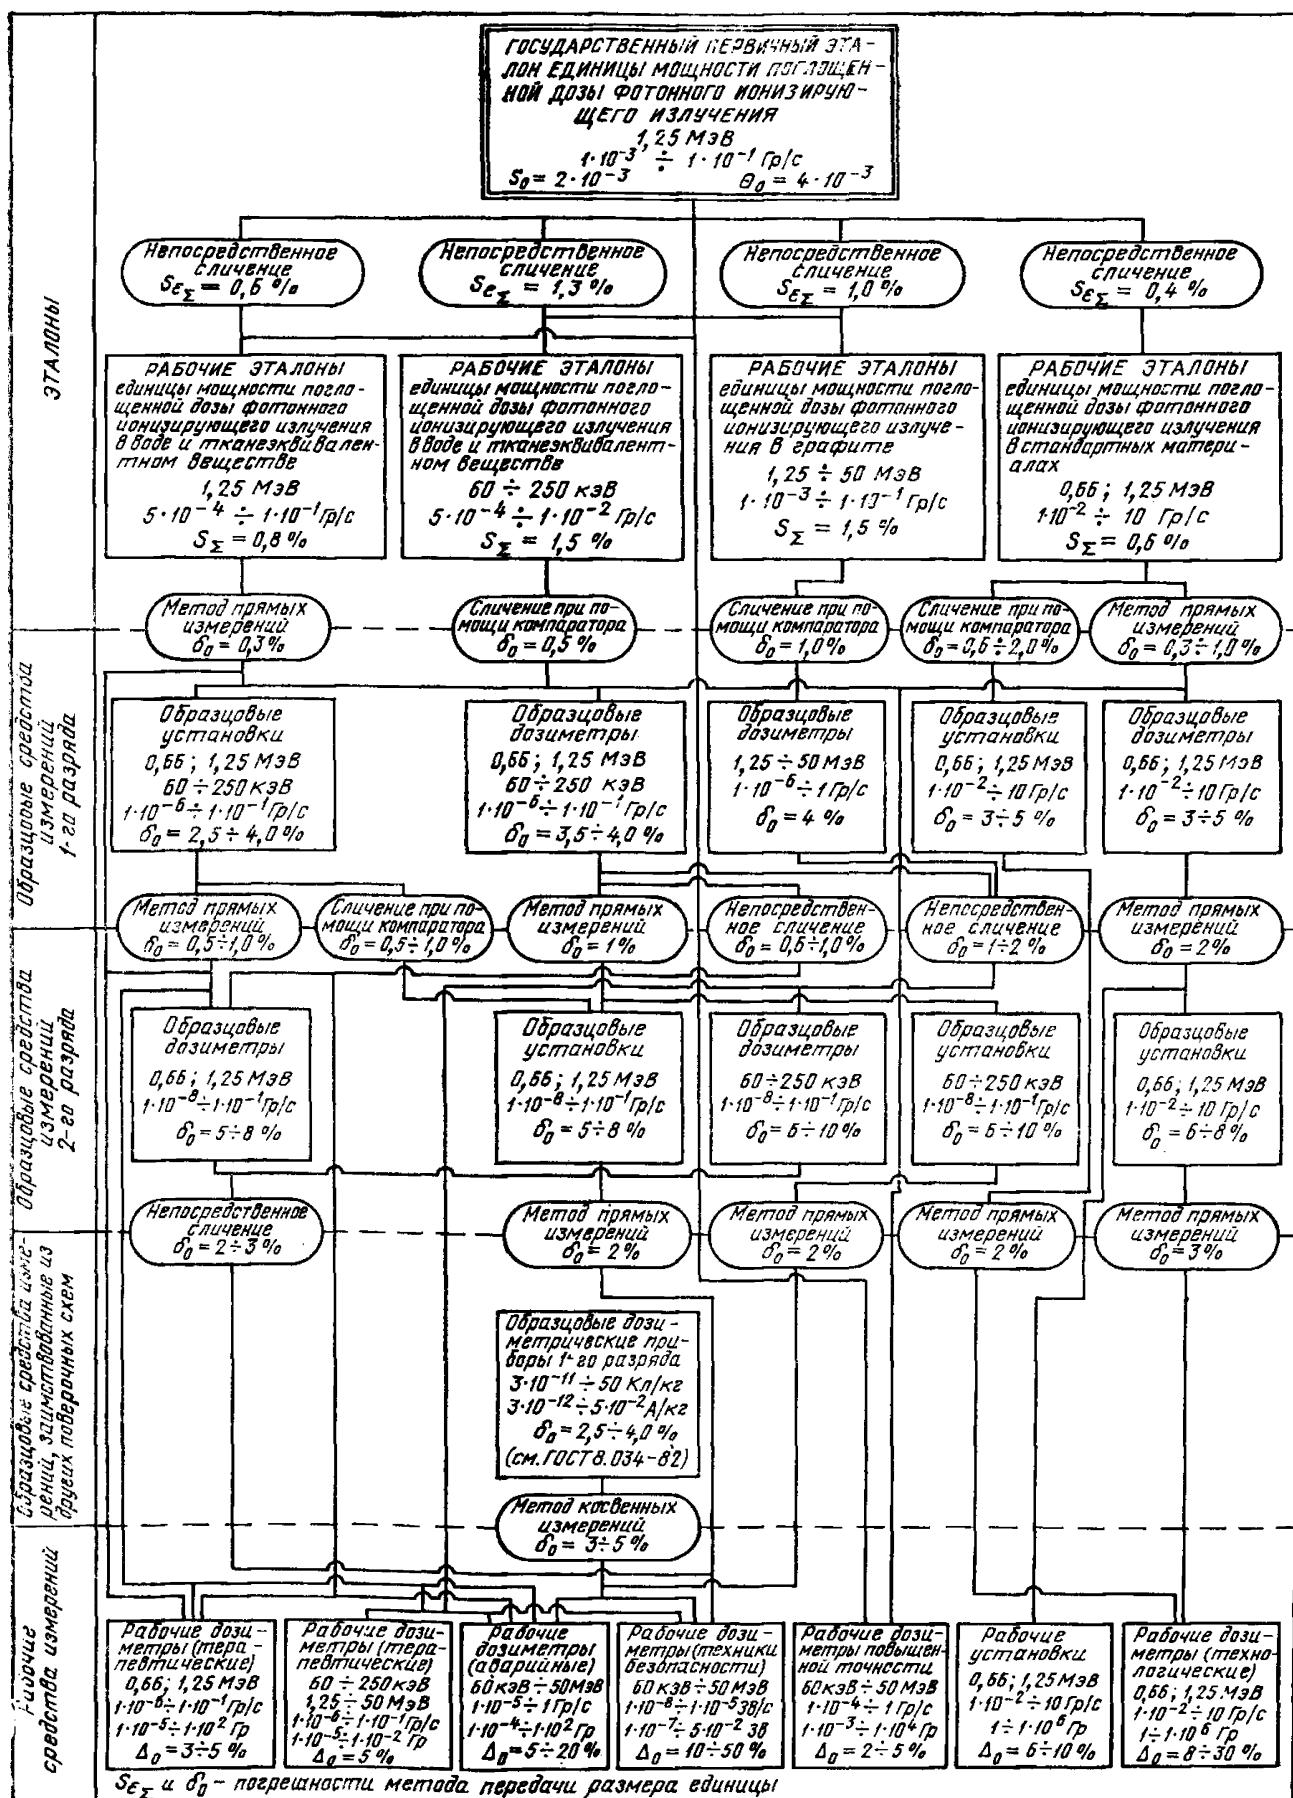

Редактор *Л. А. Бурмистрова*

Технический редактор *Н. М. Ильчева*

Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 21.09.83 Подп. к печ. 04.01.84 0,5 усл. п. л.+вкл. 0,125 усл. п. л.
0,625 усл. кр.-отт. 0,28 уч.-изд. л+вкл. 0,08 уч.-изд. л. Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета». Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1192

Величина	Единица			Обозначение	
	Наименование				
		международное	русское		
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ					
Длина	метр	m		м	
Масса	килограмм	kg		кг	
Время	секунда	s		с	
Сила электрического тока	ампер	A		А	
Термодинамическая темпера- тура	kelvin	K		К	
Количество вещества	моль	mol		моль	
Сила света	кандела	cd		кд	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ					
Плоский угол	радиан	rad		рад	
Телесный угол	стерадиан	sr		ср	
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ					
Величина	Единица			Выражение через основные и до- полнительные единицы СИ	
	Наименова- ние	Обозначение			
		междуна- родное	русское		
Частота	герц	Hz	Гц	с^{-1}	
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$	
Энергия	джоуль	J	Дж	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$	
Мощность	вatt	W	Вт	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с} \cdot \text{А}$	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-2}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^8 \cdot \text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-4} \cdot \text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	теэла	T	Тл	$\text{кг} \cdot \text{с}^{-4} \cdot \text{А}^{-1}$	
Индуктивность	геми	H	Гн	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-2}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	$\text{кд} \cdot \text{ср}$	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кд} \cdot \text{ср}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	с^{-1}	
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грей	Gy	Гр	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$	