

ГОСТ 28369—89

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ**  
**ОБЛУЧАТЕЛИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

Издание официальное

БЗ 11—2004



Москва  
Стандартинформ  
2006

## Контроль неразрушающий

## ОБЛУЧАТЕЛИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ

## Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ  
28369—89Nondestructive testing. Ultra-violet sources.  
General technical requirements and test methodsМКС 19.100  
ОКП 42 7629

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на ультрафиолетовые облучатели (далее — УФ-облучатели), предназначенные для облучения поверхности объектов при неразрушающем контроле с использованием люминесцентных дефектоскопических материалов.

## 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

По конструктивному исполнению УФ-облучатели подразделяют на стационарные, передвижные и переносные.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. УФ-облучатели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на УФ-облучатели конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Ультрафиолетовая облученность (УФ-облученность) при номинальном напряжении питания в центре облучаемого поля приведена в таблице

Исполнение УФ-облучателя	Тип	УФ-облученность, мкВт/см <sup>2</sup> (отн. ед.)	
		до 01.01.92	с 01.01.92
Переносной	Фокусирующий с мощностью лампы до 125 Вт на поле диаметром 70 мм на расстоянии 300 мм от источника	10000 (1000)	10500
	Рассеянного излучения с мощностью лампы до 125 Вт на поле диаметром 100 мм на расстоянии 300 мм от источника	1400 (140)	1500
	Малогабаритный с напряжением электрического питания до 36 В на расстоянии 100 мм от источника	500 (50)	800
Передвижной и стационарный	Одноламповый и многоламповый фокусирующий с мощностью лампы до 125 Вт на поле диаметром 130 мм для каждой лампы на расстоянии 400 мм от источника	10000 (1000)	10500
	Одноламповый рассеянного излучения с мощностью лампы до 125 В на поле диаметром 200 мм на расстоянии 300 мм от источника	2500 (250)	2600
	Двухламповый с общей мощностью ламп 250 Вт и размерами облучаемого поля 130×600 мм на расстоянии 400 мм от источника	2200 (220)	2500

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1990

© Стандартиформ, 2006

Продолжение

Исполнение УФ-облучателя	Тип	УФ-облученность, мкВт/см <sup>2</sup> (отн. ед.)	
		до 01.01.92	с 01.01.92
Передвижной и стационарный	Одноламповый с мощностью лампы 400 Вт и размерами облучаемого поля 200×500 мм на расстоянии 400 мм от источника	4500 (450)	5500

**Примечания:**

1. В пределах облучаемого поля заданного размера отношение максимальной ультрафиолетовой облученности к минимальной должно быть не более 2.

2. Допускаемое отклонение УФ-облученности устанавливают в технических условиях на УФ-облучатели конкретного типа.

2.3. Спектральный диапазон используемых в УФ-облучателях источников излучения должен быть 315—400 нм с преобладанием длины волны 365 нм. В качестве источников УФ-излучения следует использовать ртутные лампы в черных колбах, указанные в приложении 1, а также ртутные лампы с приставными светофильтрами из стекла УФС6 и УФС8 по ГОСТ 9411 и другие источники, обеспечивающие заданный спектральный диапазон.

2.4. Время установления рабочего режима должно быть 10 мин, с 01.01.92 — 8 мин.

2.5. Питание УФ-облучателей следует осуществлять от сети переменного тока частотой  $(50 \pm 1)$  Гц при отклонениях напряжения сети от минус 10 % до плюс 10 % от номинального значения.

2.6. Потребляемая мощность УФ-облучателя устанавливается в технических условиях на УФ-облучатели конкретного типа.

2.7. Коэффициент мощности многоламповых УФ-облучателей должен быть не менее 0,85, одноламповых — не менее 0,8; для УФ-облучателей общей мощностью 300 Вт и менее не нормируется.

2.8. Требования к электрической изоляции УФ-облучателей — по ГОСТ 12997.

2.9. Сопротивление изоляции УФ-облучателей при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 должно быть не менее 20 МОм.

2.10. УФ-облучатели должны допускать непрерывную работу в течение 8 ч, включая время установления рабочего режима.

2.11. Средняя наработка на отказ УФ-облучателей должна быть не менее 17000 ч. Установленную безотказную наработку устанавливают в технических условиях на УФ-облучатель конкретного типа.

2.12. Полный средний срок службы — 8 лет, а с 01.01.92 — 10 лет.

2.13. Среднее время восстановления и критерии отказов должны быть указаны в технических условиях на УФ-облучатели конкретного типа.

2.14. Устойчивость УФ-облучателей к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха — по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ 4.2.

Допускается по требованию потребителя устанавливать диапазон рабочих температур от минус 10 °С до плюс 35 °С.

2.15. УФ-облучатели должны быть устойчивы к воздействию атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

2.16. По устойчивости к механическим воздействиям стационарные УФ-облучатели относятся к группе М1 ГОСТ 17516.

2.17. В транспортной таре УФ-облучатели должны выдерживать предельные климатические условия транспортирования:

температуру — от минус 50 °С до плюс 50 °С;

относительную влажность —  $(95 \pm 3)$  % при температуре 35 °С;

воздействие транспортной тряски с ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте ударов от 80 до 120 ударов в минуту.

2.18. Защитные и защитно-декоративные покрытия наружных поверхностей УФ-облучателей — по ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.

2.19. Масса переносных УФ-облучателей с блоком питания, не встроенным в футляр для переноски, должна быть не более 4,85 кг, а с 01.01.92 — не более 4,0 кг.

Массу передвижных и стационарных УФ-облучателей устанавливают в технических условиях на УФ-облучатели конкретного типа.

### 2.20. Требования безопасности

2.20.1. Требования электробезопасности — по ГОСТ 12.2.007.0.

2.20.2. При работе с УФ-облучателями следует использовать средства индивидуальной защиты оператора — халаты с длинными рукавами и перчатки из темной нелюминесцирующей хлопчатобумажной ткани.

2.20.3. Стационарные и передвижные УФ-облучатели должны быть снабжены встроенными или отдельными устройствами, защищающими лицо и глаза оператора от воздействия УФ-излучения.

Требования к защитным устройствам устанавливаются в технических условиях на УФ-облучатели конкретного типа.

В качестве защитного материала, поглощающего УФ-излучение, следует применять полиимидную пленку типа ПМ марки А по техническим условиям толщиной не менее 30 мкм или другие материалы с аналогичными оптической плотностью и спектральной характеристикой.

2.20.4. Для индивидуальной защиты глаз следует применять защитные очки по ГОСТ 12.4.013\*:

закрытые с непрямой вентиляцией типа ЗН со светофильтрами из цветного оптического стекла марки ЖС4 по ГОСТ 9411 толщиной не менее 2 мм — при контроле объектов в условиях затемнения при диффузно отраженном УФ-облучении;

закрытые с прямой вентиляцией типа ЗН или ЗНР со светофильтрами С4 — С9 — при наладке УФ-облучателей.

2.20.5. Допустимая УФ-облученность в зоне работы оператора устанавливается с учетом спектрального состава излучения и в соответствии с «Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях» № 4557—88 не должна превышать:

1) при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более  $0,2 \text{ м}^2$  и периода облучения до 5 мин, длительности пауз между ними не менее 3 мин и общей продолжительности воздействия за смену до 60 мин:

$5000 \text{ мкВт/см}^2$  — для области УФ-А (315—400 нм),

$5 \text{ мкВт/см}^2$  — для области УФ-В (280—315 нм),

2) при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более  $0,2 \text{ м}^2$ , общей продолжительности воздействия излучения 50 % рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин и более:

$1000 \text{ мкВт/см}^2$  — для области УФ-А,

$1 \text{ мкВт/см}^2$  — для области УФ-В,

3) при использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих УФ-излучение, допустимая УФ-облученность в области УФ-В (280—315 нм), не должна превышать  $100 \text{ мкВт/см}^2$ .

2.20.6. Предельно допустимая температура частей УФ-облучателей, с которыми соприкасается оператор при работе, не должна превышать:

$40 \text{ }^\circ\text{C}$  — для составных частей, выполненных из металла;

$45 \text{ }^\circ\text{C}$  — для составных частей, выполненных из материала с низкой теплопроводностью.

2.20.7. Конструкция УФ-облучателей должна соответствовать эргономическим требованиям ГОСТ 12.2.049.

Степень защиты от проникновения твердых тел и воды — по ГОСТ 14254.

2.20.8. Схема условного обозначения УФ-облучателей приведена в приложении 2.

Номенклатура основных показателей, необходимых при разработке технических заданий на ОКР и технических условий на УФ-облучатели конкретного типа, приведена в приложении 3.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Все испытания, кроме климатических и испытаний по п. 2.5, проводят при нормальных условиях:

температуре окружающего воздуха ( $20 \pm 5$ )  $^\circ\text{C}$ ;

относительной влажности от 30 до 80 %;

атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа;

напряжении питающей сети ( $220 \pm 4,4$ ) В;

частоте питающей сети ( $50 \pm 1$ ) Гц.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013—97.

3.2. Соответствие конструкторской документации (п. 2.1) и требованиям безопасности (пп. 2.20.1—2.20.5; 2.20.7; 2.20.8) проверяют внешним осмотром и измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую точность.

### 3.3. Проверка УФ-облученности (п. 2.2)

В затемненном помещении закрепляют УФ-облучатель на заданном расстоянии от горизонтальной поверхности стола.

На световое пятно, создаваемое УФ-облучателем, накладывают лист миллиметровой бумаги с контурами облучаемого поля заданных размеров, совмещая при этом центр облучаемого поля с центром светового пятна. По истечении времени установления рабочего режима измеряют УФ-облученность в центре и в точках на границе облучаемого поля с помощью радиометров со спектральным диапазоном 315—400 нм или приспособления для измерения УФ-облученности по методике, изложенной по ГОСТ 18442.

Количество точек, в которых измеряется УФ-облученность, и их расположение на облучаемом поле устанавливают в технических условиях на УФ-облучатели конкретного типа.

УФ-облучатель считают выдержавшим испытание, если УФ-облученность в центре облучаемого поля соответствует требованиям п. 2.2, а в точках на границе облучаемого поля отличается от значений в центре поля не более чем в 2 раза.

3.4. Спектральный диапазон (п. 2.3) проверяют сравнением значений спектрального диапазона с требованиями нормативно-технической документации на источники УФ-излучения и (или) светофильтры.

3.5. Время установления рабочего режима (п. 2.4) и продолжительности непрерывной работы (п. 2.10) проверяют по методике п. 3.3 в центре облучаемого поля по истечении времени, указанного в пп. 2.4 и 2.10.

3.6. Работоспособность УФ-облучателя при отклонениях напряжения питания (п. 2.5) проверяют по методике п. 3.3 в центре облучаемого поля, устанавливая предельное напряжение питания в соответствии с требованиями п. 2.5.

УФ-облучатель считают выдержавшим испытание, если УФ-облученность в центре облучаемого поля соответствует допускаемым значениям, установленным в технических условиях на УФ-облучатели конкретного типа.

3.7. Потребляемую мощность  $S$  в вольтамперах (п. 2.6) и коэффициент мощности  $\cos \varphi$  (п. 2.7) измеряют с помощью амперметра, вольтметра и ваттметра и вычисляют соответственно по формулам:

$$S = U \cdot I,$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{U \cdot I},$$

где  $U$  — напряжение питания, В;

$I$  — потребляемый ток, А;

$P$  — активная мощность, Вт.

УФ-облучатель считают выдержавшим испытания, если потребляемая мощность и коэффициент мощности соответствуют значениям, установленным в технических условиях.

3.8. Проверка электрической прочности изоляции (п. 2.8) и сопротивления изоляции (п. 2.9) — по ГОСТ 12997.

3.9. Показатель безотказности (п. 2.11), средний срок службы (п. 2.12), среднее время восстановления (п. 2.13), требования к покрытиям (п. 2.18) проверяют по методике, установленной в технических условиях на УФ-облучатели конкретного типа.

3.10. Для проверки работоспособности при воздействии рабочих климатических условий (пп. 2.14; 2.15) помещают УФ-облучатель в климатическую камеру, повышают (понижают) температуру до 35 °С (10 °С) и выдерживают в течение 2 ч. Испытания проводят по методике п. 3.3.

3.11. Устойчивость к механическим воздействиям (п. 2.16) проверяют по методике, указанной в технических условиях на УФ-облучатели конкретного типа.

**3.12. Проверка устойчивости к воздействию предельных климатических условий транспортирования (п. 2.17)**

3.12.1. УФ-облучатель в транспортной таре помещают в климатическую камеру, понижают (повышают) температуру в камере до минус 50 °С (плюс 50 °С) и выдерживают в течение 6 ч.

## С. 5 ГОСТ 28369—89

Извлекают УФ-облучатель из камеры, освобождают от транспортной тары, выдерживают в нормальных условиях в течение 6 ч и проводят испытания по методике п. 3.3.

3.12.2. УФ-облучатель в транспортной таре помещают в климатическую камеру, повышают температуру в камере до 35 °С и влажность до  $(95 \pm 3) \%$ , выдерживают в течение 6 ч.

Извлекают УФ-облучатель из камеры, освобождают от транспортной тары, выдерживают в нормальных условиях в течение 6 ч и проводят испытания по методике п. 3.3.

3.13. Проверку устойчивости к воздействию транспортной тряски (п. 2.17) проводят на стенде имитации транспортной тряски. Для этого УФ-облучатель в транспортной таре закрепляют на платформе испытательного стенда, устанавливают на стенде параметры в соответствии с требованиями п. 2.17 и проводят испытания в течение 2 ч.

Освобождают УФ-облучатель от транспортной тары, проверяют отсутствие механических повреждений и ослаблений креплений и проводят испытания по методике п. 3.3.

3.14. Массу (п. 2.19) проверяют взвешиванием на весах общего применения с погрешностью не более  $\pm 0,05$  кг.

3.15. УФ-облученность в зоне работы оператора (п. 2.20.6) и температуру составных частей УФ-облучателей, с которыми соприкасается оператор при работе (п. 2.20.7), определяют по методике, установленной в технических условиях на УФ-облучатели конкретного типа.


*ПРИЛОЖЕНИЕ 1*  
*Рекомендуемое*

### ТИПЫ РТУТНЫХ ЛАМП

ДРУФ 125—3, ДРУФ3 125—3 по ТУ 16—89 ИФМР 675640.003.ТУ

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2*  
*Обязательное*

### СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ УФ-ОБЛУЧАТЕЛЯ

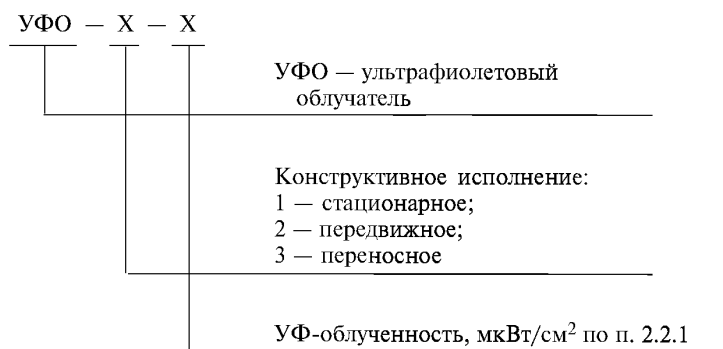

Примеры условного обозначения:

Переносной ультрафиолетовый облучатель с УФ-облученностью при номинальном напряжении питания в центре облучаемого поля 10000 мкВт/см<sup>2</sup>:

*УФО-3—10000*

Стационарный ультрафиолетовый облучатель с УФ-облученностью при номинальном напряжении питания в центре облучаемого поля 2500 мкВт/см<sup>2</sup>:

*УФО-1—2500*

Номенклатура основных показателей, устанавливаемых при разработке  
технического задания и технических условий на УФ-облучатели

Наименование показателя	Применяемость в НТД	
	ТЗ на ОКР	ТУ
Показатели назначения		
УФ-облученность, мкВт/см <sup>2</sup>	+	+
Спектральный диапазон, нм	+	+
Время установления рабочего режима, мин	+	+
Коэффициент мощности облучателя	±	±
Время непрерывной работы, ч	+	+
Габаритные размеры	+	+
Показатели надежности		
Средняя наработка на отказ, ч	±	+
Установленная безотказная наработка, ч	+	+
Полный средний срок службы, лет	—	+
Среднее время восстановления работоспособности состояния, ч	—	+
Показатели экономного использования материалов и энергии		
Масса	+	+
Потребляемая мощность, В · А	+	+
Показатели устойчивости к внешним воздействиям		
Устойчивость к воздействию климатических факторов	+	+
Устойчивость к воздействию механических факторов	—	+
Показатели безопасности		
Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, МОм	±	+
Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей, В	±	+
Эстетические показатели		
Показатель тщательности покрытия и отделки поверхности	—	+

П р и м е ч а н и е. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость, знак «±» — ограниченную применяемость соответствующего показателя качества.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.12.89 № 3744
3. ВЗАМЕН ГОСТ 4.177—85 (в части капиллярных дефектоскопов)
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.032—74	2.18
ГОСТ 9.301—86	2.18
ГОСТ 12.2.007.0—75	2.20.1
ГОСТ 12.2.049—80	2.20.7
ГОСТ 12.4.013—85	2.20.4
ГОСТ 9411—91	2.3, 2.20.4
ГОСТ 12997—84	2.8, 3.8
ГОСТ 14254—96	2.20.7
ГОСТ 15150—69	2.9, 2.14
ГОСТ 17516—72	2.16
ГОСТ 18442—80	3.3

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2006 г.

Редактор *Л. В. Коретникова*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *М. В. Бучная*  
Компьютерная верстка *А. Н. Золотаревой*

Подписано в печать 16.06.2006. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93.  
Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 82 экз. Зак. 417. С 2962.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано в Калужской типографии стандартов.  
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.